



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

SIENDO LAS **14:30 HORAS** DEL DÍA **15 DE ABRIL DE 2019**, EN LA SALA "A" DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 10, ALA NORTE, DEL EDIFICIO UBICADO EN ALTADENA NÚMERO 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA **C. SONIA DELGADO MIRANDA**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-010-19**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "**SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA**" HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: _____

-----**HECHOS**-----

- I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES **SERVIDORES PÚBLICOS**: _____

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	LIC. RAFAEL DE VILLA ARPÓN
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. JUAN MERCADILLO AGUILAR SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INSUMOS
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN
POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ESTA SECRETARÍA DE SALUD	C.P. EVA RODRÍGUEZ SORIANO Y JULIA STEFANY JOSÉ MARTÍNEZ
POR PARTE DE LA CONTRALORIA CIUDADANA	MARIA DEL CARMEN YONG CRUZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	DRA. ALEJANDRA CERVANTES JIMÉNEZ RESPONSABLE DEL PROGRAMA

- II. DE CONFORMIDAD CON EL **REGISTRO DE ASISTENCIA** DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS **LICITANTES**: _____



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTADA POR
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS REYES MADRID
VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V.	ALMA ROBLES CERVANTES
ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	ANA LUISA GARCIA ARANGO
MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	DANIEL MONROY PEREZ
AMPHARMA, S.A. DE C.V.	TAYDE ZARATI NARVÁEZ
KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE C.V.	GINA AGASSINI TÉLLEZ
SUMINISTROS MÉDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ADRIANA ZARAGOZA RAMIREZ
DISEÑO DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	JULIAN MACÍAS LIZAOLA
DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LIDIA ALMARAZ PEÑA

III. PRECISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1. EN EL PUNTO 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO M) LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL (PARA COTEJO) Y COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN DE I.S.R. ANUAL DEL EJERCICIO 2018 Y PARCIALES DE I.S.R. E I.V.A. DE ENERO A FEBRERO DE 2019, (LAS PERSONAS FÍSICAS PODRÁN PRESENTAR EN SU CASO SUS DECLARACIONES BIMESTRALES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019 SI SE ENCUENTRAN EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DEL ISR MISMOS QUE SE INTEGRARAN DENTRO DEL SOBRE ÚNICO QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
2. LA PARTIDA 1 CORRESPONDE A: "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS" Y LA PARTIDA 2 CORRESPONDE A: "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA". DEBERÁ



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

IDENTIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 30001122-010-19 "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA" EN EL CASO DE PARTICIPAR SÓLO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 30001122-010-19 SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS EN EL CASO DE PARTICIPAR SÓLO PARA EL SERVICIO DE SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS.

3. NUMERAL 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G) "CONSTANCIA DE ADEUDOS", EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 2 DE ANEXOS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE:

- IMPUESTO PREDIAL,
- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES,
- IMPUESTO SOBRE NÓMINA,
- IMPUESTO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS,
- IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS,
- IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE,

LAS CONSTANCIAS DEBEN SER ACREDITADAS CON EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL LICITANTE.

PARA EL CASO DE LOS DERECHOS SOBRE SUMINISTRO DE AGUA, SE DEBERÁ PRESENTAR LA "CONSTANCIA DE ADEUDOS", EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EN CASO DE NO CONTAR CON LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS, PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ACUSE (ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE) DE LA SOLICITUD DE INICIO DEL TRÁMITE DE LA CONSTANCIA DE ADEUDO CON FECHA NO MAYOR A DOS MESES DE ANTIGÜEDAD A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, INVARIABLEMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL ORIGINAL DE LA CONSTANCIA DE ADEUDOS. EN CASO DE QUE EN LA CONSTANCIA DE ADEUDO SE DETECTE ADEUDO DE ALGUNA DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTÉ OBLIGADO, NO PROCEDERÁ LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE.

ÉSTAS CONSTANCIAS SOLO APLICAN PARA LOS PROVEEDORES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL LA CIUDAD DE MÉXICO.

EN EL CASO DE QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE POR TAL MOTIVO NO LE SEA APLICABLE ALGUNA DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 2, ASÍ DEBERÁ MANIFESTARLO EN DICHO ANEXO, ASIMISMO, EN EL ANEXO 3, DEBERÁ SEÑALAR LA CAUSA POR LA QUE DICHAS CONTRIBUCIONES NO LE SON APLICABLES. ASIMISMO, SI EL DOMICILIO FISCAL DE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

4. ANEXO 19 PROPUESTA ECONÓMICA, PARA EFECTO DE FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS EL ANEXO 19 QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: **(ANEXO "A")**

A. ANEXO 3 PARTIDA 51 KIT DE DENERVACION, QUE INCLUYE BALON PARA DERIVACION DE 4, 5, 6 O 7 CM X 25 MM, CATÉTER GUÍA 8 FR, GUÍA DE 0.018, INTRODUTOR, INCLUYE EQUIPO PARA DENERVACION, NO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MERCADO POR TAL MOTIVO SE ELIMINA. LAS MUESTRAS FÍSICAS DE LOS BIENES SEÑALADOS EN LOS ANEXOS 7 Y 8 DE LOS ANEXOS TÉCNICOS SE ENTREGARÁN EL **DÍA 16 DE ABRIL DE 2019 EN UN HORARIO DE 9:00 A 12:00 HORAS.**

IV. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 43 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", 41 FRACCIÓN I DE SU "REGLAMENTO" Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE. LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍA E INSUMOS, DA RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO **(SE ANEXA CUADRO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.)**

V. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.---

VI. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.---

VII. SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE LLEVARÁ A CABO **EL DÍA 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS 11:00 HRS** Y EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO, SE LLEVARÁ A CABO **EL DÍA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HRS**, AMBOS EVENTOS SERÁN EN LA SALA "A" DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITO EN EL PISO 10, A LA NORTE DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE ALTADENA No. 23, COLONIA



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN, COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERÓN NO TENER ALGUNO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS 19:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA, AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA O CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	NOMBRE	FIRMA
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	LIC. RAFAEL DE VILLA ARPÓN	
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. JUAN MERCADILLO AGUILAR SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS	
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN	
POR PARTE DE LA CONTRALORIA CIUDADANA	MARIA DEL CARMEN YONG CRUZ	



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

ÁREA O CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	NOMBRE	FIRMA
POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ESTA SECRETARÍA DE SALUD	C.P. EVA RODRÍGUEZ SORIANO REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	DRA. ALEJANDRA CERVANTES JIMÉNEZ RESPONSABLE DEL PROGRAMA	
POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ESTA SECRETARÍA DE SALUD	LIC. JULIA STEFANY JOSÉ MARTÍNEZ REPRESENTANTE	

LICITANTES


PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTADA POR	FIRMA
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS REYES MADRID	
VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V.	ALMA ROBLES CERVANTES	
ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	ANA LUISA GARCÍA ARANGO	
MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	DANIEL MONROY PÉREZ	
AMPHARMA, S.A. DE C.V.	TAYDE ZARATE NARVÁEZ	
KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE C.V.	GINA AGASSINI TÉLLEZ	
SUMINISTROS MÉDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ADRIANA ZARAGOZA RAMÍREZ	
DISEÑO DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	JULIAN MACÍAS LIZAOLA	



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LIDIA ALMARAZ PEÑA	
--	--------------------	--


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA"



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".


ANEXO 19
PROPUESTA ECONÓMICA
"SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS"

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
ÚNICA	1	3993	SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	SERVICIO	1			
	2		HEMODIÁLISIS POR PRIMERA VEZ	PROCEDIMIENTOS	1			
	3		HEMODIÁLISIS SUBSECUENTES	PROCEDIMIENTOS	1			
	4		DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE (DPI). DIÁLISIS PERITONEAL CON MÁQUINA EN DOMICILIO (DPA). DIÁLISIS PERITONEAL MANUAL EN DOMICILIO (DPCA).	PROCEDIMIENTOS	1			
	5			PROCEDIMIENTOS	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	6	3993-0010	DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE AUTOMATIZADA (DPIA)	PROCEDIMIENTOS	1			
	7	3993-0010	DPA CON ICODEXTRINA	PROCEDIMIENTOS	1			
	8	3993-0010	DPCA CON ICODESTRINA	PROCEDIMIENTOS	1			
						SUBTOTAL		
						I.V.A.		
						TOTAL		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS


SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	PRESUPUESTO MÍNIMO A EJERCER	PRESUPUESTO MÁXIMO A EJERCER
1	\$4,500,000.00	\$ 45,000,000.00

- IMPORTES EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) CONSIDERANDO ÚNICAMENTE DOS DECIMALES PARA SU CÁLCULO (REDONDEO)
- LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO
- SE ACEPTAN LAS CONDICIONES DE PAGO, CONFORME AL PLAZO Y PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"
- ESTA PROPUESTA ECONÓMICA TIENE UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE DE "EL LICITANTE", APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA	
R F C DE "EL LICITANTE":	





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

ANEXO "A"
ANEXO 19
PROPUESTA ECONÓMICA
"SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA"

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	1	3993-0010	AGUA DE PUNCIÓN TIPO SELDINGER 7CM 18G o 20G	PIEZA	1			
	2	3993-0010	AGUA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS DE UNA SOLA PIEZA PARED DELGADA Y BISEL CORTEO LONG 7 CM CAL. 18 G. PARA GUÍA DE 0.032 PULG A 0.038 PULG	PIEZA	1			
ÚNICA	3	3993-0010	BALÓN CON ATEROTOMOS FLEXIBLES DE 5MM LONGITUD Y 0.004" DE SEPARACIÓN ENTRE ATEROTOMOS. EN LONGITUDES DE BALÓN 6MM, 10MM Y 15MM Y DIÁMETROS DE 2.0MM A 4.0MM	PIEZA	1			
	4	3993-0010	BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN AORTICA DE 30, 40 Y 50 CM DE LONG	PIEZA	1			
	5	3993-0010	BALÓN MEDICADO CON PACITAXEL DE DIVERSOS DIAM Y LONG	PIEZA	1			
	6	3993-0010	BALÓN PARA VALVULOPLASTIA AORTICA O PULMONAR DE DIVERSOS DIAM Y MEDIDAS	PIEZA	1			




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS


SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIALISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	7	3993-0010	CATÉTER BALÓN NO COMPLACIENTE CON SISTEMA SOBRE LA GUÍA 0.035". LONGITUD UTILIZABLE DE 135 CM. CONSTA DE UN CUERPO O EJE DE TRIPLE LUMEN O TRIAXIAL; DOS MARCADORES RADIOPACOS, EXTREMO DISTAL CON UN BALÓN CERRADO CON PRESIÓN DE RUPTURA DE 24 ATMÓSFERAS. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 3.0 A 12 MM Y LONGITUD DEL BALÓN HASTA 200 MM.	PIEZA	1			
	8	3993-0010	CABLES DE MARCAPASO TRANSITORIO	PIEZA	1			
	9	3993-0010	CATÉTER ANGIOGRÁFICO con CURVA HN1	PIEZA	1			
	10	3993-0010	BALON NO COMPLACIENTE PARA ANGIOPLASTIA ACTP CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, PERFIL DE CRUCE DE 0.017", TECNOLOGÍA DE SHAFT BI SEGMENTO, EN MATRIZ DE MEDIDAS DE 6MM A 30 X 2.MM A 5.0MM. COMPATIBLE CON GUÍA 0.014"	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIALISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	11	3993-0010	BALON PARA ANGIOPLASTIA ACTP CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, PERFIL DE CRUCE DE 0.017", TECNOLOGÍA DE SHAFT BI SEGMENTO, EN MATRIZ DE MEDIDAS DE 8MM A 30 X 1.20MM A 4.0MM. COMPATIBLE CON GUIA 0.014"	PIEZA	1			
	12	3993-0010	CATÉTER BALÓN CON SISTEMA SOBRE LA GUÍA O INTERCAMBIO RÁPIDO 0.014" Y PERFIL DE ENTRADA 0.017". LONGITUD UTILIZABLE DE 150 CM. CONSTA DE UN CUERPO O EJE DE DOBLE LUMEN O COAXIAL; DOS MARCADORES RADIOOPACOS, EXTREMO DISTAL CON UN BALÓN CERRADO CON PRESIÓN DE INFLADO DE 8 ATMÓSFERAS Y PRESIÓN DE RUPTURA DE 14 ATMÓSFERAS. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 1.5 A 4.0 MM Y LONGITUD DEL BALÓN HASTA 220 MM. BAJO PERFIL: 4 F	PIEZA	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	13	3993-0010	EQUIPO RECUPERADOR INTRAVASCULAR DE ASA CONSTA DE CATETER TIPO SANARE O CANASTILLA Y GUIA METALICA CON PUNTA EN ASA LONGITUD TOTAL DEL SISTEMA 120 CM CALIBRE DEL CATETER 4 FR Y LA PUNTA EN ASA DE 10 MM ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	1			
	14	3993-0010	CATETER DE EXTRACTOR DE TROMBOS PULMONARES CON SISTEMA DE SUCCION MECANICA	PIEZA	1			
	15	3993-0010	CATETER PARA ASPIRACION DE TROMBOS CORONARIOS CON PUNTA DE DISEÑO ATRAUMATICO, COMPATIBLE CON SISTEMA RAPIDO INTERCAMBIO DE GUIA 0.014 PULGADAS, PARA UTILIZARSE CON CATETER GUIA 6 FR, AREA DEL LUMEN DE ASPIRACION DE 0.55 MM, PERFIL DE CRUCE DE 0.053 PULGADAS, LONGITUD 140 CM, RECUBRIMIENTO HIDROFILICO INCLUYE 2 JERINGAS CON SISTEMA DE BLOQUEO DE VACIO DE 30 ML CADA UNA Y UN FILTRO PARA LA VISUALIZACION DE LOS TROMBOS ASPIRADOS	PIEZA	1			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS


SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
16	3993-0010	CATETER GUIA RADIOPACO RADIAL PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON ASA DE 3.0 A 5.00 MM, RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, 7 CM DISTALES SIN RECUBRIMIENTO, PUNTA RADIOPACA Y ATRAUMATICA DE 1.5 5 FR X LONG 100CM. CON DIAMETRO INTERNO DE 0.058"	PIEZA	1				
17	3993-0010	CATETER GUIA RADIOPACO FEMORAL PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON ASA DE 3.0 A 5.00 MM, RECUBRIMIENTO PTFE, ENMALLADO DE 2X2, PUNTA RADIOPACA Y ATRAUMATICA, DIAM 6FR, 7Fr y 8Fr, LONG 100CM. CON DIAMETROS INTERNOS DE 0.070", 0.081" Y 0.091" RESPECTIVAMENTE.	PIEZA	1				
18	3993-0010	CATETER DIAGNOSTICO FEMORAL MULTIPROPOSITO A2. 5 Y 6 FR. DIAM INT 0.047" Y 0.056", LONG. 100 CM., RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, PUNTA ATRAUMATICA, ENMALLADO 2X2.	PIEZA	1				



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	19	3993-0010	CATETER GUIA RADIOPACO FEMORAL MULTIPROPOSITO A2 PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA, RECUBRIMIENTO PTFE, ENMALLADO DE 2X2, PUNTA RADIOPACA Y ATRAUMATICA, DIAM 6FR, LONG 100CM. CON DIAMETROS INTERNOS DE 0.070"	PIEZA	1			
	20	3993-0010	CATETER DIAGNOSTICO FEMORAL PIGTAIL 145 GRADOS, 5 Y 6 FR. DIAM INT 0.047" Y 0.056", LONG 110 CM., RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, PUNTA ATRAUMATICA, ENMALLADO 2X2.	PIEZA	1			
	21	3993-0010	CATETER DIAGNOSTICO FEMORAL DIVERSAS CURVAS, 5 Y 6 FR. DIAM INT 0.047" Y 0.056", LONG 100 A 125 CM., RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, PUNTA ATRAUMATICA, ENMALLADO 2X2.	PIEZA	1			
	22	3993-0010	COIL FIBRADO 3D DE LIBERACION MECANICA CONTROLADA PARA EMBOLIZACION ENDOVASCULAR CON SISTEMA RECUPERABLE ESTERIL Y DESECHABLE DIVERSAS MEDIDAS Y LONGITUDES	PIEZA	1			
	23	3993-0010	SISTEMA DE LIBERACION DE ESPIRALES DE PLATINO DESPRENDIBLES TERMOMECHANICAMENTE	PIEZA	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	24	3993-0010	ESPIRAL DESPRENDIBLE CON DISEÑO 3D PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR, FABRICADO DE PLATINO-TUGSTENO Y FIBRAS INTERNAS DE POLIPROPILENO CON SISTEMA DE LIBERACION MECANICO VARIAS MEDIDAS DISPONIBLES	PIEZA	1			
	25	3993-0010	CONECTOR EN Y PARA CATÉTERES DE ANGIOPLASTIA	PIEZA	1			
	26	3993-0010	INSUFLADOR DE BALON ANGIOPLASTIA DE 20 CC Y MEDIDOR FLUORESCENTE 20 ATM.	PIEZA	1			
	27	3993-0010	VALVULA HEMOSTATICA, DISPOSITIVO DE TORQUE E INSERTOR DE GUIA	PIEZA	1			
	28	3993-0010	JERINGA DE PLÁSTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATÉTER DE DILATACIÓN DE ARTERIAS CORONARIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESIÓN. CON CAPACIDAD DE 20 CC Y 26 ATM	PIEZA	1			

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS


SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	29	3993-0010	CONTENEDOR DE MEDIO DE CONTRASTE CON CAPACIDAD DE 100ML. PUERTO DE ENTRADA CON ESPIGA PARA BOTELLA DE MEDIO DE CONTRASTE Y PUERTO DE SALIDA CON CONEXIÓN LUER DE ALTA PRESIÓN. ESTÉRIL, DESECHABLE, PARA UTILIZARSE CON HASTA 5 PACIENTES CONSECUTIVOS EN UN PERIODO DE 12 HORAS. COMPATIBLE CON EL SISTEMA INYECTOR ACIST CVI.	PIEZA	1			
	30	3993-0010	KIT DE MANIFOLD AUTOMATIZADO, CON DOMO DE PRESIÓN PARA COMPATIBLE CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN REUSABLE, ESPIGA PARA BOLSA DE SOLUCIÓN SALINA Y CONECTOR DE ALTA PRESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO DE CONTRASTE. ESTÉRIL, DESECHABLE, UN SOLO USO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA INYECTOR ACIST CVI.	PIEZA	1			

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	31	3993-0010	KIT DE CONTROLADOR MANUAL NEUMÁTICO CON BOTONES DE CONTRASTE Y DE SOLUCIÓN SALINA, AMBOS SENSIBLES A LA PRESIÓN MANUAL DEL OPERADOR. INCLUYE TAMBIÉN EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN DE 1.37CM DE LONGITUD Y CONECTORES LUER EN AMBOS EXTREMOS, Y LLAVE DE 3 VÍAS DE ALTA PRESIÓN CON EXTREMO GIRATORIO LUER LOCK. ESTÉRIL, UN SOLO USO, DESECHABLE. COMPATIBLE CON EL SISTEMA INYECTOR ACIST CVI.	PIEZA	1			
	32	3993-0010	CATÉTER CON BALÓN DISEÑADA PARA CRUZAR LAS OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS. TRAZABILIDAD MEJORADA. PROCESO DE DOBLAJE DE 2 PLIEGUES MEJORADO. PUNTA BLANDA ULTRA-BAJA, DE 0.016" Y PERFIL DE CRUCE 0.021". SISTEMA SOBRE LA GUÍA. DIÁMETRO DEL GLOBO: 1.00 MM LONGITUD DEL GLOBO: 8.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00 MM	PIEZA	1			
	33	3993-0010	LÁPIZ DESECHABLE CON CONTROL DE CORTE Y COAGULACIÓN PARA ELECTROCAUTERIO	PIEZA	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	34	3993-0010	PLACAS DOBLES DESECHABLE DOBLE ÁREA PARA ELECTROCAUTERIO	PIEZA	1			
	35	3993-0010	CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA PARA CATÉTER CON PUNTA ANGULADA O RECTA, DIAM DE 0.035, LONG 150 Y 260	PIEZA	4			
	36	3993-0010	CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DIVERSOS SOPORTES Y PUNTAS VARIADAS. DIAM 0.014 LONG 182 CM Y 300 CM	PIEZA	1			
	37	3993-0010	CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DIVERSOS SOPORTES Y PUNTAS VARIADAS. DIAM 0.014 LONG 185 CM Y 300 CM	PIEZA	1			
	38	3993-0010	GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE PUNTA RECTA CON PUNTA RADIOPACA DE 0.014" LONGITUD 182CM DEL TIPO EXTRASSUPPORT, INTERMEDIA, FLOPPY Y PT CHOICE EXTRA SUPPORT	PIEZA	1			
	39	3993-0010	GUÍA AMPLATZ SUPER STIFF DE 0.035 PUNTA EN "J" DE 260 CMS.	PIEZA	1			
	40	3993-0010	CUERDA GUÍA 0.018 O 0.014 PULGADAS PUNTA RECTA CON ALTO GRAMAJE EN LA PUNTA DE 12 G A 30 G LONGITUD 300 CM	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	41	3993-0010	GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) PARAV CATETER CON PUNTA "J" DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 195 CM A 300 CMS DE LARGO. FORMA DE PUNTA DISTAL RADIOPACA EN FORMA DE DOMO O CUÑA, PARA OCLUSIONES TOTALES.	PIEZA	1			
	42	3993-0010	CUERDA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD 300 CM, DIÁMETRO 0.018 PULGADAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	1			
	43	3993-0010	CATETER DE SOPORTE COMPATIBLE CON SISTEMA 0.035, 0.018 Y 0.014 PULGADAS Y LONGITUD DE TRABAJO DE 90 Y 150 CM, TRES MARCAS RADIOPACAS DISTALES DE PLATINO CADA 5 CM.	PIEZA	1			
	44	3993-0010	CUERDA GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATÉTER CON PUNTA RECTA O EN "J" DE 3 MM, DIAM DE 0.035, LONG 150 Y 260 CM	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	45	3993-0010	DESFIBRILADOR BICAMERAL CARDIOVERSOR AUTOMÁTICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. AL MENOS 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA EL DIFERENCIAMIENTO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES DE LAS VENTRICULARES, LONGEVIDAD MINIMA DE 6 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR. AL MENOS 72 MIN DE MEMORIA PARA ELECTROGRAMAS. CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACION REMOTA AUTOMÁTICA DE PACIENTE. CONECTORES IS-1/DF-4 PARA ELECTRODOS.	PIEZA	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	46	3993-0010	DESFIBRILADOR UNICAMERAL CARDIOVERSOR AUTOMÁTICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. CON ADAPTACIÓN DE FRECUENCIA. LONGEVIDAD MÍNIMA DE 10 AÑOS A PARÁMETROS ESTÁNDAR. MEMORIA PARA ELECTROGRAMAS. CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACIÓN REMOTA AUTOMÁTICA DE PACIENTE. CONECTORES DF-1 PARA ELECTRODOS. CON MONITORIZACIÓN DE LÍQUIDO PULMONAR.	PIEZA	1			




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS


SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	47	3993-0010	DESFIBRILADOR UNICAMERAL CON SENSADO AURICULAR CARDIOVERSOR AUTOMÁTICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. AL MENOS 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA EL DIFERENCIAMIENTO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES DE LAS VENTRICULARES, ASÍ COMO 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA LA ADAPTACION DE LA FRECUENCIA. CON ALGORITMO ACTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE FA. LONGEVIDAD MÍNIMA DE 9 AÑOS A PARÁMETROS ESTÁNDAR. AL MENOS 72 MIN DE MEMORIA PARA ELECTROGRAMAS. CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACIÓN REMOTA AUTOMÁTICA DE PACIENTE. CONECTORES IS-1/DF-1 PARA ELECTRODO. CON MONITORIZACIÓN DE LÍQUIDO PULMONAR. COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA.	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	48	3993-0010	DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA, CON DEFIBRILADOR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, MEDICIO AUTOMÁTICA DEL UMBRAL DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CAPACIDAD DE CARGAR 40J DE ENERGÍA MÁXIMA, CAPACIDAD DE ENTREGAR MAS DE 6 CHOQUES POR ZONA DE ARRITMIA, 3 VECTORES DISTINTOS PARA ENTREGA DE CHOQUE, CAPACIDAD DE ENTREGAR TERAPIA ANTICARDIA EN ZONA DE FV, CON ALGORITMOS ESPECIALES PARA LA DISCRIMINACION DE TSV Y TV, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION PARA EL VENTRICULO IZQUIERDO, CON LONGEVIDAD MÍNIMA DE 6.6 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO.	PIEZA	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	49	3993-0010	DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA ENERGÍA DE ESTIMULACIÓN EN LAS TRES CÁMARAS, CON HISTÉRESIS NEGATIVA AV, 6 DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACIÓN PARA EL VENTRÍCULO IZQUIERDO, CON LONGEVIDAD MÍNIMA DE 8 AÑOS CON ESTIMULACIÓN 100 % BIVENTRÍCULAR, CON MONITORIZACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO, COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA	PIEZA	1			
	50	3993-0010	ENGRAPADORAS DE PIEL	PIEZA	1			
	51	3993-0010	KIT DE DENERVACIÓN, QUE INCLUYE BALÓN PARA DERIVACIÓN DE 4, 5, 6 O 7 CM X 25 MM, CATÉTER GUÍA 8 FR, GUÍA DE 0.018, INTRODUCTOR, INCLUYE EQUIPO PARA DENERVACIÓN	PIEZA	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	52	3993-0010	EQUIPO PARA ATEROTOMIA ROTACIONAL (INCLUYE: GUIAS ,AVANZADOR, OLIVAS DE PUNTA DE DIAMANTE DE DIVERSOS DIAMETROS Y CONSOLA CON PEDAL, Y CABLES CONECTORES)	PIEZA	1			
	53	3993-0010	EXTENSION DE CATÉTER GUÍA CORONARIOS COAXIALES, SISTEMA 5 EN 6 FR. HIDROFÍLICO, DIAM INT. 0.057", 25 CM DE SEGMENTO DE CATETER GUÍA, 120 CM DE HIPOTUBO. ENMALLADO 1 A 1, CINTURON DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1			
	54	3993-0010	CATETER EXTRACTOR DE TROMBOS INTRACARDIACOS DE 6 FR Y 7 FR	PIEZA	1			
	55	3993-0010	FILTRO DE VENA CAVA FEMORAL O YUGULAR	PIEZA	1			
	56	3993-0010	FILTRO DE PROTECCION DISTAL	PIEZA	1			
	57	3993-0010	FRASCO DE MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO DE 100 ML.	PIEZA	1			




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS


SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	58	3993-0010	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO, FEMORAL POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONG 11 CM, DE 4 A 9 FR. QUE INCLUYE INTRODUCTOR, DILATADOR Y GUIA ANGIOGRAFICA.	PIEZA	1			
	59	3993-0010	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO, RADIAL POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONG VARIABLE DE 4 A 11 FR.	PIEZA	1			
	60	3993-0010	INTRODUCTOR LARGO O VAINA TIPO MULLINS DE 7 A 12 FR	PIEZA	1			
	61	3993-0010	INTRODUCTORES LARGOS DE 23 A 90 CM DE DIVERSOS TIPOS Y MATERIALES	PIEZA	1			
	62	3993-0010	JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFIA DE 100 MM A 150 MM DE CAPACIDAD	PIEZA	1			
	63	3993-0010	JERINGA DE CONTROL DE 12 C	PIEZA	1			
	64	3993-0010	KIT DE ROPA QUIRÚRGICA, QUE INCLUYE, BATA, ROPA PARA CIRUGÍA, CUBRE CALZADO, CAMPOS ESTÉRILES, TOALLAS Y SABANAS. PRODUCTO DESECHABLE Y DE UN SOLO USO	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	65	3993-0010	MARCAPASO BICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE DOBLE CAMARA PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, CON FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO. CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y MEDICION DEL UMBRAL DE ESTIMULACION. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 10 AÑOS.	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	66	3993-0010	MARCAPASO UNICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, CON FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE; CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO. CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y DEL VOLTAJE DE SALIDA. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 15 AÑOS.	PIEZA	1			
	67	3993-0010	MICROCATÉTERES DE DIVERSOS TAMAÑOS Y FORMAS VARIADAS	PIEZA	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	68	3993-0010	SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO, CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, DE DOBLE DISCO AUTOCENTRANTE Y CUERPO ARTICULADO SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO, GUIA DE INTERCAMBIO 0.035 PULGADAS X 260 CM DE ALTO SOPORTE Y PUNTA EN "J", CON SEGMENTO SUAVE DE 1.5 CM, OCLUSORES DIAMETROS DE 3 A 6 MM EN INCREMENTOS DE 1 MM, LONGITUDES DE 4 O 6 MM	PIEZA	1			

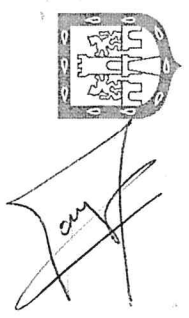


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	69	3993-0010	SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTANEO DEL FORAMEN OVAL PERMEABLE (PFO), CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y CUBIERTA INTERNA DE POLIESTER, DE DOBLE DISCO, CON MARCAS RADIOOPACAS PROXIMAL Y DISTAL SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO, GUÍA DE INTERCAMBIO 0.035 PULGADAS X 260 CM DE ALTO SOPORTE Y PUNTA EN "J" CON SEGMENTO SUAVE DE 1.5 CM, OCLUSORES DIAMETROS 18, 25 MM, COMPATIBLES CON CAMISA DEL SISTEMA LIBERADOR DE 8 FR, OCLUSOR 35 MM COMPATIBLE CON SISTEMA LIBERADOR 9 FR	PIEZA	1			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	70	3993-0010	OCCLUSOR PARA EL CIERRE DE LA COMUNICACION INTERAURICULAR CON DOBLE DISCO DE MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL CON SISTEMA DE LIBERACION TIPO FORCEPS Y PARCHES INTERNOS DE POLIESTER MEDIDA DE 26 MM NOMINAL CON CAMISA LIBERADORA 12 FR E INTRODUTOR 12 FR (OCCLUSOR PARA CIERRE PERCUTANEO DE CIA).	PIEZA	1			




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	71	3993-0010	SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTANEO DE LA COMUNICACION INTER-AURICULAR (CIA), CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y CUBIERTA INTERNA DE POLIESTER DE DOBLE DISCO AUTOCENTRANTE CON MARCAS RADIOOPACAS PROXIMAL Y DISTAL, SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO, BALON DE MEDICION DE ELASTOMERO DE SILICON Y PLACA DE MEDICION CON ORIFICIOS CIRCULARES DE 4 A 38 MM GUIA DE INTERCAMBIO 0.035" X 260 CM DE ALTO SOPORTE Y PUNTA EN "J" CON SEGMENTO SUAVE DE 1.5 CM, OCLUSORES DIAMETROS DE 4 A 20 MM EN INCREMENTOS DE 1 MM Y DE 22 A 40 MM EN INCREMENTOS DE 2 MM COMPATIBLES CON CAMISA DEL SISTEMA LIBERADOR DE 7 A 12 FR MAXIMO	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	72	3993-0010	SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTANEO DE LA COMUNICACION INTER-VENTRICULAR MUSCULAR POST-INFARTO (CIV MUSCULAR) CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y CUBIERTA INTERNA DE POLIESTER, DE DOBLE DISCO AUTOCENTRANTE, CON MARCAS RADIOPACAS PROXIMAL Y DISTAL, SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO, GUIA DE INTERCAMBIO 0.035 PULGADAS X 260 CM DE ALTO SOPORTE Y PUNTA EN "J", SISTEMA LIBERADOR DE 10 FR	PIEZA	1			
	73	3993-0010	OCLUSORES TIPO PLUG IN DE DIFERENTES TAMAÑOS	PIEZA	1			
	74	3993-0010	PIEZA DE DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE DE PUNCIÓN ARTERIAL DE COLÁGENO DE 6 A 8 FR. DE 13 CM	PIEZA	1			
	75	3993-0010	BANDA DE COMPRESION RADIAL	PIEZA	1			
	76	3993-0010	MANIFOLD DE 3 VIAS Y EXTREMO OPUESTO CON SALIDA HEMBRA.	PIEZA	1			



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIALISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	77	3993-0010	EXTENSION DE ALTA PRESION PARA HEMODINAMICA 100 CM	PIEZA	1			
	78	3993-0010	SONDA DE FIBRA ÓPTICA PARA ULTRASONIDO, 5 FR. PERFIL DE CRUCE DE 1.05 MM, HIDROFILICA, RESOLUCION DE 38 MICRONES. TRANSDUCTOR ROTACIONAL, FRECUENCIA 40 MHZ, 10 CM DE SHAFT TELECOPICO GRADUADO, 2 CM DE DISTANCIA DE LA PUNTA AL TRANSDUCTOR.	PIEZA	1			
	79	3993-0010	SONDA INTRACORONARIA PARA LA ADQUISICION DE IMAGENES MEDIANTE TOMOGRFIA DE COHERENCIA OPTICA, SE REQUIERE LONGITUD DE 135 CM UTILES DE UN DIAMETRO DE 2.7 FR Y QUE SEA MEDIANTE FIBRA OPTICA Y QUE TRABAJE MEDIANTE SISTEMA WIRE BOX INALAMBRICO (INCLUYE FUNDA PARA PULL BACK Y EQUIPO)	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	80	3993-0010	STENT CORONARIO DE ACERO INOXIDABLE 316L, CUBIERTO DE PERICARDIO EQUINO TRATADO. MONTADO EN CATÉTER BALÓN RÁPIDO INTERCAMBIO COMPATIBLE CON GUÍA 0.014" Y CON CATÉTER GUÍA 6F. LONGITUD DE TRABAJO DEL CATÉTER 140 CM. DIVERSAS MEDIDAS Y LONGITUDES.	PIEZA	1			
	81	3993-0010	STENT CON MICROMALLA DE PET	PIEZA	1			
	82	3993-0010	STENT CORONARIO ESTRUCTURA DE CROMO-PLATINO, DISEÑO TUBULAR CON POLÍMERO DURABLE DIAM DE 2.25 A 4 MM, LONG DE 8 -38 MM, MEDICADO.	PIEZA	1			
	83	3993-0010	STENT DE ALEACION CROMO COBALTO O NITINOL AUTOEXPANDIBLE PARA ANGIOPLASTIA FEMORAL Y/O ILIACA AUTOEXPANDIBLE, 8 MARCAS RADIOPACAS, SISTEMA PARA GUÍA 0.035"	PIEZA	1			




SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
84	3993-0010	STENT CORONARIO ESTRUCTURA DE CROMO- PLATINO, DISEÑO TUBULAR CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE DIAM DE 2.25 A 4 MM, LONG DE 8-38 MM, MEDICADO	PIEZA	1				
85	3993-0010	STENT CORONARIO DESNUDO, ESTRUCTURA DE CROMO-PLATINO, DISEÑO TUBULAR DIAM DE 2.25 A 4.5 MM, LONG DE 8-32 MM.	PIEZA	1				
86	3993-0010	ENDOPRÓTESIS DE ALEACIÓN CROMO COBALTO O NITINOL AUTOEXPANDIBLE PARA ANGIOPLASTIA FEMORAL Y/O ILIACA DISEÑO DE CELDA DUAL CON CELDAS CERRADA EN LOS EXTREMOS PROXIMAL Y DISTAL Y CELDA ABIERTAS EN EL CENTRO, 8 MARCAS RADIOPACAS, SISTEMA DE 130 CM DE LARGO PARA GUÍA 0.035". DIÁMETRO: 5 A 8.0 MM. LONGITUD: 20 MM A 200 MM, BAJO PERFIL 6F	PIEZA	1				
87	3993-0010	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INTRACAVITARIA DESECHABLE	PIEZA	1				
88	3993-0010	KIT DE ACCESO TRANSEPTAL	PIEZA	1				



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	SUBPARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	89	3993-0010	DISPOSITIVO PARA CIERRE DE OREJUELA DE AURÍCULA IZQUIERDA CON MARCO AUTO- EXPANDIBLE DE NITINOL, RECUBRIMIENTO PERMEABLE DE PET DE 160 MICRONES Y ANCLAS DE FIJACIÓN, PRE-MONTADO EN SISTEMA DE LIBERACIÓN 12F CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA. EN MEDIDAS DE 21MM A 33 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ACCESO PARA DISPOSITIVO DE CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA CON DILATADOR, CATÉTER DE PEBAX CON TRES MARCAS PROXIMALES DE PLATINO-IRIDIO Y UNA MARCA DISTAL, DIÁMETRO INTERNO 12F Y EXTERNO DE 14F, 75CM DE LONGITUD. EN CURVA SENCILLA Y CURVA DOBLE.	PIEZA	1			
								SUBTOTAL
								I.V.A.
								TOTAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-010-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA".

PARTIDA	PRESUPUESTO MÍNIMO A EJERCER	PRESUPUESTO MÁXIMO A EJERCER
2	\$4,321,252.90	\$43,212,529.00

- IMPORTES EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) CONSIDERANDO ÚNICAMENTE DOS DECIMALES PARA SU CÁLCULO (REDONDEO)
- LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO
- SE ACEPTAN LAS CONDICIONES DE PAGO, CONFORME AL PLAZO Y PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"
- ESTA PROPUESTA ECONÓMICA TIENE UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE DE "EL LICITANTE", APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DE "EL LICITANTE".

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 30001122-010-19

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
1	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	1	PARTIDA 7	SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS CONFIRMEN QUE SE REQUIERE BALONES DE DOBLE LUMEN, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION	SE REQUIERE UN BALON CON DOBLE LUMEN UN LUMEN POR DONDE VA LA GUIA 0.014 Y OTRO POR DONDE SE INFLA EL BALON	Hemodinamica Partida 2
2	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	2	PARTIDA 18	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL CATETER DIAGNOSTICO DE 5 FR CON UN DIAMETRO INTERNO DE 0.041", LO CUAL PERMITE EL MEJOR TRANSITO DE LOS INSTRUMENTOS DENTRO DEL CATETER.	SEREQUIERE LOS DOS 5 Y 6 FRENCH	Hemodinamica Partida 2
3	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	3	PARTIDA 18	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DIAGNOSTICO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, LO CUAL NO GENERA UN RESULTADO DISTINTO DURANTE EL PROCEDIMIENTO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinamica Partida 2
4	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	4	PARTIDA 20	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL CATETER DIAGNOSTICO DE 5 FR CON UN DIAMETRO INTERNO DE 0.045", LO CUAL PERMITE EL MEJOR TRANSITO DE LOS INSTRUMENTOS DENTRO DEL CATETER.	ES IMPORTANTE TENER TANTO 5 FRENCH COMO 6 FRENCH	Hemodinamica Partida 2
5	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	5	PARTIDA 20	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DIAGNOSTICO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, LO CUAL NO GENERA UN RESULTADO DISTINTO DURANTE EL PROCEDIMIENTO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinamica Partida 2
6	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	6	PARTIDA 21	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL CATETER DIAGNOSTICO DE 5 FR CON UN DIAMETRO INTERNO DE 0.045", LO CUAL PERMITE EL MEJOR TRANSITO DE LOS INSTRUMENTOS DENTRO DEL CATETER.	SEREQUIEREN LOS DOS 5 Y 6 FRENCH	Hemodinamica Partida 2
7	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	7	PARTIDA 21	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DIAGNOSTICO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, LO CUAL NO GENERA UN RESULTADO DISTINTO DURANTE EL PROCEDIMIENTO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinamica Partida 2
8	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	8	PARTIDA 24	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESPIRAL DESPRENDIBLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS PERO CON FIBRAS INTERNAS DE DRACRON, LAS MISMAS FAVORECEN EL RECLUTAMIENTO CELULAR EN UN MENOR TIEMPO, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SISE PERMITE	Hemodinamica Partida 2
9	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	9	PARTIDA 25	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN KIT, QUE INCLUYA INSUFLADOR, LLAVE EN "Y", INTRODUCIDOR DE GUIA Y ROTADOR, LO MISMO AYUDARÁ AL MANEJO DEL INVENTARIO Y A CONTAR CON TODOS LOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO KIT. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinamica Partida 2
10	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	10	PARTIDA 27	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN KIT, QUE INCLUYA INSUFLADOR, LLAVE EN "Y", INTRODUCIDOR DE GUIA Y ROTADOR, LO MISMO AYUDARÁ AL MANEJO DEL INVENTARIO Y A CONTAR CON TODOS LOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO KIT. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinamica Partida 2



Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
11	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	11	PARTIDA 28	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN KIT, QUE INCLUYA INSUFLADOR, LLAVE EN "Y", INTRODUCIDOR DE GUIA Y ROTADOR, LO MISMO AYUDARÁ AL MANEJO DEL INVENTARIO Y A CONTAR CON TODOS LOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO KIT. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinamia Partida 2
12	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	12	PARTIDA 32	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MICRO DILATACIÓN CON BALÓN DE 1.2 x 12.0mm. CON UN ESPIRAL DE ACERO INOXIDABLE CON VAINA DE POLÍMERO EN EL CUERPO PROXIMAL DEL CATÉTER. LA PUNTA DEL CATÉTER ES CÓNICA PARA FACILITAR SU AVANCE HACIA LA ESTENOSIS. PUNTA BLANDA ULTRA-BAJA, DE 0.017" Y PERFIL DE CRUCE 0.024". SISTEMA SOBRE LA GUÍA. RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE PERMITE	Hemodinamia Partida 2
13	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	13	PARTIDA 41	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 0.014 CON POCO GRAMAJE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA EN LA PARTE DISTAL PARA NAVEGAR Y CRUZAR Y CON CUBIERTA HIDROFÓLICA EN LO PROXIMAL PARA BUEN EMPUJE Y TÁCTO?	SISE PERMITE	Hemodinamia Partida 2
14	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	14	PARTIDA 41	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LO REQUERIDO EN ESTE PUNTO ES UNA GUÍA DE 0.014" DE ALTO GRAMAJE. EN CASO DE SER ESTE EL CASO, SOLICITAMOS NOS INDIQUE EL GRAMAJE REQUERIDO.	SISE REQUIEREN GUIAS 0.014 CON VARIOS GRAMAJES, 2 A 12 GRAMOS	Hemodinamia Partida 2
15	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	15	PARTIDA 43	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MARCAS RADIOOPACAS A 5 CM PARA LOS SISTEMAS DE 0.035", Y A 1.5 CM PARA LOS SISTEMAS DE 0.018 Y 0.014". SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD=	SI SE PERMITE	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
16	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	16	PARTIDA 45	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR BICAMERAL CON LOGEVIDAD DE 5.1 AÑOS Y SIN MONITOREO REMOTO? AL RESPECTO DEL MONITOREO REMOTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE CONSIDERAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO NIRMALATIBAN PERTHIBAN, ET AL. (2015) "REMOTEMONITORING OF IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DESFIBRILATORS" JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY VOL. 65, NO. 24, DOI: 10.1016/J.JACC.2015.04.029 EN EL QUE SE DETERMINA QUE EL USO DE MONITOREO REMOTO RESULTA EN UN INCREMENTO DE VISITAS A CONSULTORIO NO PROGRAMADAS , LA PROBABILIDAD DE DESCARGA DEL DISPOSITIVO ES SIMILAR CON EL USO Y SIN EL USO DEL MONITOREO Y LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD SOLO SON IMPACTADOS CUANDO SE REALIZA UN MONITOREO DIARIO DEL PACIENTE. TOMANDO EN CUENTA ESTOS FACTORES, SOLICITAMOS RECONSIDERAR EL COSTO-BENEFICIO DE LOS DISPOSITIVOS CON ESTAS CARACTERISTICAS.	SI SE PERMITE	Hemodinamia la Partida 2
17	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	17	PARTIDA 46	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR UNICAMERAL CON LOGEVIDAD DE 5.1 AÑOS Y SIN MONITOREO REMOTO? AL RESPECTO DEL MONITOREO REMOTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE CONSIDERAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO NIRMALATIBAN PERTHIBAN, ET AL. (2015) "REMOTEMONITORING OF IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DESFIBRILATORS" JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY VOL. 65, NO. 24, DOI: 10.1016/J.JACC.2015.04.029 EN EL QUE SE DETERMINA QUE EL USO DE MONITOREO REMOTO RESULTA EN UN INCREMENTO DE VISITAS A CONSULTORIO NO PROGRAMADAS , LA PROBABILIDAD DE DESCARGA DEL DISPOSITIVO ES SIMILAR CON EL USO Y SIN EL USO DEL MONITOREO Y LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD SOLO SON IMPACTADOS CUANDO SE REALIZA UN MONITOREO DIARIO DEL PACIENTE. TOMANDO EN CUENTA ESTOS FACTORES, SOLICITAMOS RECONSIDERAR EL COSTO-BENEFICIO DE LOS DISPOSITIVOS CON ESTAS CARACTERISTICAS.	SI SE PERMITE	Hemodinamia la Partida 2

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]

[Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page]

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
18	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	18	PARTIDA 48	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA "SMART DELAY" EN LUGAR DE LA CARACTERISTICA DE HISTERESIS NEGATIVA DE AV. ASIMISMO SOLICITAMOS SEA ELIMINADO EL REQUISITO DEL MONITOREO REMOTO, AL RESPECTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE CONSIDERAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO NIRMALATIBAN PERTHIBAN, ET AL. (2015) "REMOTE MONITORING OF IMPLANTABLE CARDIOVERTER- DEFIBRILATORS" JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY VOL. 65, NO. 24, DOI: 10.1016/J.JACC.2015.04.029 EN EL QUE SE DETERMINA QUE EL USO DE MONITOREO REMOTO RESULTA EN UN INCREMENTO DE VISITAS A CONSULTORIO NO PROGRAMADAS, LA PROBABILIDAD DE DESCARGA DEL DISPOSITIVO ES SIMILAR CON EL USO Y SIN EL USO DEL MONITOREO Y LOS INDICES DE MORTALIDAD SOLO SON IMPACTADOS CUANDO SE REALIZA UN MONITOREO DIARIO DEL PACIENTE. TOMANDO EN CUENTA ESTOS FACTORES, EL DEPTO. DEBE DE CONSIDERAR EL COSTO- BENEFICIO DE TENER DISPOSITIVOS CON ESTA SOLICITUD?	SE PERMITE SI ESTA TECNOLOGIA SMART DELAY ESTA PRESENTE EN EL EQUIPO DE RESINCRONIZACION CARDIACA CON DESFIBRILADOR ALQUE SE REFIERE ESTE RUBRO, PERO NO ES LIMITANTE	Hemodinam la Partida 2
19	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	19	PARTIDA 49	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA "SMART DELAY" EN LUGAR DE LA CARACTERISTICA DE HISTERESIS NEGATIVA DE AV. ASIMISMO SOLICITAMOS SEA ELIMINADO EL REQUISITO DEL MONITOREO REMOTO, AL RESPECTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE CONSIDERAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO NIRMALATIBAN PERTHIBAN, ET AL. (2015) "REMOTE MONITORING OF IMPLANTABLE CARDIOVERTER- DEFIBRILATORS" JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY VOL. 65, NO. 24, DOI: 10.1016/J.JACC.2015.04.029 EN EL QUE SE DETERMINA QUE EL USO DE MONITOREO REMOTO RESULTA EN UN INCREMENTO DE VISITAS A CONSULTORIO NO PROGRAMADAS, LA PROBABILIDAD DE DESCARGA DEL DISPOSITIVO ES SIMILAR CON EL USO Y SIN EL USO DEL MONITOREO Y LOS INDICES DE MORTALIDAD SOLO SON IMPACTADOS CUANDO SE REALIZA UN MONITOREO DIARIO DEL PACIENTE. TOMANDO EN CUENTA ESTOS FACTORES, EL DEPTO. DEBE DE CONSIDERAR EL COSTO- BENEFICIO DE TENER DISPOSITIVOS CON ESTA SOLICITUD?	SE PERMITE SI ESTA TECNOLOGIA SMART DELAY ESTA PRESENTE EN EL EQUIPO DE RESINCRONIZACION CARDIACA LA QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA OTROS COMPETIDORES	Hemodinam la Partida 2
20	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	20	PARTIDA 53	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HIPOTUBO DE LONGITUD 125 CM. Y CINTURON DE PLATINO-IRIO. DICHAS CARACTERISTICAS NO AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DURANTE EL PROCEDIMIENTO, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SISE PERMITE	Hemodinam la Partida 2
21	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	21	PARTIDA 65	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA "HISTERESIS DE FRECUENCIA NOCTURNA" EN LUGAR DE LA CARACTERISTICA DE HISTERESIS DE FRECUENCIA, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SISE PERMITE	Hemodinam la Partida 2

prosecuti	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
22	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	22	PARTIDA 66	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "NUESTRA TECNOLOGIA "HISTERESIS DE FRECUENCIA NOCTURA" EN LUGAR DE LA CARACTERISTICA DE HISTERESIS DE FRECUENCIA, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO CON UNA LONGEVIDAD PROMEDIO DE 10 AÑOS, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR 5 O 6 MARCAS RADIOPACAS SEGUN CORRESPONDA, ESTO PERMITE LA VISIBILIDAD DESEADA DEL DISPOSITIVO DURANTE EL IMPLANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR 5 O 6 MARCAS RADIOPACAS SEGUN CORRESPONDA, ESTO PERMITE LA VISIBILIDAD DESEADA DEL DISPOSITIVO DURANTE EL IMPLANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinam la Partida 2
23	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	23	PARTIDA 83	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR 5 O 6 MARCAS RADIOPACAS SEGUN CORRESPONDA, ESTO PERMITE LA VISIBILIDAD DESEADA DEL DISPOSITIVO DURANTE EL IMPLANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR 5 O 6 MARCAS RADIOPACAS SEGUN CORRESPONDA, ESTO PERMITE LA VISIBILIDAD DESEADA DEL DISPOSITIVO DURANTE EL IMPLANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinam la Partida 2
24	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	24	PARTIDA 86	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR 5 O 6 MARCAS RADIOPACAS SEGUN CORRESPONDA, ESTO PERMITE LA VISIBILIDAD DESEADA DEL DISPOSITIVO DURANTE EL IMPLANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR 5 O 6 MARCAS RADIOPACAS SEGUN CORRESPONDA, ESTO PERMITE LA VISIBILIDAD DESEADA DEL DISPOSITIVO DURANTE EL IMPLANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE	Hemodinam la Partida 2
25	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO S.A DE C.V.	25	PARTIDA 86	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR 5 O 6 MARCAS RADIOPACAS SEGUN CORRESPONDA, ESTO PERMITE LA VISIBILIDAD DESEADA DEL DISPOSITIVO DURANTE EL IMPLANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SISE PERMITE (PREGUNTA REPETIDA)	Hemodinam la Partida 2
26	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	1	4.6 PROPUESTAS.4.6.1PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA KK DEBERÁ PRESENTAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA CERTIFICADO ISO DE CALIDAD A NOMBRE DEL LICITANTE. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO DEL CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, QUE HAGA CONSTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX- CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 O ISO 9001:2015, QUE CONTEMPLE CUANDO MENOS EL SIGUIENTE ALCANCE: COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO O DE CURACIÓN DE ALTA ESPECIALIDAD O INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Y ADECUACIÓN FÍSICA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA CADA PARTICIPANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO 9001-2015 CON ALCANCE EN HEMODINAMIA A NOMBRE DEL LICITANTE.	Hemodinam la Partida 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
27	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	2	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA A PROPUESTA TÉCNICA IMPRESA, DE ACUERDO AL ANEXO 1 Y 1.1 QUE INDIQUE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS 3 Y 4, Y DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA ANEXO 2, Y PARA FINES DE REFERENCIACIÓN ACOMPAÑADAS DE SU CATÁLOGO ORIGINAL QUE CONTENGA LOS INSUMOS PROPUESTOS, EN EL SUPUESTO DE QUE ÉSTOS NO ESTÉN EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBERÁN ENTREGAR TRADUCCIÓN TÉCNICA AL ESPAÑOL, IDENTIFICANDO Y RESALTANDO O SUBRAYANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANTES MENTIONADAS EN EL CATÁLOGO. LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE EN HOJA MEMBRADA DE EL PROVEEDOR, EN EL CUAL (DE ACUERDO AL ANEXO 1.1) SE DEBERÁN DESCRIBIR, LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A UTILIZAR DEL ANEXO 3 ANOTANDO LA CLAVE (NÚM. DE REFERENCIA), DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, MARCA, E INDICAR EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS INSUMOS OFERTADOS; ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ REQUISITAR DEBIDAMENTE, Y MARCAR EL NÚMERO DEL MANUAL Y/O CATÁLOGO Y DE PÁGINA EN DONDE SE LOCALIZAN CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PROPONEN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE LOS CATÁLOGOS FICHAS TÉCNICAS, MANUALES ETC. SOLO SE PRESENTEN EN FORMATO DIGITAL EN UNA USB DEBIDAMENTE REFERENCIADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA	Hemodinamia la Partida 2
28	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	3	1. INFORMACIÓN GENERAL. 1.1 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. PARTIDA 1: SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARTIDA 2: SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SERVICIO CORRESPONDE LA PARTIDA 1 Y A QUE SERVICIO CORRESPONDE LA PARTIDA 2, YA QUE EN EL ANEXO 19 DE LA CONVOCATORIA, LA PARTIDA 1 CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y LA PARTIDA 2 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	SE DA RESPUESTA CON LA PRECISIÓN NUMERO 2.	Ambas

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
29	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	4	1. INFORMACIÓN GENERAL. 1.1 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. PARTIDA 1: SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARTIDA 2: SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ DE VENIR IDENTIFICADA HACIENDO REFERENCIA A LOS DOS SERVICIOS INTEGRALES: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-010-19 SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA O PODRÁ IDENTIFICAR DE LA SIGIENTE MANERA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-010-19 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL CASO DE PARTICIPAR SOLO PARA EL SER SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, ¿SERÍA AMABLE DE ACLARARNOS ESTA SITUACIÓN?	SE DA RESPUESTA CON LA PRECISIÓN NUMERO 2.	Ambas
30	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	5	4.2 MUESTRAS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 8 INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. SE SEÑALAN LA FORMA EN QUE SE PRESENTARÁ LAS MUESTRAS ENLISTADAS EN EL ANEXO 8 PARA SU EVALUACIÓN. DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES DEL 100% DE LOS RENGLONES SEÑALADOS EN EL DIA 15 DE ABRIL DE 2019, EN UN HORARIO DE 09:00 A LAS 12:00 HORAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS. EL	DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 8, ENTENDEMOS QUE SE DEBEN PRESENTAR MUESTRAS SOLO DEL LISTADO PREESTABLECIDO EN EL ANEXO 8 ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	ES CORRECTO	Hemodinam la Partida 2
31	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	6	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA O DEBERÁ ENTREGAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA PARA AL MENOS 4 PERSONAS COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO PARA COTEJO DEL TÍTULO Y/O CÉDULA PROFESIONAL EN CARRERAS MÉDICAS AFINES, ASÍ COMO COPIA DE DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA. EL CUAL NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	ES CORRECTO ENTENDER POR CARRERAS MÉDICAS AFINES: MÉDICOS CIRUJANOS, LICENCIADOS EN ENFERMERÍA O TÉCNICOS EN ENFERMERÍA? ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	SISON CARRERAS AFINES PERO SEREQUIERE QUE DEMUESTRE QUE ESTAN CAPACITADOS EN PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMICA	Hemodinam la Partida 2
32	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	7	ANEXO 2 FICHA TÉCNICA 2019 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Otras prescripciones aplicables al bien, arrendamiento o servicio: 2 El proveedor deberá proveer un médico especializado para realizar los procedimientos programados que el hospital requiera, dicha programación se realizará semanalmente para que el médico esté presente en el procedimiento, dicho servicio no generará un costo extra para el hospital.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL DEBERÁ SER LA ESPECIALIDAD SOLICITADA EN ESTE PUNTO?	SE ACLARA QUE LOS MEDICOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE HEMODINAMICA DEL HOSPITAL BELISARIO DOMINGUEZ SON LOS UNICOS QUE REALIZARAN LOS PROCEDIMIENTOS	Hemodinam la Partida 2
33	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	8	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA A CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE, ACTUALIZADO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN LA QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN ESTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE AL MENOS UN CONTRATO FORMALIZADO O COPIA SIMPLE DEL ACTA DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DE FALLO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE UN CONTRATO CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 18 MESES POR CONCEPTO AL SERVICIO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE	Hemodinam la Partida 2

6

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
34	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	9	4.6 PROPUESTAS.4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA GARANTIZAR EL ABASTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS INSUMOS OFERTADOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR A LA "SEDESA", UNA RELACIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 1.1. QUE PODRÁ SER DE HASTA TRES MARCAS ALTERNAS DEL ANEXO 3 EN LA PROPUESTA TÉCNICA TOMANDO LA ALTERNATIVA 1 COMO OFERTA PRINCIPAL Y LAS ADICIONALES DEBERÁN CUMPLIR LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 3	ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR DE UNA HASTA TRES MARCAS POR CADA RENGLÓN DESCRITO EN EL ANEXO 3 DE LOS ANEXOS TÉCNICOS DE SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, SIN SER OBLIGATORIO OFERTAR TRES MARCAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTO	Hemodinam ia Partida 2
35	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	10	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA A) "CONSTANCIA DE ADEUDOS", EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) CON FECHA NO MAYOR A DOS MESES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONFORME A LO MANIFESTADO EN	MI REPRESENTADA NO CUENTA CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENCONTRÁNDOSE EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA EN COAHUILA, POR LO QUE ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHA CONSTANCIA NO NOS ES APLICABLE? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBIDO A QUE SU DOMICILIO SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Administrati va
36	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	11	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 32 CATÉTER CON BALÓN DISEÑADA PARA CRUZAR LAS OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS: TRAZABILIDAD MEJORADA. PROCESO DE DOBLAJE DE 2 PLIEGUES MEJORADO. PUNTA BLANDA ULTRA-BAJA, DE 0.016" Y PERFIL DE CRUCE 0.021". SISTEMA SOBRE LA GUÍA, DIÁMETRO DEL GLOBO: 1.00 MM, LONGITUD DEL GLOBO: 8.00 - 12.00" - 15.00" - 20.00 MM	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CATÉTER CON BALÓN DISEÑADA PARA CRUZAR LAS OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS. TRAZABILIDAD MEJORADA. PROCESO DE DOBLAJE DE 2 PLIEGUES MEJORADO. PUNTA BLANDA ULTRA-BAJA. SISTEMA SOBRE LA GUÍA. DIÁMETRO DEL GLOBO: 1.0 MM CON PERFIL DE CRUCE 0.20" EN TIPO DE CATETER COAXIAL OTW Y RAPID INTERCAMBIO 8.0, 12.0 16.0 Y 20.0 MM LONGITUD DE BALON ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinam ia Partida 2
37	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	12	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 37 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DIVERSOS SOPORTES Y PUNTAS VARIADAS. DIAM 0.014 LONG 185 CM Y 300 CM	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DIVERSOS SOPORTES Y PUNTAS VARIADAS. DIAM 0.014 LONG 185 CM Y 300 CM SUPORTE NORMAL Y EXTRA CON PUNTAS RADIOAPACAS EN PESO DE PUNTA CON VARIAS GRAMAJES ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinam ia Partida 2
38	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	13	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 38 GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE PUNTA RECTA CON PUNTA RADIOAPACA DE 0.014" LONGITUD 182CM DEL TIPO EXTRASSUPPORT, INTERMEDIA, FLOPPY Y PT CHOICE EXTRA SUPPORT	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE PUNTA RECTA CON PUNTA RADIOAPACA DE 0.014" LONGITUD 182CM DEL TIPO EXTRASSUPPORT, INTERMEDIA, FLOPPY Y PT CHOICE EXTRA SUPPORT 0.3 G, 0.45 G Y 0.6 G SUPORTE NORMAL Y EXTRA ¿SE ACEPTA?	SISE ACEPTA	Hemodinam ia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
39	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	14	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 47 DESFIBRILADOR UNICAMERAL CON SENSADO AURICULAR CARDIOVERSOR AUTOMATICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. AL MENOS 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA EL DIFERENCIAMIENTO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES DE LAS VENTRICULARES. ASI COMO 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA LA ADAPTACION DE LA FRECUENCIA. CON ALGORITMO ACTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE FA. LONGEVIDAD MINIMA DE 9 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR. AL MENOS 72 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR. CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACION REMOTA AUTOMATICA DE PACIENTE. CONECTORES IS-1/DF-1 PARA ELECTRODO. CON MONITORIZACION DE LIQUIDO PULMONAR. COMPATIBLE CON LIQUIDO PULMONAR. COMPATIBLE CON	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR UNICAMERAL CON SENSADO AURICULAR CARDIOVERSOR AUTOMATICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. AL MENOS 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA EL DIFERENCIAMIENTO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES DE LAS VENTRICULARES, ASI COMO 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA LA ADAPTACION DE LA FRECUENCIA. CON ALGORITMO ACTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE FA. LONGEVIDAD MINIMA DE 9 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR. AL MENOS 72 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR. CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACION REMOTA AUTOMATICA DE PACIENTE. CONECTORES IS-1/DF-1 PARA ELECTRODO. CON MONITORIZACION DE LIQUIDO PULMONAR. COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinamia Partida 2
40	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	15	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 48 DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACION CARDIACA, CON DESFIBRILADOR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, MEDICION AUTOMATICA DEL UMBRAL DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CAPACIDAD DE CARGAR 40J DE ENERGIA MAXIMA, CAPACIDAD DE ENTREGAR HASTA 6 MAS DE 6 CHOQUES POR ZONA DE ARRITMIA, 3 VECTORES DISTINTOS PARA ENTREGA DE CHOQUE, CAPACIDAD DE ENTREGAR TERAPIA ANTICARDIA EN ZONA DE FV, CON ALGORITMOS ESPECIALES PARA LA DISCRIMINACION DE TSV Y TV, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION VENTRICULAR IZQUIERDA EN DOS PUNTOS DEL MISMO CABLE CON INTERVALOS PROGRAMABLES, CON LONGEVIDAD MINIMA DE 6.6 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO ¿SE ACEPTA?	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 48 DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACION CARDIACA, CON DESFIBRILADOR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, MEDICION AUTOMATICA DEL UMBRAL DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CAPACIDAD DE CARGAR 40J DE ENERGIA MAXIMA, CAPACIDAD DE ENTREGAR HASTA 6 CHOQUES POR ZONA DE ARRITMIA, 3 VECTORES DISTINTOS PARA ENTREGA DE CHOQUE, CAPACIDAD DE ENTREGAR TERAPIA ANTICARDIA EN ZONA DE FV, CON ALGORITMOS ESPECIALES PARA LA DISCRIMINACION DE TSV Y TV, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION VENTRICULAR IZQUIERDA EN DOS PUNTOS DEL MISMO CABLE CON INTERVALOS PROGRAMABLES, CON LONGEVIDAD MINIMA DE 6.6 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinamia Partida 2
41	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	16	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 66 MARCAPASO UNICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, CON FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO. CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y DEL VOLTAJE DE SALIDA. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 14 AÑOS ¿SE ACEPTA?	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 66 MARCAPASO UNICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, CON FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO. CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y DEL VOLTAJE DE SALIDA. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 14 AÑOS ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
42	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	17	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 84 STENT CORONARIO ESTRUCTURA DE CROMO-PLATINO, DISEÑO TUBULAR CON POLIMERO BIOABSORBIBLE DIAM DE 2.25 A 4 MM, LONG DE 8 -38 MM, MEDICADO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 84 STENT CORONARIO CON SUPERFICIE DE STENT IONIZADO CON CARBÓN, DISEÑO TUBULAR CON POLIMERO BIOABSORBIBLE EN 6 SEMANAS DIAM DE 2.0 A 4 MM, LONG DE 10 -38 MM, MEDICADO ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinam ia Partida 2
43	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	18	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 85 STENT CORONARIO DESNUDO, ESTRUCTURA DE CROMO- PLATINO, DISEÑO TUBULAR DIAM DE 2.25 A 4.5 MM,	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 85 STENT CORONARIO METALICO SIN DROGA; CROMO COBALTO, DISEÑO TUBULAR DIAM DE 2.25 A 4.0 MM, LONG DE 8 -30 MM STENT FLEXIBLE CON	SISE ACEPTA	Hemodinam ia Partida 2
44	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	19	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 51 KIT DE DENERVACION, QUE INCLUYE BALON PARA DERIVACION DE 4, 5, 6 O 7 CM X 25 MM, CATÉTER GUÍA 8 FR, GUÍA DE 0.018, INTRODUTOR, INCLUYE EQUIPO PARA DENERVACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A DERIVACIÓN RENAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SEREFIERE AL PROCEDIMIENTO DEDENERVACION RENAL	Hemodinam ia Partida 2
45	CORVASC DEVICES, S.A. de C.V.	20	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 78 y 79	DE LOS RENGLONES 78 Y 79 ESTABLECIO EN EL ANEXO 3 DE LOS ANEXOS TECNICOS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, NOHACE FALTA MAS DE UN METODO DE VISUALIZACION INTRACORONARIA, YA SEA POR TECNICA DE ULTRASONIDO O POR TOMAGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA, POR LO QUE SOLICITAMOS SEA OPCIONAL UNO U OTRO ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE SI HACE FALTA MAS DE UN METODO PARA LA VISUALIZACION INTRACORONARIA, POR LO QUE SE REQUIERE TANTO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO COMO DE TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA	Hemodinam ia Partida 2
46	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	1	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA DEBERÁ PRESENTAR CON LA PROPUESTA TECNICA CERTIFICADO ISO DE CALIDAD A NOMBRE DEL LICITANTE. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO DEL CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, QUE HAGA CONSTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX- CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 O ISO 9001:2015, QUE CONTEMPLE CUANDO MENOS EL SIGUIENTE ALCANCE: COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO O DE CURACIÓN DE ALTA ESPECIALIDAD O INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Y ADECUACIÓN FÍSICA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA CADA PARTICIPANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO 9001-2015 CON ALCANCE EN HEMODINAMIA A NOMBRE DEL LICITANTE.	Hemodinam ia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
47	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	2	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA A. PROPUESTA TÉCNICA IMPRESA, DE ACUERDO AL ANEXO 1 Y 1.1 QUE INDIQUE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS 3 Y 4, Y DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA ANEXO 2, Y PARA FINES DE REFERENCIACION ACOMPAÑADAS DE SU CATÁLOGO ORIGINAL QUE CONTENGA LOS INSUMOS PROPUESTOS, EN EL SUPUESTO DE QUE ÉSTOS NO ESTÉN EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBERÁN ENTREGAR TRADUCCIÓN TÉCNICA AL ESPAÑOL, IDENTIFICANDO Y RESALTANDO O SUBRAYANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANTES MENCIONADAS EN EL CATÁLOGO. LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE EN HOJA MEMBRADA DE EL PROVEEDOR, EN EL CUAL (DE ACUERDO AL ANEXO 1.1) SE DEBERÁN DESCRIBIR, LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A UTILIZAR DEL ANEXO 3 ANOTANDO LA CLAVE (NÚM. DE REFERENCIA), DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, MARCA, E INDICAR EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS INSUMOS OFERTADOS; ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ REQUISITAR DEBIDAMENTE, Y MARCAR EL NÚMERO DEL MANUAL Y/O CATÁLOGO Y DE PÁGINA EN DONDE SE LOCALIZAN CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PROPONEN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE LOS CATÁLOGOS FICHAS TÉCNICAS, MANUALES ETC. SOLO SE PRESENTEN EN FORMATO DIGITAL EN UNA USB DEBIDAMENTE REFERENCIADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA	Hemodinam la Partida 2
48	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	3	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA S. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR CON SU PROPUESTA TÉCNICA ORIGINAL O COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTESPOR CADA MARCA DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS QUE OFERTE EN EL ANEXO 1.1 (ANEXOS TÉCNICOS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA).	ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTESPOR CADA MARCA DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS QUE OFERTE EN EL ANEXO 1.1 (ANEXOS TÉCNICOS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA).	ES CORRECTO DEBERA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD FDAO TUV O CE O JIS, ASI COMO ISO 13485 Y ASI MISMO LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS EN PRESTAMO PERMANENTE ASI COMO DE LOS INSUMOS DEL ANEXO 3.	Hemodinam la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
49	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	4	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 41 GUIA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) PARAV CATETER CON PUNTA "J" DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 195 CM A 300 CMS DE LARGO. FORMA DE PUNTA DISTAL RADIOCAPA EN FORMA DE DOMO O CUÑA, PARA OCCLUSIONES TOTALES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 41GUIA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) PARAV CATETER CON PUNTA "J" DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 195 CM A 300 CMS DE LARGO. FORMA DE PUNTA DISTAL RADIOCAPA EN FORMA DE DOMO O CUÑA, PARA OCCLUSIONES TOTALES 3 G, 4.5 G, 6.0 G, 9.0 G Y 12.0 G CON PUNTA DISTAL FORMO DE CUÑA 195 CM Y 300 CM LONGITUD ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinam la Partida 2
50	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	5	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 45 DESFIBRILADOR BICAMERAL CARDIOVERSOR AUTOMATICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. AL MENOS 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA EL DIFERENCIAMIENTO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES DE LAS VENTRICULARES, LONGEVIDAD MINIMA DE 6 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR. AL MENOS 72 MIN DE MEMORIA PARA ELECTROGRAMAS. CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACION REMOTA AUTOMATICA DE PACIENTE. CONECTORES IS-1/DF- 4 PARA ELECTRODOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR BICAMERAL CARDIOVERSOR AUTOMATICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. AL MENOS 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA EL DIFERENCIAMIENTO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES DE LAS VENTRICULARES, LONGEVIDAD MINIMA DE 6 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR AL MENOS 45 MIN DE MEMORIA PARA ELECTROGRAMAS CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACION REMOTA AUTOMATICA DE PACIENTE. CONECTORES IS-1/DF-4 PARA ELECTRODOS. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinam la Partida 2
51	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	6	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 48 DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACION CARDIACA, CON DESFIBRILADOR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, MEDICIO AUTOMATICA DEL UMBRAL DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CAPACIDAD DE CARGAR 40J DE ENERGIA MAXIMA, CAPACIDAD DE ENTREGAR MAS DE 6 CHOQUES POR ZONA DE ARRITMIA, 3 VECTORES DISTINTOS PARA ENTREGA DE CHOQUE, CAPACIDAD DE ENTREGAR TERAPIA ANTICARDIA EN ZONA DE FV, CON ALGORITMOS ESPECIALES PARA LA DISCRIMINACION DE TSV Y TV, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION PARA EL VENTRICULO IZQUIERDO, CON LONGEVIDAD MINIMA DE 6.6 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 48 DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACION CARDIACA, CON DESFIBRILADOR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, MEDICIO AUTOMATICA DEL UMBRAL DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CAPACIDAD DE CARGAR 40J DE ENERGIA MAXIMA, CAPACIDAD DE ENTREGAR HASTA 6 CHOQUES POR ZONA DE ARRITMIA, 3 VECTORES DISTINTOS PARA ENTREGA DE CHOQUE, CAPACIDAD DE ENTREGAR TERAPIA ANTICARDIA EN ZONA DE FV, CON ALGORITMOS ESPECIALES PARA LA DISCRIMINACION DE TSV Y TV, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION VENTRICULAR IZQUIERDA EN DOS PUNTOS DEL MISMO CABLE CON INTERVALOS PROGRAMABLES, CON LONGEVIDAD MINIMA DE 6.6 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinam la Partida 2
52	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	7	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 31 KIT DE DENERVACION, QUE INCLUYE BALON PARA DERIVACION DE 4, 5, 6 O 7 CM X 25 MM, CATETER GUÍA 8 FR, GUÍA DE 0.018, INTRODUCCTOR, INCLUYE EQUIPO PARA DENERVACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARA SI SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DENERVACION RENAL		Hemodinam la Partida 2
53	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	8	ANEXO 8 MUESTRAS MUESTRAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	LA MUESTRA MARCADA CON EL NO. 87 EN EL LISTADO DENOMINADO COMO: DISPOSITIVO PARA CIERRE DE OREJUELA DE AURICULA IZQUIERDA CON MARCO AUTO- EXPANDIBLE DE NITINOL, RECUBRIMIENTO PERMEABLE	SI SE REFIERE AL INSUMO 89 DEL ANEXO 3	Hemodinam la Partida 2
54	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	9	ANEXO 8 MUESTRAS MUESTRAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN MUESTRAS ABIERTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO NO ESTEN USADAS Y ESTEN COMPLETAS	Hemodinam la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
55	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1	1. INFORMACIÓN GENERAL. 1.1 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. PARTIDA 1: SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARTIDA 2: SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SERVICIO CORRESPONDE LA PARTIDA 1 Y A QUE SERVICIO CORRESPONDE LA PARTIDA 2, YA QUE EN EL ANEXO 19 DE LA CONVOCATORIA, LA PARTIDA 1 CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y LA PARTIDA 2 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	SE DA RESPUESTA CON LA PRECISIÓN NUMERO 2.	Hemodinam ia Partida 2
56	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2	1. INFORMACIÓN GENERAL. 1.1 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. PARTIDA 1: SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARTIDA 2: SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ DE VENIR IDENTIFICADA HACIENDO REFERENCIA A LOS DOS SERVICIOS INTEGRALES: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-010-19 SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA O PODRÁ IDENTIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-010-19 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL CASO DE PARTICIPAR SOLO PARA EL SER SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, ¿SERÍA AMABLE DE ACLARARNOS ESTA SITUACIÓN?	SE DA RESPUESTA CON LA PRECISIÓN NUMERO 2.	Hemodinam ia Partida 2
57	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3	4.2 MUESTRAS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 8 INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, SE SEÑALAN LA FORMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS MUESTRAS ENLISTADAS EN EL ANEXO 8 PARA SU EVALUACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES DEL 100% DE LOS RENGLONES SEÑALADOS EN EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019, EN UN HORARIO DE 09:00 A LAS 12:00 HORAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS MUESTRAS CON CARÁCTER DEVOLUTIVO, Y ESTAS	DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 8, ENTENDEMOS QUE SE DEBEN PRESENTAR MUESTRAS SOLO DEL LISTADO PREESTABLECIDO EN EL ANEXO 8 ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	ES CORRECTO	Hemodinam ia Partida 2
58	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA O, DEBERÁ ENTREGAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA PARA AL MENOS 4 PERSONAS COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO PARA COTEJO DEL TÍTULO Y/O CÉDULA PROFESIONAL EN CARRERAS MÉDICAS AFINES, ASÍ COMO COPIA DE DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA. EL CUAL NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	ES CORRECTO ENTENDER POR CARRERAS MÉDICAS AFINES: MÉDICOS CIRUJANOS, LICENCIADOS EN ENFERMERÍA O TÉCNICOS EN ENFERMERÍA? ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	SI ES CORRECTA LA APRECIACIÓN SIMPRE Y CUANDO DEMUESTREN QUE SE ENCUENTRAN CAPACITADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA	Hemodinam ia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
59	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	5	ANEXO 2 FICHA TÉCNICA 2019 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Otras prescripciones aplicables al bien, arrendamiento o servicio.2. El proveedor deberá proveer un médico especializado para realizar los procedimientos programados que el hospital requiera, dicha programación se realizará semanalmente para que el médico esté presente en el procedimiento, dicho servicio no generará un costo extra para el hospital.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL DEBERÁ SER LA ESPECIALIDAD SOLICITADA EN ESTE PUNTO?	SE ACLARA QUE LOS MEDICOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL BELISARIO DOMINGUEZ SON LOS UNICOS QUE REALIZARAN LOS PROCEDIMIENTOS	Hemodinam la Partida 2
60	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	6	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA. LL. DOCUMENTO FIRMADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL PROVEEDOR, EN EL QUE INDIQUE QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB, DEBIENDO CONTAR CON SOPORTE TÉCNICO.	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA PROPUESTA SOLO SE DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO FIRMADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL PROVEEDOR, EN EL QUE INDIQUE QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB, CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DESCRITAS EN EL ANEXO 6.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN	ES CORRECTO	Hemodinam la Partida 2
61	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA GARANTIZAR EL ABASTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS INSUMOS OFERTADOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR A LA "SEDESA", UNA RELACIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 1.1. QUE PODRÁ SER DE HASTA TRES MARCAS ALTERNAS DEL ANEXO 3 EN LA PROPUESTA TÉCNICA TOMANDO LA ALTERNATIVA 1 COMO OFERTA PRINCIPAL Y LAS ADICIONALES DEBERÁN CUMPLIR LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 3	ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR DE UNA HASTA TRES MARCAS POR CADA RENGLON DESCRITO EN EL ANEXO 3 DE LOS ANEXOS TÉCNICOS DE SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, SIN SER OBLIGATORIO OFERTAR TRES MARCAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTO	Hemodinam la Partida 2
62	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 32 CATETER CON BALÓN DISEÑADA PARA CRUZAR LAS OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS. TRAZABILIDAD MEJORADA. PROCESO DE DOBLAJE DE 2 PLIEGUES MEJORADO. PUNTA BLANDA ULTRA-BAJA, DE 0.016" Y PERFIL DE CRUCE 0.021". SISTEMA SOBRE LA GUÍA. DIAMETRO DEL GLOBO: 1.00 MM LONGITUD DEL GLOBO: 8.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00 MM	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNCATER CON BALÓN DISEÑADA PARA CRUZAR LAS OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS. TRAZABILIDAD MEJORADA. PROCESO DE DOBLAJE DE 2 PLIEGUES MEJORADO. PUNTA BLANDA ULTRA-BAJA. SISTEMA SOBRE LA GUÍA. DIAMETRO DEL GLOBO: 1.0 MM CON PERFIL DE CRUCE 0.20" EN TIPO DE CATETER COAXIAL OTW Y RAPID INTERCAMBIO 8.0, 12.0 16.0 Y 20.0	SI SE ACEPTA	Hemodinam la Partida 2
63	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 37 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DIVERSOS SOPORTES Y PUNTAS VARIADAS: DIAM 0.014 LONG 185 CM Y 300 CM	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNCUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DIVERSOS SOPORTES Y PUNTAS VARIADAS. DIAM 0.014 LONG 185 CM Y 300 CM SUPORTE NORMAL Y EXTRA CON PUNTAS RADIOAPACAS EN PESO DE PUNTA CON VARIAS GRAMAJES ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinam la Partida 2
64	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 38 GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE PUNTA RECTA CON PUNTA RADIOAPACA DE 0.014" LONGITUD 182CM DEL TIPO EXTRASUPPORT, INTERMEDIA, FLOPPY Y PT CHOICE EXTRA SUPPORT	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNGUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE PUNTA RECTA CON PUNTA RADIOAPACA DE 0.014" LONGITUD 182CM DEL TIPO EXTRASUPPORT, INTERMEDIA, FLOPPY Y PT CHOICE EXTRA SUPPORT 0.3 G, 0.45 G Y 0. 6 G SUPORTE NORMAL Y EXTRA ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinam la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
65	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	11	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 65 MARCAPASO BICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE DOBLE CAMARA PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, CON FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO, CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA FRECUENCIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO, CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y MEDICION DEL UMBRAL DE ESTIMULACION. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 15 AÑOS	NO SE ACEPTA	Hemodinamia la Partida 2
66	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	12	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 66 MARCAPASO UNICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, CON FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO, CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y DEL VOLTAJE DE SALIDA. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 15 AÑOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 66 MARCAPASO UNICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, CON FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO, CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y DEL VOLTAJE DE SALIDA. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 14 AÑOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.	Hemodinamia la Partida 2
67	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	13	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 84 STENT CORONARIO ESTRUCTURA DE CROMO-PLATINO, DISEÑO TUBULAR CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE DIAM DE 2.25 A 4 MM, LONG DE 8 -38 MM, MEDICADO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 84 STENT CORONARIO CON SUPERFICIE DE STENT IONIZADO CON CARBÓN, DISEÑO TUBULAR CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE EN 6 SEMANAS DIAM DE 2.0 A 4 MM, LONG DE 10 -38 MM, MEDICADO ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinamia la Partida 2
68	DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS 85 STENT CORONARIO DESNUDO, ESTRUCTURA DE CROMO- PLATINO, DISEÑO TUBULAR DIAM DE 2.25 A 4.5 MM, LONG DE 8 -32 MM.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 85 STENT CORONARIO METALICO SIN DROGA; CROMO COBALTO, DISEÑO TUBULAR DIAM DE 2.25 A 4.0 MM, LONG DE 8 -30 MM STENT FLEXIBLE CON DISEÑO MULTICELULAR ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA	Hemodinamia la Partida 2
69	Hi-Tec Medical, S.	1	4.6.1 PROPUESTA TECNICA	SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIALISIS CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGURIDAD A LA CONVOCANTE DE UN ABASTO REGULAR Y CONFIABLE DE PRODUCTOS DE CALIDAD, SUGERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, SE SOLICITE LA PRESENTACIÓN DE CARTA DE APOYO EMITIDA POR EL FABRICANTE PARA	Se aclara que los licitantes deberán presentar con su propuesta técnica una carta bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, en la que se compromete a presentar en cada	Dialisis y Hemodialis la Partida 1

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]

[Handwritten signature and mark at the bottom right of the page]

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
70	Hi-Tec Medical, S.	2	4.6.1 PROPUESTA TECNICA INCISO B	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERA NECESARIO PRESENTAR ESCRITO AL RESPECTO E INTEGRARLO EN LA PROPUESTA TECNICA.	Si, es correcto y mediante escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que en caso de adjudicación, se compromete a otorgar al menos un curso por unidad medica de la sedesa y a elaborar y otorgar un programa teórico-práctico y calendario de capacitación que se requiera en el manejo y funcionamiento de los equipos, así como de actualización en procedimientos para hemodiálisis, diálisis peritoneal intermitente y diálisis peritoneal ambulatoria, esta será para todo el personal operativo y jefes de servicio hemodiálisis y diálisis de "la sedesa" en idioma español. El proveedor deberá entregar en la dirección de medicamentos, tecnología e insumos la constancia de personas que recibieron dicha capacitación por unidad medica en un plazo no mayor a 3 meses de la adjudicación.	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
71	Hi-Tec Medical, S.	3	4.5.2 PROPUESTA ECONOMICA	EN LA PÁG. 20 SE MENCIONA EL NUMERAL 4.5.2 PROPUESTA ECONOMICA, SIN EMBARGO, CONSIDERAMOS QUE EL NUMERAL CORRECTO ES 4.6.2, FAVORECE ACLARAR. DICE: LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERÁ SER PRESENTADA POR "LOS LICITANTES" PARA LAS PARTIDAS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DE ACUERDO CON EL FORMATO DEL ANEXO 19, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LOS ANEXOS 1, 2, 2A Y 2B CONFORME A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, SIN EMBARGO, EN EL ANEXO 19 SE REQUIERE LA COTIZACIÓN POR SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS Y POR SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, A CANTIDADES TOTALES REFERIDAS. A EFECTO DE ESTAR EN CONDICIONES DE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA ACORDE CON CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS DETALLADAS EN EL ANEXO 2, FICHA TECNICA, PAGINA 39; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS: A).- HEMODIÁLISIS. PRIMER EVENTO EVENTO SUBSECUENTE. B).- DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE AUTOMATIZADA (DPIA) (DPA) DIÁLISIS PERITONEAL CON MÁQUINA EN DOMICILIO DIÁLISIS PERITONEAL MANUAL EN DOMICILIO (DPCA) DIÁLISIS PERITONEAL CON ICODEXTRINA EN DOMICILIO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL NUMERAL CORRECTO ES 4.6.2	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
72	Hi-Tec Medical, S.	4	4.5.2 (4.6.2.) PROPUESTA ECONOMICA, PAGINA 20.		La propuesta economica debera de presentarse de acuerdo a la aclaración de la convocante. NO IMPORTA EL NUMERO DE PACIENTES, YA QUE SE PUEDE TENER UN PACIENTE CON MUCHOS O POCOS PROCEDIMIENTOS, LO QUE IMPORTA ES EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS, QUE SE MENCIONA EN LAS BASES ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 12796 PARA HEMODIÁLISIS Y 6398 PARA DIÁLISIS	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
73	Hi-Tec Medical, S.	5	ANEXO 28 INCISO B	PÁG. 47 INCISO B. DESCRIPCION DEL SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL. EN EL CUARTO PÁRRAFO RENGLÓN PENÚLTIMO DICE: BOLSA 6000 ML PARA MAQUINA CICLADORA E ICODEXTRINA 7.25%, SIN EMBARGO, EN EL CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS DICE 7.5%, FAVOR DE ACLARAR AL RESPECTO.	podrá referenciar 7.5%, sin ser limitante	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
74	Hi-Tec Medical, S.	6	NUMERAL B-3	SOLUCIONES PARA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA APLICACIÓN DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PÁG. 49. EN LA CLAVE: 010.000.2364.00.01. SEGUNDO RENGLÓN DICE CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.0257 G, SIN EMBARGO, EN EL CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICA 0.0520 G, FAVOR DE ACLARAR AL RESPECTO.	podrá referenciar 0.0520 g, sin ser limitante	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
75	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	1	5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN.	Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el presente procedimiento se adjudicará por partida única, es decir, las 2 partidas a un mismo licitante o se podrá presentar propuesta por solo una de las 2	PODRÁ OFERTAR POR PARTIDAS INDIVIDUALES: PARTIDA 1 "DIALISIS Y HEMODIALISIS" Y/O PARTIDA 2 "HEMODINAMIA"	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
76	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	2	1.1 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. PARTIDA 2 SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIALISIS	Solicitamos a la Convocante considere que debido a que en la actualidad solo existen dos fabricantes de soluciones de dialisis y más de cinco proveedores de equipos e insumos para hemodialis, se consideren servicios-partidas separadas las especialidades de dialisis y hemodialis, ya que este mecanismo ha permitido a su proveedor actual a dirigir y orientar el procedimiento de contratación desde hace más de 6 años, toda vez que las marcas Baxter y Gambro sin representar las mejores condiciones de mercado han permanecido inamovibles de dicho hospital por la orientación técnica que se ha brindado a dichos distribuidores y fabricantes respectivamente	NO SE ACEPTA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ESPERA PARTIDA 1 "DIALISIS Y HEMODIALISIS"	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
77	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	3	PUNTO 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN	Solicitamos a la convocante considere que debido al tipo de servicio que se requiere en el procedimiento, los insumos a ofertar no son de fabricación nacional, razón por la que no sería posible cumplir con el porcentaje de integración nacional que se señala. ¿Se acepta ofertar un servicio con productos de importación con un grado de integración nacional de 50% o menor?	DEBIDOA QUE SE CONSIDERA UN SERVICIO INTEGRAL EL MISMO ES DE CARÁCTER NACIONAL	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
78	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	4	PUNTO 2.3 PERIODO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una clínica subrogada para la atención de los pacientes de forma externa en caso de que se realice un cambio de proveedor de manera tal que se pueda mantener un servicio continuo y la salud del paciente durante el periodo de transición de tecnología, esto sin costo adicional para la Secretaría.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A BASES	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
79	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	5	PUNTO 4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA, SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y HEMODIALISIS. INCISO E.	Solicitamos a la Convocante nos permita presentar impresión simple del manual electrónico acompañado de su versión digital, esto debido a que el fabricante del equipo que proponemos ya no entrega manuales físicos sino su versión digital. ¿Se acepta?	SEACEPTA, SIN SER LIMITATIVO	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
80	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	6	ANEXO TÉCNICO, SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS 2019 11, PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLES POR PARTE DE EL PROVEEDOR; INCISO C	Solicitamos a la Convocante que debido a que cada institución de Salud titula de forma particular los contratos y en específico esta Convocante no ha cambiado de proveedor en al menos los últimos 6 años, de manera que las bases de la misma se conservan dirigidas y orientadas al mismo al fabricante que distribuye el mismo, se permita presentar contratos relacionados con la prestación de servicios de hemodiálisis y/o diálisis peritoneal y/o hemodiafiltración de manera que sea posible tener apertura a la libre competencia tal como lo establece la Ley de Adquisiciones. Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la Convocante considere y elimine el requerimiento de icodextrina ya que solo el fabricante Baxter produce la bolsa para diálisis con icodextrina. ¿Se acepta?	DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS CON EL MISMO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN (PARTIDA 1 Y HEMODIÁLISIS)	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
81	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	7	Anexo 2, Servicio integral de diálisis y hemodiálisis, B). Diálisis Peritoneal Hospitalaria (Dpi/Pdia) Y Domiciliaria (Dpa/Pdca Mas icodextrina)	Solicitamos a la Convocante elimine el requerimiento de icodextrina ya que limita la libre participación no solo del servicio de diálisis sino también el de hemodiálisis al fabricante Baxter, siendo que el requerimiento de icodextrina no alcanza ni al 2% del valor de facturación para dicho servicio integral, más aun como el anexo mismo lo señala ni siquiera se considera un porcentaje de consumo.	NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE EL INSUMO ES NECESARIO PARA LATERAPIA DE VIDA RESPECTIVA	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
82	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	8	Anexo 2, Servicio integral de diálisis y hemodiálisis, B). Diálisis Peritoneal Hospitalaria (Dpi/Pdia) Y Domiciliaria (Dpa/Pdca Mas icodextrina), Anexo 2B Diálisis Peritoneal.	Solicitamos a la Convocante elimine el requerimiento de icodextrina ya que limita la libre participación no solo del servicio de diálisis sino también el de hemodiálisis al fabricante Baxter, siendo que el requerimiento de icodextrina no alcanza ni al 2% del valor de facturación para dicho servicio integral, más aun como el anexo mismo lo señala ni siquiera se considera un porcentaje de consumo.	RESPUESTA EN LA PREGUNTA 7	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
83	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	9	Anexo 2, Servicio integral de diálisis y hemodiálisis, ASISTENCIA TÉCNICA. Segunda viñeta.	Solicitamos a la convocante adecue el requerimiento ya que el ingeniero biomédico no está facultado para la asistencia técnica en el proceso de diálisis peritoneal en ninguna modalidad de acuerdo con lo señalado en la Ley Federal de Salud y en la Ley Federal de Profesiones, específicamente este procedimiento corresponde a enfermería y personal MÉDICO.	SE ACLARA QUE LA ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DE UN INGENIERO BIOMÉDICO O AFÍN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LOS EQUIPOS, MAS NO EN LA APLICACIÓN EN EL PACIENTE	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
84	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	10	Anexo 2, Servicio integral de diálisis y hemodiálisis, EQUIPOS EN PRESTAMO PERMANENTE	Solicitamos a la Convocante aclare a que se refiere con equipos "funcionalmente nuevos" ya que dicho termino es confuso, ambiguo y técnicamente inviable.	LOS EQUIPOS EN PRÉSTAMO PERMANENTE, DEBERÁN SER NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS CON ANTIGÜEDAD DE NO MAS DE TRES AÑOS DE FABRICACIÓN	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
85	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	11	Anexo 2A, Hemodiálisis, A-5 Sistema de Ecografía.	Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la Convocante que dado que esta describiendo el equipo de ecografía que le suministre el proveedor actual, adecue el requerimiento a las especificaciones del ecógrafo existente en las guías de CENETEC de manera que no se siga orientando el procedimiento al cumplimiento técnico específico del proveedor actual. ¿Se acepta?	PODRÁ PRESENTAR EL EQUIPO PROPUESTO POR EL LICITANTE, SIEMPRE QUE SE APEGUE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DEBIDAMENTE REFERENCIADOS PARA SU EVALUACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
86	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	12	Anexo 2A, Hemodiálisis, A-5 Sistema de Ecografía.	Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la Convocante se permitan ofertar equipos equivalentes con tolerancias de +/- 10% a las especificaciones publicadas con lo cual se permite la libre participación. ¿Se acepta?	SE RESPONDE EN LA PREGUNTA ANTERIOR	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1
87	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	13	Anexo 2A A-7 INSUMOS DE HEMODIÁLISIS para las tres unidades médicas, numeral 4.	Solicitamos a la convocante permita ofertar juego de líneas arterial y venosa con o sin equipo de venoclisis de acuerdo con la marca del fabricante y por separado se suministra dicho insumo, ya que el cassette que describen es el del fabricante Gambro, situación que limita la participación, orienta el procedimiento y posiciona al proveedor actual en condiciones ventajosas sobre los demás participantes. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO	Diálisis y Hemodiálisis \$ Partida 1

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
88	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	14	Anexo 2A A-7 INSUMOS DE HEMODIÁLISIS para las tres unidades médicas, numeral 2.	Solicitamos a Convocante permita ofertar bicarbonato con contenido de 760gr de acuerdo con la tecnología de cada fabricante considerando que el contenido es suficiente para una sesión de hasta 6 horas de forma continua a Qd de 500ml/min. ¿Se acepta?	SEACEPTA, SIN SER LIMITATIVO	Diálisis y Hemodíalisis \$ Partida 1
89	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	15	Anexo 2A A-7 INSUMOS DE HEMODIÁLISIS para las tres unidades médicas, numeral 7 y 8	Solicitamos a la Convocante permita ofertar concentrados líquidos en presentación de 5,000 ml o bidón de acuerdo con la tecnología de cada fabricante, esto considerando que cada marca maneja un proceso diferente de des-incrustación y desinfección con agentes específicos. ¿se acepta?	SEACEPTA, SIN SER LIMITATIVO	Diálisis y Hemodíalisis \$ Partida 1
90	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I DE C.V	16	ANEXO 2B DIÁLISIS PERITONEAL, B-1 MÁQUINA CICLADORA PARA DIÁLISIS PERITONEAL	Solicitamos a la Convocante considere que la máquina cicladora que describe corresponde específicamente a la máquina cicladora de la marca Baxter, la cual de la simple lectura de las bases oferta equipos re-acondicionados de manufactura del año 2012, por lo que con la finalidad de permitir la libre participación de la proveeduría como lo establece la Ley, permita ofertar máquina cicladora de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, tal como lo permiten las instalaciones como el IMSS o el ISSSTE.	APEGARSE BASES, SE ACLARA QUE LOS EQUIPOS DEBERÁN SER NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS CON ANTIGÜEDAD DE NO MÁS DE TRES AÑOS DE FABRICACIÓN	Diálisis y Hemodíalisis \$ Partida 1
91	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	1	1.5 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. Y 4.1 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE	SE MENCIONA QUE LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE SE LLEVARÁN A CABO EL 11 DE ABRIL DE 2019 EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS. ADICIONALMENTE EN EL NUMERAL 4.1. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS. SE DEBEN DE REALIZAR VISITAS DE RECONOCIMIENTO A CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y/O HOSPITALARIAS EN LAS QUE SE PROPORCIONARÁ EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. Y EN CASO DE INCUMPLIR CON LA VISITA, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. DEBIDO A LOS TAN CORTOS TIEMPOS Y PLAZOS CON LOS QUE SE PUBLICÓ LA LICITACIÓN ESTE REQUISITO SE PUEDEN CONVERTIR EN UNA VENTAJA PARA EL PROVEEDOR QUE ACTUALMENTE ESTÁ BRINDANDO EL SERVICIO QUIEN TIENE PERSONAL EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER ESAS UNIDADES MÉDICAS, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL OBJETIVO DE QUE HAYA MÁS PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, QUE BRINDE CUANDO MENOS 2 DÍAS HÁBILES ADICIONALES A FIN DE PODER CUBRIR CON TODAS LAS VISITAS SOLICITADAS EN LAS BASES, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	SE ELIMINA PREGUNTA	Diálisis y Hemodíalisis \$ Partida 1

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
92	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	2	1.5 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.	SE MENCIONA QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019 A LAS 13:00 HORAS. ADICIONALMENTE EN EL NUMERAL 5.1. JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES, SE MENCIONA QUE SE DEBEN DE ENVIAR LAS PREGUNTAS 24 HORAS PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DE LA MISMA. DEBIDO A LOS TAN CORTOS TIEMPOS Y PLAZOS CON LOS QUE SE PUBLICÓ LA LICITACIÓN ESTE REQUISITO SE PUEDE CONVERTIR EN UNA VENTAJA PARA EL PROVEEDOR QUE ACTUALMENTE ESTÁ BRINDANDO EL SERVICIO, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL OBJETIVO DE QUE HAYA MÁS PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, QUE BRINDE CUANDO MENOS 5 DÍAS HÁBILES ADICIONALES POSTERIORES A LA VISITA A SITIOS, A FIN DE PODER ESTAR EN POSICIÓN DE ANALIZAR LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, ASÍ COMO LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	SE RETIRA LA PREGUNTA A PETICIÓN DEL LICITANTE	Díalísis y Hemodiálisis \$ Partida 1
93	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	3	1.5 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.	SE MENCIONA QUE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019 A LAS 13:00 HORAS, PRÁCTICAMENTE AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. DEBIDO A LOS TAN CORTOS TIEMPOS Y PLAZOS CON LOS QUE SE PUBLICÓ LA LICITACIÓN, ESTE REQUISITO SE PUEDE CONVERTIR EN UNA VENTAJA PARA EL PROVEEDOR QUE ACTUALMENTE ESTÁ BRINDANDO EL SERVICIO, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL OBJETIVO DE QUE HAYA MÁS PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, QUE BRINDE CUANDO MENOS 5 DÍAS HÁBILES ADICIONALES POSTERIORES A LA JUNTA DE ACLARACIONES, A FIN DE PODER ESTAR EN POSICIÓN DE TOMAR EN CUENTA CUALQUIER SITUACIÓN QUE SE HAYA ACLARADO O PUNTUALIZADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y SE PUEDA INTEGRAR A LA PROPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE INCLUSO SE TIENE QUE ENTREGAR UNA FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTAS, POR LO QUE BRINDAR SOLAMENTE DÍAS INHÁBILES PARA JUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN PUEDE RESULTAR UN REQUISITO PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE DE CUMPLIR, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA EN LA PRESENTE ACTA.	Díalísis y Hemodiálisis \$ Partida 1

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
94	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	4	2.3. PERIODO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SE MENCIONA QUE EL PERIODO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y FINALIZARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. EN LA PRÁCTICA ESTE ES UN REQUISITO QUE SOLAMENTE PUEDE CUMPLIR EL PROVEEDOR QUE ACTUALMENTE ESTÁ BRINDANDO EL SERVICIO, POR LO QUE SE PONE A TODOS LOS DEMÁS PROVEEDORES EN POSICIÓN DE DESVENTAJA COMERCIAL, POR LO QUE A FIN DE QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON MAYOR NÚMERO DE OFERTAS Y ASÍ PUEDA COMPARAR A LA PROVEEDURÍA TENIENDO POTENCIALMENTE AHORROS AL HABER MAYOR NÚMERO DE OFERTANTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE EL SERVICIO INICIE ENTRE 30 Y 45 DÍAS POSTERIORES AL FALLO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL SERVICIO SE DEBERÁ PROPORCIONAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	Díálisis y Hemodíálisis \$ Partida 1
95	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	5	4.3. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS, INCISO C)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN NO UTILIZAR PAPEL RECICLADO O CARTÓN. FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR ASÍ LAS PROPUESTAS.	Díálisis y Hemodíálisis \$ Partida 1
96	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	6	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO M)	EN LA ACTUALIDAD, LAS DECLARACIONES DE I.S.R. TANTO PROVISIONALES COMO ANUAL, SE PRESENTAN DE FORMA ELECTRÓNICA POR LO QUE NO EXISTE UN DOCUMENTO ORIGINAL COMO TAL, SINO UNA IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO EXPEDIDO POR EL SAT, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHO DOCUMENTO IMPRESO DOS VECES A FIN DE CUBRIR CON EL REQUISITO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.	Díálisis y Hemodíálisis \$ Partida 1
97	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	7	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO J)	SE MENCIONA LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. PREGUNTA: NOSOTROS CONTAMOS CON UN CONTRATO DE OUTSOURCING POR LO CUAL NO PODEMOS PRESENTAR DICHA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO. PODEMOS PRESENTAR ESE DOCUMENTO POR PARTE DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING QUE TENEMOS CONTRATADA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA	Díálisis y Hemodíálisis \$ Partida 1

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
98	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	8	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA (INCISO K)	HACE MENCIÓN LA RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTECEDENCIA A LA FECHA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, PREGUNTA: NOSOTROS CONTAMOS CON EL SERVICIO DE OUTSOURCING POR LO CUAL NO PODEMOS PRESENTAR DICHO DOCUMENTO. PODEMOS PRESENTAR ESE DOCUMENTO POR PARTE DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING QUE TENEMOS CONTRATADA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EL ALTA PATRONAL, RECIBOS DE PAGO DEL ULTIMO BIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y LA RELACIÓN DE LOS EMPLEADOS CONTRATADOS BAJO ESTA MODALIDAD, ASÍ COMO EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL PERSONAL Y LOS MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
99	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	9	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA (INCISO L)	SE MENCIONA COMPROBANTES DE PAGO DE LOS ULTIMOS DOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. PREGUNTA: NOSOTROS CONTAMOS CON EL SERVICIO DE OUTSOURCING POR LO CUAL NO PODEMOS PRESENTAR DICHA DOCUMENTO. PODEMOS PRESENTAR ESE DOCUMENTO POR PARTE DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING QUE TENEMOS CONTRATADA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EL ALTA PATRONAL, RECIBOS DE PAGO DEL ULTIMO BIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y LA RELACIÓN DE LOS EMPLEADOS CONTRATADOS BAJO ESTA MODALIDAD, ASÍ COMO EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL PERSONAL Y LOS MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
100	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	10	ANEXO 1 DEL ANEXO TÉCNICO SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUANTOS PACIENTES DE HEMODIÁLISIS ATIENDEN ACTUALMENTE POR HOSPITAL.	NO IMPORTA EL NUMERO DE PACIENTES, YA QUE SE PUEDE TENER UN PACIENTE CON MUCHOS O POCOS PROCEDIMIENTOS, LO QUE IMPORTA ES EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS, QUE SE MENCIONA EN LAS BASES ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 12796 PARA HEMODIÁLISIS Y 6398 PARA DIÁLISIS	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1
101	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	11	ANEXO 1 DEL ANEXO TÉCNICO SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR CUANTOS PACIENTES DE DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA ATIENDEN ACTUALMENTE, Y CUANTO PACIENTES DE DIÁLISIS MANUAL SE ATIENDEN ACTUALMENTE POR HOSPITAL	SE RESPONDE EN LA PREGUNTA ANTERIOR	Dialisis y Hemodialis \$ Partida 1

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
102	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	12	ANEXO 2A PUNTO 7 DEL ANEXO TÉCNICO SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE QUIEN SERA EL RESPONSABLE DEL ACCESO VASCULAR DEL PACIENTE (COLOCACIÓN)	PERSONAL MÉDICO DE LA CONVOCANTE	Diálisis y Hemodíali \$ Partida 1
103	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	13	ANEXO 2 EQUIPOS EN PRÉSTAMO PERMANENTE DEL ANEXO TÉCNICO SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	REFERENTE A LOS EQUIPOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA DONDE SOLICITA EQUIPOS NUEVOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPOS SEMINUEVOS CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA	LOS EQUIPOS EN PRÉSTAMO PERMANENTE, DEBERÁN SER NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS CON ANTIGÜEDAD DE NO MAS DE TRES AÑOS DE FABRICACIÓN	Diálisis y Hemodíali \$ Partida 1
104	MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	14	ANEXO 2B DEL ANEXO TÉCNICO SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS	REFERENTE A LOS EQUIPOS DE DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA LA CONVOCANTE SOLICITA ALREDEDOR DE 525 EQUIPOS A COMODATO, PREGUNTA ¿QUIEN SERA EL ENCARGADO DE OTORGAR Y RECOLECTAR LOS EQUIPOS EN CASO DE QUE ALGÚN PACIENTE FALLECIERA	EL NÚMERO DE EQUIPOS REQUERIDOS ESTÁ EN EL ANEXO 2B. EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERÁ EL ENCARGADO DE ENTREGAR Y RECOGER EL EQUIPO EN CASO DEL FALLECIMIENTO DEL PACIENTE	Diálisis y Hemodíali \$ Partida 1
105	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	1	En el Anexo 3, partida 5	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "BALÓN MEDICADO CON SIROLIMUS DE DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES", ya que el Sirolimus es un medicamento antiproliferativo ampliamente estudiado para el control de estenosis en arterias coronarias. ¿Se acepta?	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinam la Partida 2
106	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	2	En el Anexo 3, partida 7	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "BALÓN PERIFÉRICO SOBRE LA GUÍA 0.035", LONGITUD DE CATERETER 135 CM, DOBLE LUMEN, DOS MARCADORES RADIOOPACOS, PRESION DE RUPTURA 18 ATM, DIÁMETROS DE 3 A 12 MM Y LONGITUD MÁXIMA DE 220 MM", ya que las diferencias respecto a las especificaciones técnicas solicitadas, no representan una desventaja técnica durante el procedimiento. ¿Se acepta?	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinam la Partida 2
107	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	3	En el Anexo 3, partida 7	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "BALÓN NO COMPLACIENTE, RÁPIDO INTERCAMBIO, COMPATIBLE CON GUÍA 0.014", PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON DIÁMETROS DE 1.5 A 4.5 MM Y LONGITUDES SE 8.0 A 30.0 MM", ya que las diferencias en matrix de medidas, no implica una desventaja técnica durante el procedimiento de angioplastia coronaria. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA PORQUE EL SISTEMA ES PARA GUÍA 0.014	Hemodinam la Partida 2
108	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	4	En el Anexo 3, partida 11	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "BALÓN CORONARIO PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, RÁPIDO INTERCAMBIO, COMPATIBLE CON GUÍ 0.014", PERFIL DE ENTRADA 0.0157". EN DIÁMETROS DE 1.0 A 4.0 MM Y LONGITUDES DE 6.0 A 30.0 MM", ya que las especificaciones y matrix de medidas ofertadas, superan a las requeridas por la convocante. ¿Se acepta?	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinam la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
109	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	5	En el Anexo 3, partida 12	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "BALON PERIFÉRICO SOBRE LA GUÍA, COMPATIBLE CON GUÍA 0.014", LONGITUD 150 CM, PRESIÓN DE RUPTURA 15 A 16 ATM, DIÁMETRO 1.25 A 5.0 MM, LONGITUD MÁXIMA 220 MM", ya que las especificaciones y matriz de medidas ofertadas, superan a las requeridas por la convocante. ¿Se acepta?	SISE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinamia Partida 2
110	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	6	En el Anexo 3, partida 16	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "CATÉTER GUÍA PARA ACCESO A CORONARIA DERECHA O IZQUIERDA POR TÉCNICA RADIAL, CON CURVAS Y ASAS NECESARIAS, RECUBRIMIENTO INTERNO DE PTFE, PUNTA RADIOPACA, DIÁMETRO 5 FR, LONGITUD 100 CM, DIÁMETRO INTERNO 0.056", ya que las especificaciones solicitadas son exclusivas de una marca y limitan la libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS	Hemodinamia Partida 2
111	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	7	En el Anexo 3, partida 17	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "CATÉTER GUÍA PARA ACCESO A CORONARIA DERECHA O IZQUIERDA POR TÉCNICA FEMORAL, CON CURVAS Y ASAS NECESARIAS, RECUBRIMIENTO INTERNO DE PTFE, PUNTA RADIOPACA, DIÁMETRO 6 Y 8 FR, LONGITUD 100 CM, DIÁMETRO INTERNO 0.070", 0.078" Y 0.088" RESPECTIVAMENTE", ya que las especificaciones solicitadas son exclusivas de una marca y limitan la libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS	Hemodinamia Partida 2
112	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	8	En el Anexo 3, partidas 18, 20 y 21	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "CATÉTER DIAGNÓSTICO FEMORAL, DIVERSAS CURVAS (INCLUIDAS MPA2, PIGTAIL 145°), EN 5 Y 6 FR, DIÁMETRO INTERNO 0.048" Y 0.057", LONGITUD 100 CM, RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, PUNTA ATRAUMÁTICA, ENMALLADO INTERNO", ya que los diámetros internos ofertados son mayores y permiten un mayor flujo interno, es decir, son superiores a las requeridas. ¿Se acepta?	SISE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinamia Partida 2
113	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	9	En el Anexo 3, partida 23	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "SISTEMA DE LIBERACIÓN DE ESPIRALES DE PLATINO DESPRENDIBLES MECÁNICAMENTE", ya que las especificaciones solicitadas son exclusivas de una marca y el método de liberación de espirales es indistinto, siempre que sea compatible con el espiral ofertado. ¿Se acepta?	SISE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinamia Partida 2
114	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	10	En el Anexo 3, partidas 26 y 28	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "INSUFLADOR PARA BALÓN DE ANGIOPLASTIA, CAPACIDAD DE 20 CC Y MEDIDOR FLUORESCENTE DE 30 ATM", ya que las especificaciones ofertadas, superan a las requeridas. ¿Se acepta?	SISE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinamia Partida 2
115	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	11	En el Anexo 3, partida 32	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "CATÉTER BALÓN DISEÑADO PARA CRUZAR OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS, PERIL DE ENTRADA DE 0.016", ULTRA BAJO PERIL DE CRUXE, DIÁMETRO DE BALÓN DE 1.1 MM, LONGITUDES EN 10, 15 Y 20 MM", ya que las especificaciones ofertadas, son específicas de una marca y limitan la libre participación, confirmando que las especificaciones ofertadas cumplen los requerimientos de un procedimiento coronario de oclusión total crónica. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
116	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	12	En el Anexo 3, partida 40 y 41	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "CUERDA GUÍA 0.014" PUNTA RECTA CON PUNTA CONIFICADA A 0.007 Y 0.010" ESPECIAL PARA OCCLUSIONES TOTALES, DISPONIBLE EN LONGITUDES DE 180 Y 300 CM", ya que las especificaciones ofertadas, confirmando que las especificaciones ofertadas cumplen los requerimientos de un procedimiento coronario de oclusión total crónica. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL GRAMAJE DE 12 G	Hemodinam la Partida 2
117	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	13	En el Anexo 3, partida 53	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "EXTENSION COAXIAL DE CATETER GUÍA CORONARIO, COMPATIBLE CON CATETER GUÍA 6 FR (LUMEN MÍNIMO 0.070"), DIÁMETRO INTERNO DE LA EXTENSIÓN 0.056", RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD 25 CM, ENMALLADO", ya que las especificaciones ofertadas no implican una desventaja durante el procedimiento. ¿Se acepta?	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinam la Partida 2
118	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	14	En el Anexo 3, partida 70	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "OCLUSOR PARACIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR, DISEÑO AUTOCENTRANTE, FABRICADO EN MALLA DE NITINOL Y PARCHES INTERNOS DE POLIESTER, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN TIPO MICROTORNILLO, DIÁMETROS DE 4 A 40 MM", ya que las especificaciones ofertadas son específicas de una sola marca y limita la libre participación, además que el dispositivo ofertado es aquel que cuenta con mayor soporte clínico en todo el mercado. ¿Se acepta?	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinam la Partida 2
119	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	15	En el Anexo 3, partida 74	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "DISPOSITIVO DE CIERRE ARTERIAL FABRICADO EN TAPON DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, PARA CALIBRES DE 5, 6 Y 7 FR", ya que las especificaciones requeridas son exclusivas de una marca y limita la libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES MENTIONADAS	Hemodinam la Partida 2
120	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	16	En el Anexo 3, partida 89	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "DISPOSITIVO DE CIERRE DE OREJUELA DE AURÍCULA IZQUIERDA, CON OLCUSOR DE MALLA DE NITINOL Y CUBIERTA INTERNA DE POLIESTER, CONTA DE UN LOBULO DISTAL AUTOCENTRANTE CON GUÍAS ESTABILIZADORAS PARA FIJACIÓN EN LA OREJUELA, CINTURA CONECTORA Y DISCO PROXIMAL, MARCAS RADIOFACAS PROXIMAL, INTERMEDIAS Y DISRAL. SISTEMA DE LIBERACIÓN CON MICROTORNILLO PRECARGADO CON EL OCLUSOR. INCLUYE CAMISA Y DILATADOR CON CURVA TRIDIMENSIONAL DE 45°x45°. CALIBRE 12 O 14 FR", ya que las especificaciones requeridas son exclusivas de una marca y limita la libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS PARTICIPANTES	Hemodinam la Partida 2
121	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV (MEDINAMICS)	17	En el Anexo 3, partida 9,	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "CATETER ANGIOGRÁFICO CURVA MP, CALIBRE 5 FR", ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO REFERENCIE 6 FRENCH	Hemodinam la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
122	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	18	En el Anexo 3, partida 51	Se le solicita a la convocante elimine la partida de "KIT DE DENERVACIÓN RENAL...", ya que este dispositivo no cuenta con resultados clínicos favorables. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA YA QUE HAY NUEVA EVIDENCIA FAVORABLE AL PROCEDIMIENTO	Hemodinamia Partida 2
123	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	19	En el Anexo 3, partida 52	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "DISPOSITIVO DE ATERCOTOMIA DIRECCIONAL PERIFERICA", ya que las especificaciones requeridas son exclusivas de una marca y limita la libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA YA QUE SE REQUIERE EL PROCEDIMIENTO PARA ARTERIAS CORONARIAS	Hemodinamia Partida 2
124	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	20	En el Anexo 3, partida 60	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un "INTRODUCTOR DE MULLINS DE 8 Y 8.5 FR". ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA DEBE SER DE 7 A 12 FRENCH	Hemodinamia Partida 2
125	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A DE C.V.	1	Punto 4.6.1 Propuesta técnica Servicio Integral de Hemodinamia inciso kk).	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita participar en la licitación ya que nuestra empresa se encuentra en el proceso para iniciar la certificación del ISO de calidad.	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL INCISO KK PERO SE ACLARA QUE DEBE DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LOS INCISOS SSS Y CC DE LAS BASES.	Hemodinamia Partida 2
126	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	1	1.2	¿Es correcto entender que todas las respuestas que emita la convocante a la Junta de Aclaraciones para la presente licitación serán motivadas y fundamentadas?	ES CORRECTO	Hemodinamia Partida 2
127	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	1	3. Garantías 3.1 De los Servicios	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la finalidad de la póliza de responsabilidad civil, ya que al amparo de la Ley de Adquisiciones los distintos tipos de fianzas cubre cualquier necesidad o inconsistencia que se tenga durante la prestación del servicio.	Las fianzas solicitadas en bases una es para el sostenimiento e la propiedad, otra para el cumplimiento el ato para caso de la póliza de responsabilidad civil es para hacer frente a los daños personales, materiales y con consecuencias que involuntariamente por errores u omisiones el personal del proveedor adjudicado pueda causar a los pacientes, instalaciones y personal de la institución	Hemodinamia Partida 2
128	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	3	4.2 Servicio Integral de Diálisis y hemodálisis	Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación disminuya el porcentaje de muestras solicitadas	DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS	Diálisis y Hemodálisis Partida 1
129	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	4	4.2 Servicio Integral de Hemodinamia	Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación disminuya el porcentaje de muestras solicitadas	DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS	Hemodinamia Partida 2
130	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	5	4.5 Documentación Legal-Administrativa inciso G	¿Es correcto entender que éste inciso sólo aplica para licitantes con domicilio propio y para los licitantes que arrendan oficinas bastará con presentar copia del contrato de arrendamiento?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
131	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	6	4.5 Documentación Legal-Administrativa inciso H	¿Es correcto entender que por tratarse de una Licitación Pública los licitantes no estamos obligados a estar registrados en el padrón de Proveedores de la CDMX?	DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN PUBLICADA EL 28 DE JUNIO DE 2018, ESTABLECE QUE DICHA CONSTANCIA ES EXIGIBLE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Y POR ADJUDICACIÓN DIRECTA	Hemodinam la Partida 2
132	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	7	4.5 Documentación Legal-Administrativa inciso k	Se le solicita amablemente a la convocante especifique el tipo de aseguramiento solicitado para el total cumplimiento de este punto.	DEBERÁ PRESENTAR LA "CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS" CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.	Hemodinam la Partida 2
133	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	8	4.5 Documentación Legal-Administrativa inciso k y l	Solicitamos amablemente a la convocante permita acreditar estos incisos con opiniones de cumplimiento vigentes y positivas de Outsourcing ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EL ALTA PATRONAL, RECIBOS DE PAGO DEL ÚLTIMO BIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y LA RELACIÓN DE LOS EMPLEADOS CONTRATADOS BAJO ESTA MODALIDAD, ASÍ COMO EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL PERSONAL Y LOS MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS	Hemodinam la Partida 2
134	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	9	4.5 Documentación Legal-Administrativa inciso k y l	En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación especifique los requisitos para personal contratado por outsourcing	SE ACEPTA SU PROPUESTA, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EL ALTA PATRONAL, RECIBOS DE PAGO DEL ÚLTIMO BIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y LA RELACIÓN DE LOS EMPLEADOS CONTRATADOS BAJO ESTA MODALIDAD, ASÍ COMO EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL PERSONAL Y LOS MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS	Hemodinam la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
135	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	10	4.6.1 Propuesta Técnica inciso C Servicio integral de Diálisis y Hemodiálisis	Solicitamos a la convocante que para no limitar la libre participación permita presentar para el cumplimiento de éste punto contratos de similares características ¿Se acepta nuestra propuesta?	LA CONVOCANTE SOLICITA PARA LA PARTIDA 1 CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE DIALISIS Y/O HEMODIALISIS, EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS. NO SE ACEPTA, DEBERÁ ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE ENTREGARÁ LA LISTA DEL PERSONAL QUE PROPORCIONARÁ ASISTENCIA TÉCNICA Y ESTE DEBERÁ CONTAR CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN HEMODIALISIS, DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE Y DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA	Hemodiam a Partida 2
136	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	11	4.6.1 Propuesta Técnica inciso G	Solicitamos a la convocante que para no limitar la libre participación permita presentar para el cumplimiento de éste punto personal capacitado en la prestación de servicios de salud de similares características ¿Se acepta nuestra propuesta?		Hemodiam a Partida 2
137	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	12	4.6.1 Propuesta Técnica inciso P	Solicitamos a la convocante que para no limitar la libre participación permita presentar las fianzas consideradas como requisitos mínimos en la Ley de Adquisiciones ¿Se acepta nuestra propuesta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR LA FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA SU PROPUESTA, LA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ALA FIMA DEL MISMO, ASI COMO LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.	Hemodiam a Partida 2
138	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	13	4.6.1 Propuesta Técnica inciso C Servicio integral de Hemodinamia	¿Es correcto entender que se permitirá presentar únicamente las hojas útiles necesarias para corroborar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas?	PODRÁ REFERENCIAR LAS PÁGINAS DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES O FOLLETOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS	Hemodiam a Partida 2
139	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	14	4.6.1 Propuesta Técnica inciso D Servicio integral de Hemodinamia	Solicitamos atentamente a la convocante permita presentar esta información en caso de resultar adjudicados a la firma del contrato ¿Se acepta nuestra propuesta?	DEBERÁ PRESENTAR AL MENOS UNA MARCA PRINCIPAL, DE PREFERENCIA HASTA TRES	Hemodiam a Partida 2
140	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	15	4.6.1 Propuesta Técnica inciso KK Servicio integral de Hemodinamia	Considerando que el ISO 9001-2008 ya no se encuentra vigente. Solicitamos amablemente a la convocante sea obligatorio presentar sólo ISO 9001-2015 con alcance en la prestación del servicio integral de hemodinamia. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SE ACLARA QUE LOS CERTIFICADOS DEBERÁN SER VIGENTES	Hemodiam a Partida 2
141	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	16	4.6.1 Propuesta Técnica inciso O) Servicio integral de Hemodinamia	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar copia de su título y/o cédula profesional de al menos 4 personas en carreras médicas afines. Derivado que son documentos personales y que son de utilidad para los profesionistas.	PODRÁ ENTREGAR COPIA DE TÍTULO Y/O CÉDULA PROFESIONAL, ASI COMO COPIA DEDOCUMENTO QUE ACREDITE SUCAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA CON ANTIGÜEDAD	Hemodiam a Partida 2
142	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	17	4.6.1 Propuesta Técnica inciso O) Servicio integral de Hemodinamia	En caso de ser negativa a nuestra pregunta anterior solicitamos amablemente a la convocante nos motive y fundamente el motivo de solicitar ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO PARA COTEJO DEL TÍTULO y/o CÉDULA PROFESIONAL EN CARRERAS MÉDICAS AFINES.	NO APLICA	Hemodiam a Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
143	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	18	4.6.1 Propuesta Técnica inciso O) Servicio Integral de Hemodinamia	¿Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que las carreras médicas afines pueden ser Ing. Biotecnólogo y Licenciado en enfermería?	SEACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ACREDITESU CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS EN HEMODINAMIA	Hemodinamia Partida 2
144	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	19	4.6.1 Propuesta Técnica inciso O) Servicio Integral de Hemodinamia	¿Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la libre participación nos permita presentar Ing. Biotecnólogo Y Licenciado en enfermería?	RESPONDIDA EN EL ANTERIOR	Hemodinamia Partida 2
145	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	20	ANEXO 19 Formato para la propuesta económica	¿Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare de qué manera se cotizará la partida 2 "Servicio Integral de Hemodinamia si por servicio o por insumo señalados en el anexo 3? Derivado de que en el anexo 2 ficha técnica "etapa 2 trámite administrativo" menciona que se deberá de entregar en ventanilla de finanzas factura por INSUMO utilizados de acuerdo con el anexo 2 y 3. De igual manera lo señalado en el ANEXO TÉCNICO numeral 6. Lugar, plazos y condiciones de la prestación del servicio "El servicio integral se paga por cada insumo del ANEXO 3. Favor de aclarar	RESPONDIDA EN LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONVOCANTE	Hemodinamia Partida 2
146	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	21	ANEXO 19 Formato para la propuesta económica	En relación a nuestra pregunta anterior solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar el siguiente formato de propuesta económica para cotizar los insumos del anexo 3. El cual se adjunta al presente escrito	RESPONDIDA EN LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONVOCANTE	Hemodinamia Partida 2
147	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	22	ANEXO 19 Formato para la propuesta económica	¿Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que en caso de que mi representa oferte lo solicitado para el Servicio Integral de Hemodinamia "partida 2" no será necesario cotizar la partida 1 "Servicio Integral de Diálisis y Hemodialisís?	RESPONDIDA EN LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONVOCANTE	Hemodinamia Partida 2
148	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	23	1.1 Objeto del procedimiento de licitación pública nacional	¿Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si para este procedimiento será adjudicado por partida?	YA ACLARADA POR LA CONVOCANTE	Hemodinamia Partida 2
149	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	24	4.6.1 Servicio Integral de Hemodinamia inciso S)	¿Entendemos que los certificados de calidad a que refiere son (FDA ó CE ó JIS ó TUV ó iso 9001-2015 ó iso 13485	SI, DEBERÁ PRESENTAR PARA EQUIPOS: FDA ó CE ó JIS ó TUV Y ISO13485 VIGENTES. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRESENTAR ISO 9001-2015 A NOMBRE DEL LICITANTE CON ALCANCE EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA	Hemodinamia Partida 2
150	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	25	4.6.1 Servicio Integral de Hemodinamia inciso S)	¿ En caso de ser negativa a nuestra pregunta anterior. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar de esa manera los certificados anteriormente señalados.	NO APLICA	Hemodinamia Partida 2
151	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV	26	4.6.1. Servicio Integral de Hemodinamia inciso S)	¿Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si será necesario referenciar los certificados solicitados de acuerdo al numeral de los insumos y equipos propuestos?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
152	AMPHARMA, S.A.	1	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA A) "CONSTANCIA DE ADEUDOS", EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) CON FECHA NO MAYOR A DOS MESES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 2 DE ANEXOS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, IMPUESTO SOBRE NÓMINA, IMPUESTO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, LAS CONSTANCIAS DEBEN SER ACREDITADAS CON EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL LICITANTE. PARA EL CASO DE LOS DERECHOS SOBRE SUMINISTRO DE AGUA, SE DEBERÁ PRESENTAR LA "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 4.6 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA A. CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE, ACTUALIZADO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTA EN LA QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN ESTE TIPO DE SERVICIO INTEGRAL, PRESTANDO SERVICIOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE ENTENDERÁN POR CARACTERÍSTICAS SIMILARES LOS CONTRATOS QUE ACREDITEN EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA, CON EQUIPO EN PRÉSTAMO PERMANENTE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE HAYA TENIDO UNA VIGENCIA DENTRO DE LOS 18 MESES PREVIOS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA, INCLUYENDO NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES, PERSONA DE CONTACTO Y TELÉFONO, FECHA Y VIGENCIA DEL SERVICIO, PARA LO ANTERIOR LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR COPIA DE AL MENOS UN CONTRATO FORMALIZADO, EN EL O LOS CUALES, PARA SER CONSIDERADOS DEBERÁN ACREDITAR CADA UNO DE ELLOS, UN MONTO SIMILAR AL DEL IMPORTE MÁXIMO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.	MI REPRESENTADA NO CUENTA CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENCONTRÁNDOSE EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA EN JALISCO, POR LO QUE ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHA CONSTANCIA NO NOS ES APLICABLE? ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	YA ACARADA EN LA PRECISIÓN NUMERO 23.	Hemodinamia Partida 2
153	AMPHARMA, S.A.		4.6 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA A. CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE, ACTUALIZADO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTA EN LA QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN ESTE TIPO DE SERVICIO INTEGRAL, PRESTANDO SERVICIOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE ENTENDERÁN POR CARACTERÍSTICAS SIMILARES LOS CONTRATOS QUE ACREDITEN EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA, CON EQUIPO EN PRÉSTAMO PERMANENTE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE HAYA TENIDO UNA VIGENCIA DENTRO DE LOS 18 MESES PREVIOS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA, INCLUYENDO NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES, PERSONA DE CONTACTO Y TELÉFONO, FECHA Y VIGENCIA DEL SERVICIO, PARA LO ANTERIOR LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR COPIA DE AL MENOS UN CONTRATO FORMALIZADO, EN EL O LOS CUALES, PARA SER CONSIDERADOS DEBERÁN ACREDITAR CADA UNO DE ELLOS, UN MONTO SIMILAR AL DEL IMPORTE MÁXIMO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE AL MENOS UN CONTRATO FORMALIZADO O COPIA SIMPLE DEL ACTA DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DE FALLO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA. DEBERA PRESENTAR COPIA DE UN CONTRATO DE CARACTERISTICA SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION FORMALIZADO EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
154	AMPHARMA, S.A.	3	4.2 MUESTRAS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 8 INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, SE SEÑALAN LA FORMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS MUESTRAS ENLISTADAS EN EL ANEXO 8 PARA SU EVALUACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES DEL 100% DE LOS RENGLONES SEÑALADOS EN EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019, EN UN HORARIO DE 09:00 A LAS 12:00 HORAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS MUESTRAS 4.6 PROPUESTAS.4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA O DEBERÁ ENTREGAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA PARA AL MENOS 4 PERSONAS COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO PARA COTEJO DEL TÍTULO Y/O CÉDULA PROFESIONAL EN CARRERAS MÉDICAS AFINES, ASÍ COMO COPIA DE DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA, EL CUAL NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE	DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 8, ENTENDEMOS QUE SE DEBEN PRESENTAR MUESTRAS SOLO DEL LISTADO QUE FORMA PARTE DEL CUERPO EN EL ANEXO 8 ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	ES CORRECTO UNA MUESTRA DE CADA UNA	Hemodinam la Partida 2
155	AMPHARMA, S.A.	3B	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1.PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA KK. DEBERÁ PRESENTAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA CERTIFICADO ISO DE CALIDAD A NOMBRE DEL LICITANTE. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO DEL CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, QUE HAGA CONSTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX- CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 O ISO 9001:2015, QUE CONTEMPLE CUANDO MENOS EL SIGUIENTE	LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS EN CUESTION SON PROPIEDAD DE LOS COLABORADORES Y NO PERTENECEN A LA EMPRESA, SIN EMBARGO, LA EMPRESA CUENTA CON COPIA DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL CONTRATADO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, Y EN EL ENTENDIDO QUE ESOS DOCUMENTOS ORIGINALES SON PROPIEDAD DE LOS COLABORADORES, ¿BASTARÁ CON PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS Y CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE INDIQUEMOS QUE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL?	SE ACEPTA PRESENTAR COPIA SIMPLE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTESY CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE INDIQUEMOS QUE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL.	Hemodinam la Partida 2
156	AMPHARMA, S.A.	4	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1.PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA KK. DEBERÁ PRESENTAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA CERTIFICADO ISO DE CALIDAD A NOMBRE DEL LICITANTE. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO DEL CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, QUE HAGA CONSTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX- CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 O ISO 9001:2015, QUE CONTEMPLE CUANDO MENOS EL SIGUIENTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA CADA LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	NOSE ACEPTA. DEBERA DE PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2015 VIGENTE CON ALCANCEEN SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA A NOMBRE DEL LICITANTE	Hemodinam a Partida 2
157	AMPHARMA, S.A.	5	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA S. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR CON SU PROPUESTA TÉCNICA ORIGINAL O COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES POR CADA MARCA DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS QUE OFERTE EN EL ANEXO 1.1 (ANEXOS TÉCNICOS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA).	ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES POR CADA MARCA DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS QUE OFERTE EN EL ANEXO 1.1 (ANEXOS TÉCNICOS SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA).	PODRA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD FDA O TUV O JIS O CE,ASI COMO DEL CERTIFICADO ISO13485 VIGENTE TANTO PARA LOS INSUMOS PARA LOS EQUIPOS EN PRESTAMO PERMANENTE	Hemodinam la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
158	AMPHARMA, S.A.	6	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1. PROPUESTA TÉCNICA SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA LL. DOCUMENTO FIRMADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL PROVEEDOR, EN EL QUE INDIQUE QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB, DEBIENDO CONTAR CON SOPORTE TÉCNICO, ACCESO INSTANTÁNEO A LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA OPERACIÓN Y CONTANDO PRINCIPALMENTE CON: CENSO DIARIO POR UNIDAD HOSPITALARIA. SOLICITUD DE MATERIAL QUIRÚRGICO. REPORTES DE EVENTOS Y CONSUMOS. ARCHIVO DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS EVENTOS CONSULTA E INCIDENCIAS Y. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR A LA "SEDESA" EL SOFTWARE DESCRITO EN EL ANEXO 7 EN LAS OFICINAS CENTRALES DE "LA CONVOCANTE", EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS Y EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS. ASÍ TAMBIÉN OTORGAR LA CAPACITACIÓN PARA SU CONSULTA, Y EN CASO DE REQUERIRSE PROPORCIONAR EQUIPO DE COMPUTO Y/O IMPRESORA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE SOFTWARE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE, ANEXO 6.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ES CORRECTO	ES CORRECTO	Hemodinamia la Partida 2
159	AMPHARMA, S.A.	7	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 41 GUIA RECUBIERTA DE POLYTETRAFLUORETILENO (PTFE) PARAV CATETER CON PUNTA "J" DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 195 CM A 300 CMS DE LARGO. FORMA DE PUNTA DISTAL RADIOPACA EN FORMA DE DOMO O CUÑA, PARA OCLUSIONES TOTALES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA 41 GUIA RECUBIERTA DE POLYTETRAFLUORETILENO (PTFE) PARAV CATETER CON PUNTA "J" DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 195 CM A 300 CMS DE LARGO. FORMA DE PUNTA DISTAL RADIOPACA EN FORMA DE DOMO O CUÑA, PARA OCLUSIONES TOTALES 3 G, 4.5 G, 6.0 G, 9.0 G Y 12.0 G CON PUNTA DISTAL FORMO DE CUÑA 195 CM Y 300 CM LONGITUD ¿SE ACEPTA?	Podrá ofertar sin ser limitante a los demás participantes	Hemodinamia la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
160	AMPHARMA, S.A.	8	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 45 DESFIBRILADOR BICAMERAL CARDIOVERSOR AUTOMATICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. AL MENOS 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA EL DIFERENCIAMIENTO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES DE LAS VENTRICULARES, LONGEVIDAD MINIMA DE 6 AÑOS A LONGEVIDAD MINIMA DE 8 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR. AL MENOS 72 MIN DE MEMORIA PARA ELECTROGRAMAS. CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACION REMOTA AUTOMATICA DE PACIENTE. CONECTORES IS-1/DF-4 PARA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR BICAMERAL CARDIOVERSOR AUTOMATICO DEFINITIVO IMPLANTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS, CON FUNCIONES DE MARCAPASO. AL MENOS 2 ALGORITMOS DIFERENTES PARA EL DIFERENCIAMIENTO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES DE LAS VENTRICULARES, LONGEVIDAD MINIMA DE 6 AÑOS A PARAMETROS ESTÁNDAR AL MENOS 45 MIN DE MEMORIA PARA ELECTROGRAMAS CON POSIBILIDAD DE MONITORIZACION REMOTA AUTOMATICA DE PACIENTE. CONECTORES IS-1/DF-4 PARA ELECTRODOS. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES	Hemodinamia Partida 2
161	AMPHARMA, S.A.	9	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 48 DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACION CARDIACA, CON DESFIBRILADOR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, MEDICION AUTOMATICA DEL UMBRAL DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CAPACIDAD DE CARGAR 40J MAS DE 6 CHOQUES POR ZONA DE ARRITMIA, 3 VECTORES DISTINTOS PARA ENTREGA DE CHOQUE. CAPACIDAD DE ENTREGAR TERAPIA ANTICARDIA EN ZONA DE FV, CON ALGORITMOS ESPECIALES PARA LA DISCRIMINACION DE TSV Y TV, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION VENTRICULAR IZQUIERDA EN DOS PUNTOS DEL MISMO CABLE CON INTERVALOS PROGRAMABLES, CON LONGEVIDAD MINIMA DE 6.6 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO ¿SE ACEPTA?	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 48 DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACION CARDIACA, CON DESFIBRILADOR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, MEDICION AUTOMATICA DEL UMBRAL DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CAPACIDAD DE CARGAR 40J DE ENERGIA MAXIMA, CAPACIDAD DE ENTREGAR 6 CHOQUES POR ZONA DE ARRITMIA, 3 VECTORES DISTINTOS PARA ENTREGA DE CHOQUE, CAPACIDAD DE ENTREGAR TERAPIA ANTICARDIA EN ZONA DE FV, CON ALGORITMOS ESPECIALES PARA LA DISCRIMINACION DE TSV Y TV, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION VENTRICULAR IZQUIERDA EN DOS PUNTOS DEL MISMO CABLE CON INTERVALOS PROGRAMABLES, CON LONGEVIDAD MINIMA DE 6.6 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES	Hemodinamia Partida 2
162	AMPHARMA, S.A.	10	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 49 DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACION CARDIACA, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, AJUSTE AUTOMATICO DE LA ENERGIA DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, 6 DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION VENTRICULAR IZQUIERDA EN DOS PUNTOS DEL MISMO CABLE CON INTERVALOS PROGRAMABLES, CON LONGEVIDAD MINIMA DE 8 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO, COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA ¿SE ACEPTA?	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 49 DISPOSITIVO DE TERAPIA PARA RESINCRONIZACION CARDIACA, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS ADVERSOS, AJUSTE AUTOMATICO DE LA ENERGIA DE ESTIMULACION EN LAS TRES CAMARAS, CON HISTERESIS NEGATIVA AV, 6 DISTINTOS VECTORES DE ESTIMULACION VENTRICULAR IZQUIERDA EN DOS PUNTOS DEL MISMO CABLE CON INTERVALOS PROGRAMABLES, CON LONGEVIDAD MINIMA DE 8 AÑOS CON ESTIMULACION 100 % BIVENTRICULAR, CON MONITORIZACION DE INSUFICIENCIA CARDIACA, CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO, COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
163	AMPHARMA, S.A.	11	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 65 MARCAPASO BICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE DOBLE CAMARA PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, CON FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO. CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y MEDICION DEL UMBRAL DE ESTIMULACION. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 10 AÑOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA 65 MARCAPASO BICAMERAL, MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO IMPLANTABLE DOBLE CAMARA PARA EL TRATAMIENTO DE BRADICARDIAS, CON ADAPTACION DE FRECUENCIA, FRECUENCIA NOCTURNA PROGRAMABLE, CONTROLES AJUSTABLES DE VOLTAJE Y ANCHO DE PULSO. CON FUNCION DE AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD Y MEDICION DEL UMBRAL DE ESTIMULACION. ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS PARA EL GRABADO DE EVENTOS. LONGEVIDAD MINIMA DE 9.5 AÑOS ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES	Hemodinam ia Partida 2
164	AMPHARMA, S.A.	12	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 51 KIT DE DENERVACION, QUE INCLUYE BALON PARA DERIVACION DE 4, 5, 6 O 7 CM X 25 MM, CATÉTER GUÍA 8 FR, GUÍA DE 0.018, INTRODUTOR, INCLUYE EQUIPO PARA DENERVACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A DERIVACION RENAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SEREFIERE AL PROCEDIMIENTO DE DENERVACION RENAL	Hemodinam ia Partida 2
165	AMPHARMA, S.A.	13	ANEXO 8 MUESTRAS MUESTRAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	LA MUESTRA MARCADA CON EL NO. 87 (89 EN EL ANEXO 3) EN EL LISTADO DENOMINADO COMO: DISPOSITIVO PARA CIERRE DE OREJUELA DE AURÍCULA IZQUIERDA CON MARCO AUTO-EXPANDIBLE DE NITINOL, RECUBRIMIENTO PERMEABLE DE PET DE 160 MICRONES Y ANCLAS DE FIJACIÓN, PRE-MONTADO EN SISTEMA DE LIBERACIÓN 12F CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA. EN MEDIDAS DE 21MM A 33 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ACCESO PARA DISPOSITIVO DE CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA CON DILATADOR, CATÉTER DE PEBAX CON TRES MARCAS PROXIMALES DE PLATINO-IRIDIO Y UNA MARCA DISTAL, DIÁMETRO INTERNO 12F Y EXTERNO DE 14F, 75CM DE LONGITUD. EN CURVA SENCILLA Y CURVA DOBLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN REALIDAD ES EL NUMERO 89 DEL ANEXO 3Y POR CONSIGUIENTE ES EL QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA PRESENTAR LA MUESTRA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA	Hemodinam ia Partida 2
166	AMPHARMA, S.A.	14	ANEXO 8 MUESTRAS MUESTRAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN MUESTRAS ABIERTAS ¿SE ACEPTA?	Podrán presentar muestras abiertas, nuevas, completas y no utilizadas, en su empaque original y con el etiquetado correcto	Hemodinam ia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
167	AMPHARMA, S.A.	15	ANEXO 3 LISTA DE INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES DE HEMODINAMIA 78 y 79	DE LOS RENGLONES 78 Y 79 ESTABLECIO EN EL ANEXO 3 DE LOS ANEXOS TECNICOS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, NO HACE FALTA MAS DE UN METODO DE VISUALIZACION INTRACORONARIA, YA SEA POR TECNICA DE ULTRASONIDO O POR TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA, POR LO QUE SOLICITAMOS SEA OPCIONAL UNO U OTRO ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE SI HACE FALTA MAS DE UN METODO PARA LA VISUALIZACION INTRACORONARIA, POR LO QUE SE REQUIERE TANTO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO COMO DE TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA	Hemodinamia Partida 2
168	AMPHARMA, S.A.	16	SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 4 PUNTO 3.- ELECTROCAUTERIO	EN EL ANEXO 4 PUNTO 3.- ELECTROCAUTERIO EN EL REQUISITO DE COAGULACION MONOPOLAR, MANIFIESTAN SEA DE 180 WATTS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE 120 WATTS.	Se puede ofertar sin ser limitante para las demás participantes	Hemodinamia Partida 2
169	AMPHARMA, S.A.	17	SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 4 PUNTO 3.- ELECTROCAUTERIO	EN EL ANEXO 4 PUNTO 3.- ELECTROCAUTERIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PUEDA CONFIGURAR PROTOCOLOS DE CIRUGIAS EN EL EQUIPO, PARA QUE SEA MAS RAPIDO Y PRACTICO SU USO.	Se puede ofertar sin ser limitante para las demás participantes	Hemodinamia Partida 2
170	AMPHARMA, S.A.	18	SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 4 PUNTO 5.- ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES	EN EL ANEXO 4 PUNTO 5.- ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES EN EL REQUISITO DE NUMERO DE ESTUDIOS, SOLICITAN QUE SEAN 200, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE ALMACENE POR LO MENOS 100 ESTUDIOS.	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS	Hemodinamia Partida 2
171	AMPHARMA, S.A.	19	SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 4 PUNTO 5.- ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES	EN EL ANEXO 4 PUNTO 5.- ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PERMITA INSTALAR POR SEPARADO UNA APLICACION WEB, PARA GUARDAR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN EL ANEXO 4.4 FICHA TECNICA DE ECOCARDIOGRAFO PORTATIL, LA DESCRIPCION CORRESPONDE A UN ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES, Y EL ANEXO 4.5 FICHA TECNICA DE ELECTROCARDIOGRAFO	NO SE ACEPTA DADO QUE EN LA SALANO HAY SEÑAL DE INTERNET	Hemodinamia Partida 2
172	AMPHARMA, S.A.	20	SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 4.4 FICHA TECNICA DE ECOCARDIOGRAFO PORTATIL		ES CORRECTA SU APRECIACION	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
173	AMPHARMA, S.A.	21	SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN EL ANEXO 4.4 PUNTO 14	ANEXO 4.4 PUNTO 14, SOLICITAMOS A LA COVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN FORMATO PDF DE AL MENOS 200 ECG EN SU MEMORIA INTERNA Y CAPACIDAD A FUTURO EXPANDIBLE A 200 VÍA MEMORIA USB, ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES	Hemodinamia la Partida 2
174	KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE CV.	1	4.6.1 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, INCISO KK	EN EL NUMERAL 4.6.1 EN EL INCISO KK SE SOLICITA PRESENTACION DE CERTIFICADO ISO 9001:2008 O 9001:2015. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL CERTIFICADO ISO 9001:2008 HA QUEDADO SIN VALIDEZ PARA EL ORGANO EMISOR DEL MISMO DESDE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITAMOS A LA COVOCANTE QUE EL UNICO CERTIFICADO VALIDO PARA PRESENTACION SEA EL ISO 9001:2015 ¿SE ACEPTA?	Se Aclara que deberá presentar el Certificado ISO 9001 vigente; por lo que deberá ser ISO9001:2015 con alcance en Servicio Integral de Hemodinamia	Hemodinamia la Partida 2
175	KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE CV.	2	ANEXO No. 1, PAGINA 65, SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	EN EL ANEXO 1 LA COVOCANTE MENCIONA EL TOTAL MINIMO Y MAXIMO DE PROCEDIMIENTOS A REALIZAR SIN ESPECIFICAR DETALLE DE CANTIDAD POR PROCEDIMIENTO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA COVOCANTE NOS PROPORCIONEA DETALLE LA CANTIDAD POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS A REALIZAR DE ACUERDO CON EL LISTADO DE LOS 13	Se aclara que en el anexo 3 se relaciona los insumos. El pago de cada servicio realizado será la suma de los insumos utilizados, no es el costo por cada procedimiento.	Hemodinamia la Partida 2
176	KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE CV.	3	3.2. DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS	EN EL NUMERAL 3.2 SE SOLICITA QUE "LOS LICITANTES DEBERÁN GARANTIZAR LA FORMALIDAD DE SUS PROPUESTAS, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, SIN INCLUIR I.V.A." CONSIDERANDO QUE CADA PROCEDIMIENTO LLEVA INSUMOS DIFERENTES, LO QUE IMPLICA UNA VARIACIÓN EN SU VALOR Y DEBIDO A QUE EN LAS BASES NO SE ESPECIFICA EL TOTAL MINIMO Y MAXIMO POR TIPO DE PROCEDIMIENTO, LO QUE EN ESTE MOMENTO IMPOSIBILITA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y POR TANTO LA DETERMINACIÓN DEL MONTO EQUIVALENTE AL 5% SOLICITA A LA COVOCANTE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA GARANTÍA O EN SU CASO, LA ELIMINACIÓN DE ESTE REQUERIMIENTO, PUES AUN CUANDO SE DETALLE LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS EN JUNTA DE ACLARACIÓN EL TIEMPO RESTANTE ENTRE ESTA Y LA ENTREGA DE PROPUESTAS ABARCA DIAS INHABILES POR LO QUE NO ES FACTIBLE OBTENER LA GARANTÍA SOLICITADA EN TIEMPO. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE SU PROPUESTA POR EL 5% DEL MONTO MÁXIMO A EJERCER SIN CONSIDERAR IMPUESTOS	Hemodinamia la Partida 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
177	KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE CV.	4	ANEXO No. 8, PÁGINA 91 , PARTIDA 29	EN LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 29 DE LA CUAL DEBE PRESENTARSE LA MUESTRA DICE: "CONTENEDOR DE MEDIO DE CONTRASTE CON CAPACIDAD DE 100ML. PUERTO DE ENTRADA CON ESPIGA PARA BOTELLA DE MEDIO DE CONTRASTE Y PUERTO DE SALIDA CON CONEXIÓN LUER DE ALTA PRESIÓN. ESTÉRIL, DESECHABLE, PARA UTILIZARSE CON HASTA 5 PACIENTES CONSECUTIVOS EN UN PERIODO DE 12 HORAS. COMPATIBLE CON EL SISTEMA INYECTOR ACIST CVI." CONSIDERANDO QUE EL INYECTOR ES UN EQUIPO QUE DEBERA SER PRESENTADO A COMODATO Y ESTE PUEDE SER DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL ANEXO 4.6 Y DADO QUE EL MATERIAL SOLICITADO EN MUESTRA REFIERE A UNA MUESTRA COMPATIBLE CON UNA MARCA ESPECIFICA DE INYECTOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTA PARTIDA DE LA PRESENTACION DE MUESTRAS O PERMITA ENTREGAR MUESTRA SIMILAR QUE SEA COMPATIBLE CON EL INYECTOR A ENTREGAR POR PARTE DEL LICITANTE. ¿SE	SEDESaYa cuenta con el Inyector de Medio de contraste, por eso se pide ese contenedor de medio de contraste. Podrá entregar una muestra similar señalando que es compatible con su equipo, mismo que pretende ofertar en préstamo permanente.	Hemodinam la Partida 2
178	KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE CV.	5	ANEXO No. 8, PÁGINA 91 , PARTIDA 30	EN LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 DE LA CUAL DEBE PRESENTARSE LA MUESTRA DICE: "KIT DE MANIFOLD AUTOMATIZADO, CON DOMO DE PRESIÓN PARA COMPATIBLE CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN REUSABLE, ESPIGA PARA BOLSA DE SOLUCIÓN SALINA Y CONECTOR DE ALTA PRESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO DE CONTRASTE. ESTÉRIL, DESECHABLE, UN SOLO USO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA INYECTOR ACIST CVI." CONSIDERANDO QUE EL INYECTOR ES UN EQUIPO QUE DEBERA SER PRESENTADO A COMODATO Y ESTE PUEDE SER DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL ANEXO 4.6 Y DADO QUE EL MATERIAL SOLICITADO EN MUESTRA REFIERE A UNA MUESTRA COMPATIBLE CON UNA MARCA ESPECIFICA DE INYECTOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTA PARTIDA DE LA PRESENTACION DE MUESTRAS O PERMITA ENTREGAR MUESTRA SIMILAR QUE SEA COMPATIBLE CON EL INYECTOR A ENTREGAR POR PARTE DEL LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	Podrá ofertar Inyector DE FLUJO VARIABLE de medio de contraste a comodato, sin ser limitante para las demás participantes. SE OMITE PRESENTAR LA MUESTRA.	Hemodinam la Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha técnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
179	KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE C.V.	6	ANEXO No. 8, PÁGINA 91 , PARTIDA 31	EN LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 31 DE LA CUAL DEBE PRESENTARSE MUESTRA DICE: "KIT DE CONTROLADOR MANUAL NEUMÁTICO CON BOTONES DE CONTRASTE Y DE SOLUCIÓN SALINA, AMBOS SENSIBLES A LA PRESIÓN MANUAL DEL OPERADOR. INCLUYE TAMBIÉN EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN DE 1.37CM DE LONGITUD Y 3 VÍAS DE ALTA PRESIÓN CON EXTREMO GIRATORIO LUEER LOCK. ESTÉRIL, UN SOLO USO, DESECHABLE. COMPATIBLE CON EL SISTEMA INYECTOR ACIST C.VI." CONSIDERANDO QUE EL INYECTOR ES UN EQUIPO QUE DEBERA SER PRESENTADO A COMODATO Y ESTE PUEDE SER DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL ANEXO 4.6 Y DADO QUE EL MATERIAL SOLICITADO EN MUESTRA REFIERE A UNA MUESTRA COMPATIBLE CON UNA MARCA ESPECIFICA DE INYECTOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTA PARTIDA DE LA PRESENTACION DE MUESTRAS O PERMITA ENTREGAR MUESTRA SIMILAR QUE SEA COMPATIBLE CON EL INYECTOR A ENTREGAR POR PARTE DEL LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	SE RESPONDIO EN LA PREGUNTA ANTERIOR	Hemodinamia Partida 2
180	KELARIS SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE C.V.	7	ANEXO No. 8, PÁGINA 91 , PARTIDA 38	EN LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38 DE LA CUAL DEBE PRESENTARSE MUESTRA DICE: "GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE PUNTA RECTA CON PUNTA RADIOPACA DE 0.014" LONGITUD 182CM DEL TIPO EXTRASUPPORT, INTERMEDIA, FLOPPY Y PT CHOICE EXTRA SUPPORT" CONSIDERANDO QUE LA MARCA PT CHOICE PERTENECE A UNA SOLA CASA COMERCIAL (BOSTON SCIENTIFIC) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA PRESENTACION DE MUESTRA DE MATERIAL DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION REQUERIDA Y PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	Podrá presentar su muestra, misma que sera evaluada para su aceptación o no.	Hemodinamia Partida 2

Consecutivo	EMPRESA (Razon Social)	No de de preg.	Numeral e Inciso de las bases al que se refiere la pregunta y/o numeral de la Ficha tecnica	Pregunta	Respuesta (Para uso exclusivo de la convocante)	Partida
		10	NUMERAL 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO H	DADO QUE ES UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLICITA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL TRAMITE SE ENCUENTRA EN PROCESO Y QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE PRESENTARÁ EL TRAMITE CONCLUIDO. ¿SE ACEPTA?	DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN PUBLICADA EL 28 DE JUNIO DE 2018, ESTABLECE QUE DICHA CONSTANCIA ES EXIGIBLE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Y POR ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		22	SERVICIO DE HEMODINAMIA	SOLICITAMOS SE CONSIDERE AGREGAR EN EL LISTADO DE EQUIPOS UN ARCO EN C EN COMODATO CON APLICACIONES CARDIOLOGICAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL DADO QUE LA SALA EN DONDE SE TIENE OPERACIONES CONSTANTEMENTE RETIENE O PARA OPERACIONES POR LOS AÑOS DE LA MISMA.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO	