



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2024, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES); SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS **ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO), ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.**-----

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL LIC. **SERGIO MENESES HERNÁNDEZ**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL **MTRO. JUAN CARLOS CASTILLO CARRIÓN**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE.-----

I.- EL QUE PRESIDE DA INICIO AL ACTO MANIFESTANDO QUE EXISTEN TRES PRECISIONES RESPECTO AL **NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO** POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y DEL ÁREA TÉCNICA EN EL SIGUIENTE SENTIDO.-----

1.- SE INFORMA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO QUE EN EL NUMERAL REFERIDO CON ANTELACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS", SE PRECISA QUE CONFORME AL CALENDARIO DE LOS ACTOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL COMPRANET, SE LLEVARÁ A CABO, EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES CONFORME A LOS SIGUIENTE:

"...

ACTO	FECHA	HORARIO	LUGAR
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	04 DE ABRIL DE 2024	12:00 HORAS	EL ACTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS FRACCIÓN II DE LA "LAASSP", A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET. AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, LOS LICITANTES ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR EN LOS ACTOS A TRAVÉS DE ESE MEDIO. HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0072



The screenshot displays the 'COMPRANET' interface. The main content area shows the following details:

- Código del expediente:** E-2024-00225209
- Numero de procedimiento de contratación:** LA-68-017-909007975-N-2-2024
- Estado del procedimiento de contratación:** VIGENTE JA.
- Código interno del procedimiento:** P-2024-00224551
- Nombre del procedimiento de contratación:** SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

The 'CRONOGRAMA DE EVENTOS' section lists the following key dates and locations:

Evento	Fecha y hora	Lugar
Fecha y hora de publicación	20/03/2024 19:46	VIA COMPRANET
Fecha y hora de junta de aclaraciones	25/03/2024 12:00	VIA COMPRANET
Fecha y hora de entrega de muestras	02/04/2024 12:00	DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE, No. 423, PISO 21 CONJUNTO HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO.

CABE SEÑALAR QUE EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EL DÍA 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR, EN ESTE SITIO PÚBLICO LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA QUE SE LLEVARÁN A CABO CADA UNO DE LOS ACTOS, LO CUAL SE AGREGA A LAS PRESENTE COMO EVIDENCIA PARA TALES EFECTOS.

2.- ASIMISMO EN ESTE MISMO ACTO EL ÁREA TÉCNICA HACE LA SIGUIENTE PRECISIÓN CON RESPECTO A LA FECHA SEÑALADA EN EL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO ANTES REFERIDO, PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACTO	FECHA	HORARIO	LUGAR
ENTREGA DE MUESTRAS	02 DE ABRIL DE 2024	DE 10:00 A 12:00 HORAS	LA ENTREGA DE MUESTRAS SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE, No. 423, PISO 21 CONJUNTO HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO.

3.- DE IGUAL FORMA LA CONVOCANTE HACE LA SIGUIENTE PRECISIÓN CON RESPECTO AL NUMERAL 6.3.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA.

DICE:

"...LA PROPOSICIÓN TÉCNICA SERÁ MIXTA DEBERÁ ENTREGARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INCLUYENDO TODOS LOS MANIFIESTOS CARTAS Y DOCUMENTACIÓN CONFORME, A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, PREVIÓ A SU DIGITALIZACIÓN. ..."

DEBE DECIR:

"... LA PROPOSICIÓN TÉCNICA SERÁ EN FORMA ELECTRÓNICA ENTREGÁNDOSE EN FORMATO PDF Y EXCEL EDITABLE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INCLUYENDO TODOS LOS MANIFIESTOS CARTAS Y DOCUMENTACIÓN CONFORME, A TODOS LOS REQUISITOS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO. ..."



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0073



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
MEMENTO DEL PALESTRADO, REVOLUCIONARIO Y GOBERNADOR DEL MEXICO

II.- ACTO SEGUIDO, SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS ESCRITOS DE INTERÉS EN PARTICIPAR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET HASTA ESTE MOMENTO, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE PREGUNTAS
1	HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.	CompraNet	Si	17
2	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	CompraNet	Si	2
3	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CompraNet	Si	2
Total de Preguntas				21

The screenshot shows the 'Solicitudes de aclaración' section of the COMPRANET system. It displays a table with the following columns: Num., Remitente, Fecha y hora de consulta del procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, and Acuse(s) de Respuestas. The table lists four companies: FRESSENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE CV, HEALTHY SA DE CV, HI-TEC MEDICAL SA DE CV, and IGSA MEDICAL SERVICES SA DE CV, with their respective consultation and interest expression dates and times.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE ADJUNTA ACUSE DE ENVÍO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DE LAS EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR DE FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO COMO ANEXO 1. -----

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA; ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL ÁREA CONTRATANTE Y LAS DE CARÁCTER TÉCNICO POR EL ÁREA TÉCNICA ASISTIDA POR EL ÁREA REQUIRENTE: -----

NO DE PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA DE "LA CONVOCANTE"
1	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.2 DE LA CONVOCATORIA. CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA ESTE EVENTO LICITATORIO, ES EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 A LAS 12:00 HORAS, COMO SE SEÑALA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET.	LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL DÍA Y LA HORA SEÑALADA EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL COMPRANET Y EN LA PRECISIÓN NÚMERO 1 DE LA PRESENTE ACTA. PARA EFECTOS DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES SERÁ EL 04 DE ABRIL A LAS 12:00 HORAS.
2	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	PLANTILLA DE PROPUESTA TÉCNICA (EXCEL)	EN LA PLANTILLA DE PROPUESTA TÉCNICA DE EXCEL, CORRESPONDIENTE A LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN DE LOS ANEXOS 1.3 (FICHAS TÉCNICAS), 1.4 (FICHA INSUMOS Y	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRANET SE HA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Cet' and 'Ka'.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



0074

2500

NO DE PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA DE "LA CONVOCANTE"
				MEDICAMENTOS, ANEXO 1.5 (FICHA POR EVENTOS) Y ANEXO 19 (PROPUESTA TÉCNICA), SOLICITA SE REALICE EL HIPERVINCULO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. SE HACE LA RESPETUOSA ACLARACIÓN A ESA H. CONVOCANTE, QUE AL COLOCAR LOS HIPERVINCULOS EN NUESTRO EXCEL, SE CORRE EL RIESGO DE QUE AL SUBIR NUESTRA PROPUESTA A LA PLATAFORMA DE COMPRANET, ESTOS SE PIERDAN Y SE GENERE UN ERROR AL MOMENTO DE SER ABIERTOS POR LA CONVOCANTE, ESTO DEBIDO A QUE NO ENCUENTRE LA RUTA DE LOS ARCHIVOS DE ORIGEN, POR TAL MOTIVO Y CON EL FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE, SE NOS PERMITA ÚNICAMENTE, SEÑALAR EL NÚMERO DE FOLIO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN CADA APARTADO DE LOS ANEXOS CITADOS, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO COLOCAR ESTOS HIPERVINCULOS SOLICITADOS.	SOLICITADO ESTE FORMATO PROPOSICIONES, SIN QUE SE HAYA PRESENTADO LA INQUIETUD MANIFESTADA, EN CASO DE QUE ALGÚN HIPERVINCULO NO FUNCIONE, EN LA FICHA TÉCNICA DEBERÁ ESTABLECER EN LA COLUMNA PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF LA INFORMACIÓN SOLICITADA. SOLO EN EL CASO DE NO ENCONTRARSE LA INFORMACIÓN SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
3	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA PUNTO 10 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL.	DE LOS EQUIPOS MÉDICOS PUNTO 14, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN EL CASO DE QUE UN EQUIPO MEDICO YA INSTALADO EN LOS HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TENGA UNA VIDA DE SERVICIO SUPERIOR A LOS 4 AÑOS Y MENOR DE 5 Y TENGA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS, SEA ACEPTADO PARA ESTE EVENTO DE LICITACIÓN, COMPROMETIÉNDONOS A QUE DE RESULTAR ASIGNADOS Y SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO TIENE FALLOS O DESCOMPOSTURAS, SE CAMBIARÁ POR UNO NUEVO.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA ELECTRÓNICA Y	APARTADO FICHAS TÉCNICAS ANEXOS 1.3, 1.4, 1.5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA: FDA O CE O JIS O EQUIVALENTE SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012. BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS, CERTIFICADO ISO:13485:2016, SOLO SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL CASO QUE APLIQUE AL EQUIPO MEDICO, INSUMOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, MOBILIARIO MEDICO Y ADMINISTRATIVO Ó DONDE EL FABRICANTE ESTE OBLIGADO POR EL MARCO LEGAL MEXICANO, POR ALGUNA NORMA OFICIAL MEXICANA DE REFERENCIA O POR LA AUTORIDAD REGULATORIA SANITARIA EJEMPLO: COFEPRIS O SECRETARIA DE SALUD.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE AL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO NO LE APLICA EL REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN, CERTIFICADO DE LA NOM 241-SSA1-2012, CERTIFICADO ISO 13485:2016, AL MOBILIARIO MÉDICO NO LE APLICA CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012, CERTIFICADO 13485:2016.
5	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA ELECTRONICA Y	APARTADO FICHAS TÉCNICAS ANEXOS 1.3, 1.4, 1.5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, RATIFIQUE QUE EL PROCESO DE CERTIFICADO ISO:13485:2016 Y LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO QUE ASÍ LO AVALE, SOLO APLIQUE PARA EQUIPO MEDICO Y NO PARA EL MOBILIARIO, ASÍ COMO PARA AQUELLOS FABRICANTES QUE DEBAN TENERLA/PRESENTARLA POR NORMATIVA DE SUS PAÍSES DE ORIGEN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN MÉXICO NO ES UNA NORMATIVA O CERTIFICACIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIA.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE AL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO NO LE APLICA EL CERTIFICADO ISO 13485:2016, AL MOBILIARIO MÉDICO NO LE APLICA CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012 Y/O CERTIFICADO 13485:2016.
6	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	APARTADO FICHAS TÉCNICAS ANEXOS 1.3, 1.4, 1.5	CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012. BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE ESTA CERTIFICACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EN EL CASO QUE APLIQUE PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS,	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE AL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO NO LE APLICA EL CERTIFICADO DE LA NOM 241-SSA1-2012 Y/O CERTIFICADO ISO 13485:2016, AL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0075



NO DE PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA DE "LA CONVOCANTE"
				INSUMOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO Ó DONDE EL FABRICANTE ESTE OBLIGADO POR EL MARCO LEGAL MEXICANO O POR LA AUTORIDAD REGULADORA SANITARIA EJEMPLO: COFEPRIS O SECRETARIA DE SALUD.	MOBILIARIO MÉDICO NO LE APLICA CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012 Y/O CERTIFICADO 13485:2016.
7	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.3	FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS MÉDICOS, EQUIPOS AUXILIARES Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. MAQUINA CICLADORA PARA DIÁLISIS PERITONEAL. PUNTO 1.8 "QUE NO NECESITE CALIBRACIÓN "SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR MAQUINA CICLADORA PARA DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE NO REQUERIR CALIBRACIÓN PARA SU USO Y NINGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.3	FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS MÉDICOS, EQUIPOS AUXILIARES Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MAQUINA CICLADORA PARA DIÁLISIS PERITONEAL. PUNTO 1.15.- CASSETE DESECHABLE EN PACIENTE ADULTO Y CASSETE DESECHABLE ESPECÍFICO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR MAQUINA CICLADORA PARA DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA CON FUNCIÓN DE MODO VOLUMEN PEQUEÑO, QUE PERMITE ATENDER A PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y DE BAJO PESO USANDO UN SOLO UN TIPO DE CASSETE.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.3	FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS MÉDICOS, EQUIPOS AUXILIARES Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. MAQUINA DE HEMODIÁLISIS. PUNTO 1.21.- CON DISPOSITIVO PARA EL MANEJO DE DESECHOS INTEGRADO A LA PARTE HIDRÁULICA DE LA MÁQUINA SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR MAQUINA PARA HEMODIÁLISIS CON DISPOSITIVO DE DESECHO INTEGRADO EN LA LÍNEAS ARTERIOVENOSAS O HEMOLÍNEA, LA CUAL GARANTIZA LAS BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD AL PACIENTE AL NO INTERACTUAR NINGÚN DESECHO BIOLÓGICO CON LA MAQUINA.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
10	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4	FICHA TÉCNICA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS SISTEMA DE CONEXIÓN MÚLTIPLE DE PVC, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SISTEMA DE CONEXIÓN MÚLTIPLE DE PVC, PARA CONECTAR 3 BOLSAS DE SOLUCIÓN DE DIÁLISIS PERITONEAL.	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
11	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	MÉDICOS, EQUIPOS AUXILIARES Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	MAQUINA DE HEMODIÁLISIS. PUNTO 1.25 HEMODIAFILTRACIÓN, SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR MAQUINA PARA HEMODIÁLISIS CON MODALIDAD HEMODIÁLISIS EXPANDIDA A TRAVÉS DE FILTRO THERANOVA, PARA CUMPLIR CON EL PUNTO DE HEMODIAFILTRACIÓN. EL DIALIZADOR THERANOVA, ES UNA MEMBRANA QUE SE DIRIGE A LA FILTRACIÓN DE MOLÉCULAS MEDIAS DE MAYOR TAMAÑO QUE NO SE ELIMINAN EFICAZMENTE POR LOS TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS DISPONIBLES. ESTA TECNOLOGÍA DE EQUIPO EN CONJUNTO CON EL DIFILTRO DIALIZADOR OFRECE LA OPORTUNIDAD DE UNA TERAPIA DE HEMODIÁLISIS EXPANDIDA (HDX), QUE PROPORCIONA UN DESEMPEÑO DE HDF MÁS ALLÁ DE LA ELIMINACIÓN DE MOLÉCULAS MEDIANAS Y MEDIANAS DE MAYOR TAMAÑO, USANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA HD CONVENCIONAL	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12	HI-TEC MEDIC	TÉCNICO	ANEXO 1.4	FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS KIT DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN PARA PARA CATÉTER Y FISTULA.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRÁTICO
DEL MAYA

0076

3700

NO DE PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA DE "LA CONVOCANTE"
	AL SA DE CV			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR Y PRESENTAR DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA Y REGULATIVA DE MANERA INDIVIDUAL PARA AQUELLOS INSUMOS QUE EL REGISTRO SANITARIO, FOLLETO O INSERTO NO CONTEMPLA DE MANERA COMPLETA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO EN EL ANEXO 1.4 KIT DE LOS KIT DE CONEXION Y DESCONEXION DE CATETER Y FISTULA, ASUMIENDO EL COMPROMISO, EN EL CASO DE RESULTAR ASIGNADO, QUE LA ENTREGA FISICA DE ESTOS INSUMOS SERA EN KIT COMO SE ENLISTA EN EL PRESENTE PUNTO DE LAS BASES.	
13	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PUNTO 7	SOLUCIÓN DE SELLADO DE PARA CATÉTERES DE HEMODIÁLISIS Y PUNTO 8 SOLUCIÓN DE SELLADO ANTICUAGULANTE, ANTIBACTERIANO Y ANTITROMBÓTICO EN JERINGA LIBRE DE AGUJA PRECARGADA CON 2.5ML C/U CON CONEXIÓN LUER LOCK, EMPAQUETADAS EN UN SET ESTÉRIL LAS CUALES CONTIENEN CITRATO TRISÓDICO AL 4%, 30%, 46.7% PRESENTACIÓN SET CON DOS JERINGAS. ACABADO DE LA JERINGA LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS, PERFORACIONES, FRACTURAS, REBABAS INTERNAS, RUGOSIDADES Y NÓDULOS. JERINGAS CON GRADUACIÓN EN ML Y CON ANILLO DE RETENCIÓN PARA EVITAR QUE EL EMBOLO SE SEPARE DEL CILINDRO. SOLICITAMOS NOS AUTORIZEN A COTIZAR EL INSUMO "SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE Y ANTIMICROBIANA DE CITRATO DE TRISODIO AL 4%, 30% Y 46.7%, EN AMPOLLETA O VIAL DE PLÁSTICO DE 5 ML. MISMO QUE CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS COMO SELLADOR DE CATÉTERES. LO ANTERIOR DERIVADO DEL CAMBIO DE PRESENTACIÓN DEL FABRICANTE.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS. PUNTO 15	FILTRO PARA HEMODIÁLISIS DE MEMBRANA SINTÉTICA (PAES) DE POLIETERSULFONA DE ALTO FLUJO EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DE LOS CLÍNICOS, SUPERFICIE DE ÁREA EN CONFORMIDAD CON LO QUE SOLICITE EL ÁREA MÉDICA, CUBRIENDO LOS PARÁMETROS DE ACLARAMIENTO DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS CON SUPERFICIES EQUIVALENTES ENTRE 1.1 Y 2.1 M2 (DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PACIENTE), PIEZA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR FILTRO PARA HEMODIÁLISIS DE MEMBRANA SINTÉTICA DE PORACTON (PAES / PVP) DE ALTO FLUJO EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE CUMPLEN CON LAS NECESIDADES DE LOS CLÍNICOS, SUPERFICIE DE ÁREA EN CONFORMIDAD CON LO QUE SOLICITE EL ÁREA MÉDICA, CUBRIENDO LOS PARÁMETROS DE ACLARAMIENTO DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS CON SUPERFICIES EQUIVALENTES ENTRE 1.1 Y 2.1 M2 (DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PACIENTE), PIEZA.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE NO SE ACEPTA
15	HI-TEC MEDIC AL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 INSUMOS PARA TRRC PUNTO 3 BOLSA RECOLECTORA DE EFLUENTE DE 5 LITROS.	ES CORRECTO ENTENDER QUE "LA BOLSA RECOLECTORA DE EFLUENTE DE 5 LITROS "DEBERA ESTAR CONTENIDA EN EL CIRCUITO EXTRACORPÓREO DE PVC INTERCONECTADO, EL CUAL DEB TENER 4 SEGMENTOS PARA BOMBA. UNA LÍNEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LÍNEA PARA LIQUIDO DE HEMODIÁLISIS, UNA LÍNEA PARA FLUIDO DE REEMPLAZO, UNA LÍNEA DE ACCESO A PACIENTE, UNA LÍNEA PARA COLECCIÓN DEL VOLUMEN EXTRAÍDO, 4 TRANSDUCTORES DE PRESIÓN, UN	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0077



NO DE PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA DE "LA CONVOCANTE"
				FILTRO DE MEMBRANA AN69, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LÍQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE VOLUMEN EXTRAÍDO PREDILUCION ESTÉRIL Y DESECHABLE, SOLICITADO EN EL PUNTO NUMERO 1	
16	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 INSUMOS PARA TRRC PUNTO 2 SUB PUNTOS 2.1, 2.2, 2.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SET PARA TERAPIA RENAL CONTINUA DE ACUERDO PRESCRIPCIÓN MÉDICA MODELOS ST60, ST100 Y ST150, YA QUE EL FABRICANTE ACTUALMENTE LOS MANUFACTURA Y COMERCIALIZA CON ESTA NUEVA NOMENCLATURA.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4. FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS, FICHA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS PARA TRRC	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR A QUE MEDICAMENTO SE REFIERE EL BIEN NO.3 CUYA DESCRIPCIÓN ES "MEDICAMENTO QUE AYUDA AL FLUJO SANGUÍNEO A TRAVÉS DEL SISTEMA DISMINUYENDO LA PROBABILIDAD DE QUE LA SANGRE SE COAGULE EN EL FILTRO	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES LA HEPARINA MÁS HEPARINA BPM MÁS CITRATO MÁS ALTEPLASA (PEDIATRÍA).
18	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.3.FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA DE TERAPIA REPLAZO RENAL CONTINUO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PONER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CAMBIAR LA MODALIDAD DE SCUF A "OPCIONAL" CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA OFERTA DE PROVEEDORES, AL SER UNA MODALIDAD POCO UTILIZADA Y QUE SE PODRÍA SUSTITUIR CON CVVHD CON FLUJOS BAJOS DE DIALIZANTE	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE NO SE ACEPTA.
19	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 SISTEMA DE CONEXIÓN MÚLTIPLE DE PVC	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SISTEMA DE CONEXIÓN MÚLTIPLE DE PVC PARA CONECTAR HASTA 3 BOLSAS DE DIÁLISIS PERITONEAL.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	IGSA MEDICAL SERVICES SA DE CV	TÉCNICO	2.5 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICARNOS SI VAN A RETENER LAS MUESTRAS O SI SÓLO SERÁN PARA VALORACIÓN Y AL FINAL DE LA MISMA VAN A DEVOLVERLOS AL PROVEEDOR.	EL ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE LAS MUESTRAS NO SE RETIENEN, SE HARÁ LA DEMOSTRACIÓN EL 2 DE ABRIL. SE SOLICITA ACUDA EL ESPECIALISTA DE PRODUCTO Y AL TERMINO DE LA EVALUACIÓN, LAS MUESTRAS SE REGRESAN EL MISMO DÍA
21	IGSA MEDICAL SERVICES SA DE CV	TÉCNICO	6.3.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA	LA PROPOSICIÓN TÉCNICA SERÁ MIXTA, DEBERÁ ENTREGARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INCLUYENDO TODOS LOS MANIFIESTOS, CARTAS Y DOCUMENTACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", PREVIO A SU DIGITALIZACIÓN. FAVOR DE INDICARNOS CUÁL SERÁ EL PROCESO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SERÁ EN FORMA ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A LA PRECISIÓN NÚMERO 3 DE LA PRESENTE ACTA.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE CUENTAN CON UN PLAZO DE 06 HORAS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2024, PARA FORMULAR Y REMITIR POR COMPRANET, LAS REPREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS, A LAS CUALES SE DARÁ CONTESTACIÓN A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO 2024, EN ESTA MISMA SALA UBICADA EN EL PISO 8 DE LA TORRE INSIGNIA PARA LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS Y DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET PARA LOS LICITANTES INTERESADOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



0078

7500

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX).

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EN EL PISO 8 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NUMERO 423, COL. NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE O PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:43 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA, QUIENES RECIBIRÁN COPIA DE LA PRESENTE ACTA POR CORREO ELECTRÓNICO.

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	C.P. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	MTRO. JUAN CARLOS CASTILLO CARRIÓN JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS	
	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
DIRECCION JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. ARIANA GALICIA MARTÍNEZ REPRESENTANTE	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMSS-BIENESTAR	DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS REPRESENTANTE	

FIN DEL ACTA

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2024, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0079

ANEXO I

g
↑
a p



SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0066



SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2024, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES); SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO), ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR ASISTIDO POR EL MTRO. JUAN CARLOS CASTILLO CARRIÓN, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET NO FUERON RECIBIDAS SOLICITUDES DE REPREGUNTAS RESPECTO DE LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA LLEVADA A CABO EL PASADO 26 DE MARZO DE 2024, LO CUAL SE HACE CONSTAR CON LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRANET DE LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA DESCARGA MASIVA DE LA REPREGUNTAS, UNA VEZ QUE SE CONSTATÓ QUE HUBO (0) REGISTROS, SE ADJUNTAN LAS CAPTURAS COMO EVIDENCIA PARA TALES EFECTOS.

1. CAPTURA DE PANTALLA DE LOS LICITANTES QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR:

NUM.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Preguntas
1	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	26/03/2024 19:20	26/03/2024 19:20			
2	FRESCENTUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE CV	25/03/2024 09:54	25/03/2024 09:59			
3	HEALTHYFI SA DE CV	25/03/2024 17:31				
4	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	27/03/2024 09:34	27/03/2024 09:40			
5	IGSA MEDICAL SERVICES SA DE CV	25/03/2024 11:32	25/03/2024 11:33			
6	LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV	26/03/2024 17:09				

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.




SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



0067

3800

2. CAPTURA DE PANTALLA, EVIDENCIA DE QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE REPREGUNTAS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET.

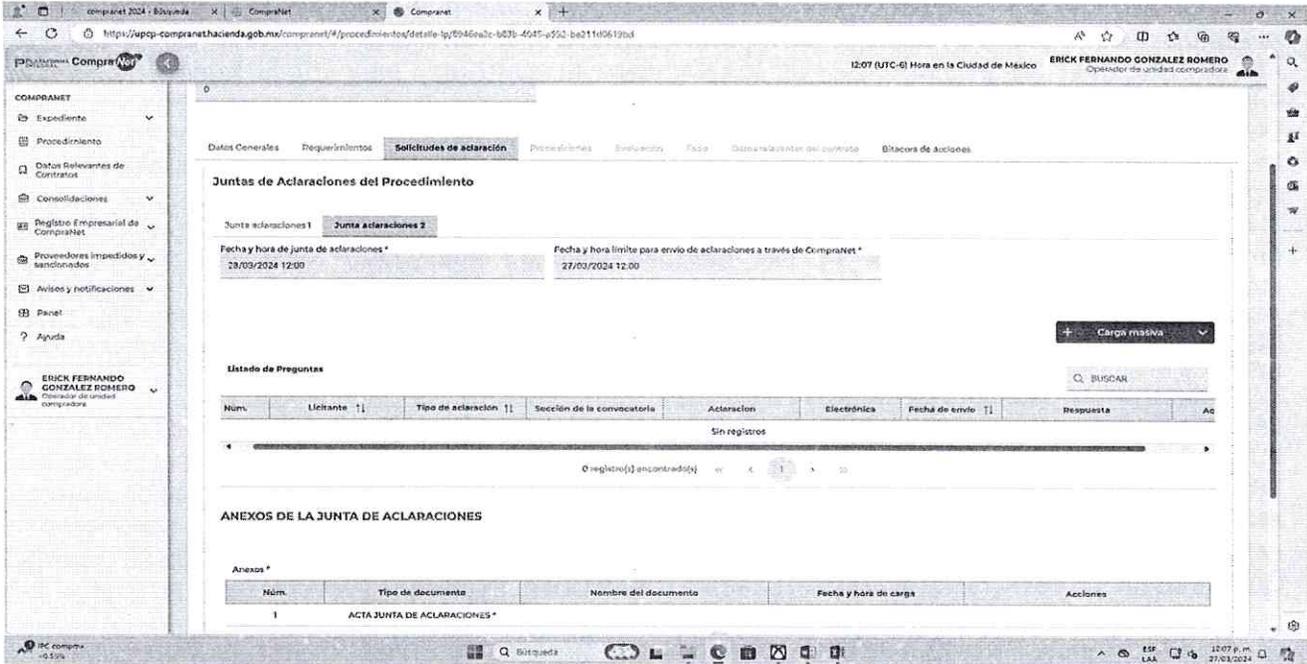

SE INFORMA A LOS LICITANTES, ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** SE LLEVARÁ A CABO EL **04 DE ABRIL DE 2024 A LAS 12:00 HORAS** EN ESTA MISMA SALA PARA LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS Y DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET PARA LOS LICITANTES INTERESADOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX).

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EN EL PISO 8 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NÚMERO 423, COL. NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE O PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0068



ESTA ACTA CONSTA DE 3 PÁGINAS, SE INFORMA, QUE SE CIERRA EL ACTO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA, QUIENES RECIBIRÁN COPIA DE LA PRESENTE ACTA POR CORREO ELECTRÓNICO-----

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	C.P. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	MTRO. JUAN CARLOS CASTILLO CARRIÓN JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS	
	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
DIRECCION JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. ARIANA GALICIA MARTÍNEZ REPRESENTANTE	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMSS-BIENESTAR	DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS REPRESENTANTE	

-----FIN DEL ACTA-----

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-2-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".