



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

SE REANUDA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2022, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL TERCER PISO DEL ANEXO 2, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE SU REGLAMENTO, JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA", HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: ----

-----HECHOS-----

- I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: -----

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
	DRA. NAZAREA HERRERA MALDONADO DIRECTORA HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"
	LIC. NALLELY MORALES ROSAS REPRESENTANTE
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	JOSÉ LUIS CORTES SANCHEZ REPRESENTANTE
COORDINACIÓN DE ENFERMERIA	MTRA. NAYELI MEJIA D. REPRESENTANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IVAN EDUARDO VEGA FRANCO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA
CONTRALORÍA CIUDADANA	MARCO ANTONIO GÓMEZ REPRESENTANTE
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS	CESAR SEBASTIÁN SALINAS NÁJERA MÉDICO ADSCRITO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS
LICITANTES: -----

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	PERLA ROGEL MENA
MOTIONCORP, S.A. DE C.V.	CARLOS HERNANDEZ TREJO
OURUX, S.A. DE C.V.	GABRIEL CORZO CARDONA
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASES, S.A. DE C.V.	ANTONIO DE J. ROMERO GÓMEZ
HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL ROMERO CARRERA
MEGAMED, S.A. DE C.V.	LEONEL MARCELO FLORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	MARTHA GARCÍA MARTÍNEZ
GRUPO ABUNDANZAA, S.A. DE C.V.	LUIS ENRIQUE MATEOS RUIZ
COMERLAT S.A. DE C.V.	KENIA PAMELA AGUIRRE BELLO
CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	MANUEL DE JESÚS RECIO RAMÍREZ
SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIGUEL LÓPEZ ESPINOSA
LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	HERIBERTO VAZQUEZ
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	MIGUEL TELLEZ DOMINGUEZ
BEATRIZ LÓPEZ LUNA	ISRAEL GARCÍA RANGEL
NUDOMI, S.A. DE C.V.	YUSEL GÓMEZ BLANCO
INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	ISRAEL INIESTRA SACT
DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN
MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	JESÚS RAMIREZ H.
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	JOSÉ ROJO LINE
LABORATORIOS SAAV, S.A. DE C.V.	JORGE SANTANDER GARCÍA
JUAN R. PACHECO VARGAS	JUAN R. PACHECO VARGAS
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	MARTA ELENA AVILA CEL.
RADIOLOGÍA Y ELÉCTRONICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	RODRIGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIMSIA INTERPRETACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.	DIEGO MAXIMILIANO MORALES NIETO
INBIOMEDIX, S.A. DE C.V.	EDUARDO JAIME CASTRO
BODIST, S.A. DE C.V.	ISRAEL GOYTIA SU
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SAUL MARQUEZ MARTÍNEZ
BETON CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	ERIKA GONZALEZ C
SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	BEATRIZ LOPEZ LUNA
INTERCABLE, S.A. DE C.V.	KATYA DAYANA GALLO MACIAS
EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA, S.A.P.I. DE C.V.	GERARDO MAYEN VI LLALOBOS
MARÍA SUSANA GONZALEZ CORPIO	MARÍA SUSANA GONZALEZ CORPIO
DEWIMED, S.A. DE C.V.	VICTOR MANUEL MONCADA PASOS
MOBLIFARMA, S.A. DE C.V.	JAIR LEONARDO MORENO ALARCÓN
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	JOSÉ ROJO
INSTRUMENTAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	CÉSAR RAMÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	MICHEL LOZANO CASILLAS
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	TEOFILA CADENA ALFARO
BIOMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ARTURO MILLAN GUADARRAMA
NEUMEDICA HOMECARE, S.A. DE C.V.	EDUARDO CARDENAS
EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	GUALBERTO MOLINA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

III. PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

PRECISIÓN 1

SE LES COMUNICA A LOS LICITANTES QUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SON LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES", LOS CUALES CORRESPONDEN A LAS FICHAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1.1 DE LAS PRESENTES BASES.

POR LO TANTO, EL LICITANTE, DEBERÁ CONSIDERAR DE ACUERDO A LA PARTIDA QUE COTICE, LOS SUPUESTOS QUE RESULTEN APLICABLES A LA PARTIDA OFERTADA, PREVISTOS EN EL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 1.8 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" Y ANEXO 26 "REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA ENTREGA DE BIENES Y GUÍA DE ENTREGA".

SI BIEN ES CIERTO EN LOS ANEXOS 1.8 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" Y ANEXO 26 "REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA ENTREGA DE BIENES Y GUÍA DE ENTREGA", CONTEMPLAN MÁS SUPUESTOS PARA LA ENTREGA Y GARANTÍA ESTOS CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD QUE NECESITARÍA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA PARA OPERAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES, SIN EMBARGO, LOS BIENES OBJETO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SOLO SON LOS SOLICITADOS TANTO EN EL ANEXO 1 Y 1.1

PRECISIÓN 2

AL FINAL DEL EVENTO SE ADJUNTARÁ UN ANEXO 29, DENOMINADO PLAZOS DE ENTREGA AL CUAL SE LE INCLUYE UNA COLUMNA REFERENTE A LAS PARTIDAS DEL PROCEDIMIENTO PARA UN MAYOR CONTROL

PRECISIONES POR PARTE DEL AREA TECNICA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

PRECISIÓN TÉCNICA NO. 1. SE ANEXA LA MINUTA DE TRABAJO QUE SE REALIZÓ AL TÉRMINO DE LA VISITA EN EL H. G. CUAJIMALPA, CON LOS VEINTIDOS LICITANTES QUE ASISTIERÓN. LA CUAL SE SOLICITA SE ADJUNTE A LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

PRECISIÓN TÉCNICA NO. 2. SE ANEXAN DOS PLANOS DONDE SE ESPECIFICA EL CABLEADO DE COMUNICACIÓN PARA LAS CUATRO CENTRALES DE MONITOREO, ASÍ COMO DE MANERA ELECTRÓNICA 4 ARCHIVOS.

PRECISIÓN TÉCNICA NO.3.
PÁGINA 156, PARTIDA 118, APARTADO "DEFINICIÓN".

DICE:

DEFINICIÓN: CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE REFRIGERANTES PARA MANTENERLOS A TEMPERATURA DE CONGELACIÓN.

1. CON PUERTA METÁLICA TIPO COFRE
2. SELLADO HERMÉTICO CERRADURA Y LLAVE.
3. CONSTRUIDO DE MATERIAL RESISTENTE A CLIMAS TROPICALES.
4. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA EN RANGO DE -15 A -20°C.
5. CON CONTROL DE TEMPERATURA CANASTILLA REMOVIBLE AHORRADOR DE ENERGÍA Y TAPÓN DE DRENADO.

ALIMENTACIÓN: EN CASO DE REQUERIR VOLTAJE DE 220V O DIFERENTE, EL ADJUDICADO REALIZARÁ LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA.

DEBE DE DECIR:

DEFINICIÓN: CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

DESCRIPCIÓN:

- 1 PARA LA GUARDA DE VACUNAS.
- 2 TIPO HORIZONTAL.
- 3 SELLADO HERMÉTICO CERRADURA Y LLAVE.
- 4 CAPACIDAD DE 14 PIES CÚBICOS.
- 5 CONSTA DE AL MENOS UNA PUERTA.
- 6 CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA EN RANGO DE -15 A -20°C.
- 7 REFRIGERANTE LIBRE DE CFC.
- 8 ALARMAS AUDITIVAS Y VISIBLES.

ALIMENTACIÓN: ALIMENTACIÓN DE 120V 50/60HZ, EN CASO DE REQUERIR VOLTAJE DE 220 O DIFERENTE, EL
PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZARÁ LAS ADECUACIONES SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD.

PRECISIÓN TÉCNICA NO.4.

PÁGINA 120, ANEXO 1.1 "FICHAS TÉCNICAS", PARTIDA 61 "HISTEROSCOPIO"

SE DEBERÁN AGREGAR LOS SIGUIENTES PUNTOS A LA FICHA TÉCNICA:

- 3.- PINZA DE AGARRE
- 4.- UNA TIJERA DE 5 CHARR

PRECISIÓN TÉCNICA NO.5.

PÁGINA 135, ANEXO 1.1 "FICHAS TÉCNICAS", PARTIDA 77 "ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO",
"ACCESORIOS", PUNTO 2.

DICE:

2. CON 500 ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS COMO MÍNIMO.

DEBE DECIR:

2. OCHO ESPÉCULOS REUSABLES TAMAÑO ADULTO Y CUATRO ESPÉCULOS REUSABLES TAMAÑO PEDIÁTRICO.

PRECISIÓN TÉCNICA NO.6.

DICE:

PARTIDA NO	NOMBRE DE LA PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA
8	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB
10	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB
12	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB
14	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	3.1.1 RESOLUCIÓN MÍNIMO DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB

DEBE DECIR:

PARTIDA NO	NOMBRE DE LA PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA
8	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 2MP
10	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 2MP



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS
MÍNIMO 2MP
14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS
COMO MÍNIMO 2MP

3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO

3.1.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA

PRECISIÓN TÉCNICA NO.7.

PARTIDA 114, "OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL", "ACCESORIOS"

DICE:

DOS PAQUETES DE PILAS COMPATIBLES CON EL EQUIPO OFERTADO

DEBE DECIR:

UN CABLE DE USB PARA CARGAR EL EQUIPO, ESTE CABLE DEBE DE TENER CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V DE UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO DEBERÁ TENER ENTRADA DE USB COMPATIBLE CON EL EQUIPO.

PRECISIÓN TÉCNICA 8:

PÁGINA 79, ANEXO 1.1 "FICHAS TÉCNICAS", PARTIDA 11 "MONITOR DE SIGNOS VITALES", "ACCESORIOS PARA MONITOR PARA PACIENTE PEDIÁTRICO", PUNTO 1.3.1

DICE:

1.3.1 PANI: DOS BRAZALETES ADULTO REUSABLE, UN BRAZALETE ADULTO OBESO REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, INCLUIR DOS MANGUERAS DE CONEXIÓN CON CONECTOR PARA BRAZALETES, POR MONITOR.

DEBE DECIR:

1.3.1 PANI: DOS BRAZALETES PEDIÁTRICO (RANGO DE 18 A 26 CM DE CIRCUNFERENCIA), DOS BRAZALETES PEDIÁTRICO INFANTIL (RANGO DE 10 A 19 CM CIRCUNFERENCIA) REUSABLE, DOS BRAZALETES NEONATALES REUSABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, INCLUIR DOS MANGUERAS DE CONEXIÓN CON CONECTOR PARA BRAZALETES, POR MONITOR.

PRECISIÓN TÉCNICA 9:

PÁGINA 208, ANEXO 1.1 "FICHAS TÉCNICAS", PARTIDA 137 "SET DE CIRUGIA DE MIEMBRO INFERIOR PEDIÁTRICA", PUNTO 41.

DICE:

41. PERFORADOR NEUMÁTICO.

DEBE DE DECIR:
SE ELIMINA.

PRECISIÓN TÉCNICA 10:

PARTIDA 18, "VIDEOCOLONOSCOPIO", PÁGINA 100

DICE:

1.7 DIÁMETRO EXTERIOR DEL EXTREMO DISTAL NO MAYOR A 13 MILÍMETROS.

1.8 DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN NO MAYOR A 13.2 MILÍMETROS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

DEBE DECIR:

1.7 DIÁMETRO EXTERIOR DEL EXTREMO DISTAL NO MAYOR A 13.2 MILÍMETROS.
1.8 DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN NO MAYOR A 13 MILÍMETROS.

PRECISIÓN TÉCNICA 11:

PARTIDA 151, "SET DE DENTAL ADULTO", PÁGINA 250, RENGLON 15

DICE:
ABREBOCAS

DEBE DECIR:
ABREBOCA DOYEN JANSEN DE 14 CM DE LONGITUD

PRECISIÓN TÉCNICA 12:

PARTIDA 153, "SET DE EPISIOTOMIA DE PARTO", PÁGINA 254, RENGLON 28

DICE:
ONFALOTOMO

DEBE DECIR
SE ELIMINA RENGLON 15

PRECISIÓN TÉCNICA 13:

PARTIDA 153, "SET DE EPISIOTOMIA DE PARTO", PÁGINA 254, RENGLON 1

DICE:
TIJERA ABDOMINAL PARA CORDÓN UMBILICAL LONGITUD DE 105 MM, CANTIDAD: 1

DEBE DECIR
TIJERA ABDOMINAL PARA CORDÓN UMBILICAL LONGITUD DE 105 MM, CANTIDAD: 2

IV. ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL
ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO
Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS
RECIBIDOS, Y PARA TAL FIN, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, DARÁ RESPUESTA
A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL,
ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: -----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

1. - INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, EL FOLIO DE CADA PROPUESTA ES POR SEPARARADO, ES DECIR LEGAL, TÉCNICO, ECONOMICO ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PUEDE FOLIAR CADA PROPUESTA POR SEPARADO, LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.
2	4.5.1 INCISO G) ANEXO 9	EN BASE AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NO PRESENTAR ESTE ANEXO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE LOS BIENES QUE PRESENTA MI REPRESENTADA SON DE ORIGEN INTERNACIONAL?	DEBERÁ INCLUIR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA
3	4.5.1 INCISO R) ANEXO 25	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO CON MARCA DE AGUA "NO APLICA", YA QUE ESTE ANEXO LE APLICA A MI REPRESENTADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
4	2.3 PERIODO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS COMUNIQUE CON PRECISIÓN EL PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, YA QUE DICHOS PLAZOS NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN LA CONVOCATORIA ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ AJUSTARSE AL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 2.5.1. "LUGAR DE ENTREGA
5	ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" Y ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUALES SERÁN LOS NÚMEROS CORRECTOS DE LAS PARTIDAS QUE APLICAN, PUES NO SON COINCIDENTES ENTRE EL ANEXO, EL ANEXO 1.1 Y EL ANEXO 1.8 DE LAS PRESENTES BASES ¿SE ACEPTA?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

6	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 52 REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS NUMERAL 4.3 CON CERRADURA DE SEGURIDAD	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHO MECANISMO DE CERRADURA PODRÁ SER OFERTADO PARA OPERARSE POR MEDIO DE LLAVE FÍSICA O ELECTRÓNICA? ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
7	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 118 CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS NUMERAL 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA MEJOR CARACTERÍSTICA AISLANTE Y NULA CORROSIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO, SE PERMITA LA OFERTA DE UN EQUIPO CON PUERTA DE POLIPROPILENO ROTOMOLDEADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES ADEMÁS DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 3
8	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 118 CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS NORMAS Y CERTIFICACIONES DE REFERENCIA APLICABLES	SE SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A LA CADENA DE FRÍO PARA VACUNAS, SEA SOLICITADA ADICIONALMENTE COMO PARTE DE LAS CERTIFICACIONES APLICABLES, LA EVALUACIÓN PQS APLICADA A CADA EQUIPO OFERTADO CON EL PROTOCOLO DICTADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
9	NUMERAL 2.5.2 CONDICIONES DE ENTREGA TERCER PÁRRAFO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA, YA QUE LOS BIENES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA SON DE ORIGEN EUROPEO Y YA QUE LAS CADENAS DE SUMINISTRO ALREDEDOR DEL MUNDO SE HAN VISTO INTERRUPTIDAS POR DIVERSOS FACTORES, NOS PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EN UN PERIODO NO SUPERIOR A 120 DÍAS NATURALES ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CADA BIEN CONFORME AL ANEXO 29



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

2. - MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.2 – GRADO DE INTEGRACIÓN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SEAN FABRICADOS EN PAÍSES EXTRANJEROS, ES DECIR QUE LOS EQUIPOS SEAN DE IMPORTACIÓN, ¿PODEMOS COLOCAR UN VALOR 0% (CERO POR CIENTO) EN EL ANEXO 9. FAVOR DE ACLARAR	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA ESTE, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.
2	4.4 – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS.	PARA UN MEJOR MANEJO Y CUIDADO DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA EN CARPETAS PERFORANDO TODOS LOS DOCUMENTOS EXCEPTO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
3	4.5.1 – ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL	EN CASO DE QUE ALGÚN DOCUMENTO INCLUIDO EN EL NUMERAL MENCIONADO NO APLIQUE PARA MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO CON LA LEYENDA NO APLICA, EXPLICANDO DICHA RAZÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

4	4.7.1.1 – PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLAMENTE PORTADA, HOJAS REFERENCIADAS Y CONTRAPORTADA DE LOS MANUALES DE LOS EQUIPOS, YA QUE ALGUNOS SOBREPASAN LAS 30 PÁGINAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ES OBLIGATORIO PRESENTAR IMPRESO PORTADA, HOJAS REFERENCIADAS Y CONTRAPORTADA DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS, ADEMÁS DEBERÁ ADJUNTAR EN FORMA ELECTRÓNICA EN PDF, TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLETOS. EN CASO QUE NO ESTE COMPLETO EN EL FORMATO ELECTRÓNICO, SE
---	-----------------------------	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

			DESECHARA LA PROPUESTA.
5	4.7.1.3 - NORMAS Y CERTIFICACIONES. PUNTO 4 - PARA REFACCIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LAS REFACCIONES QUE REQUIERAN LOS EQUIPOS, DERIVADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL PUNTO 4.7.1.3 SE REFIERE A NORMAS Y CERTIFICACIONES Y DEL PUNTO 1 AL PUNTO 5 (DEL MISMO PUNTO), SE ESPECIFICA LO CONCERNIENTE QUE DEBE CUMPLIR, CADA TIPO DE EQUIPO QUE SE LICITA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO
6	4.7.1.4 - CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR IMPRESIÓN DE LAS CARTAS FIRMADAS POR EL FABRICANTE, YA QUE EL FABRICANTE AL ESTAR EN EL EXTRANJERO Y POR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA PAQUETERÍA PODRÍAN NO LLEGAR A TIEMPO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARTAS DE APOYO DE FABRICANTE ' Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PUEDE PRESENTARSE IMPRESAS, SIN EMBARGO DEBERÁN ADJUNTAR EL CORREO ELECTRÓNICO DEL ENVÍO POR PARTE DE FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN CASO DE NO ADJUNTAR EL CORREO ELECTRÓNICO SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
7	ANEXO 1.1 - FICHAS TÉCNICAS - PARTIDA 16 - PUNTO 1.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN VIDEOPROCESADOR DE ALTA DEFINICIÓN CON ZOOM DIGITAL Y ÓPTICO, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
8	ANEXO 1.1 - FICHAS TÉCNICAS - PARTIDA 16 - PUNTO 3.5	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON ENTRADAS DVI, VGA, RGBS Y VIDEO COMPUESTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO
9	ANEXO 1.1 - FICHAS TÉCNICAS - PARTIDA 16 - PUNTO 5.6.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA COMPATIBILIDAD CON DICOM EN EL GRABADOR DE VIDEO, YA QUE TODOS LOS EQUIPOS DE LA TORRE VAN INTERCONECTADOS Y SE COMPARTIRÍA LA MISMA INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE DEL SISTEMA DE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

10	ANEXO 1.1 – FICHAS TÉCNICAS – PARTIDA 19 –PUNTO 1.4.3.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ANGULACIÓN DE FLEXIÓN HACIA LA DERECHA DE 105° GRADOS, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDO OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA COMPATIBILIDAD DE LA PARTIDA 16, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	ANEXO 1.1 – FICHAS TÉCNICAS – PARTIDA 19 –PUNTO 1.6.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN DE 11.6 MM, SIENDO MÍNIMA LA DIFERENCIA CON LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDO OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA COMPATIBILIDAD DE LA PARTIDA 16, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	ANEXO 1.1 – FICHAS TÉCNICAS.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE COMPARTIR LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 163 - LAVADORA PARA ENDOSCOPIOS, ESTÁ INCLUIDA EN EL ANEXO 1.8 PERO NO TIENE DESCRIPCIÓN.	SE ATIENDE CON LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE NÚMERO 1
REPREGUNTAS			
1	REPREGUNTA 1 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN	LA MANUFACTURA DE LOS EQUIPOS SE REALIZARÁ TOTALMENTE FUERA DE MÉXICO, ES CORRECTO PONER QUE EL GRADO DE INTEGRACIÓN ES DE 0 % Y EL CONTENIDO DEL EXTRANJERO DE 100% ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SI, DEBERA DE INDICAR EL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL AUNQUE ESTE SEA 0% E INDICAR EL PAÍS DE ORIGEN
2	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 16 PUNTO 3.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NO OFERTAR LA ENTRADA DE DISPLAY PORT, YA QUE LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

3. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO 531.341.0481	DEBIDO A QUE EN LAS BASES NO SE INCLUYÓ DESCRIPCIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA PARTIDA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE NUESTRA MARCA. ¿SE ACEPTA?	SE ATIENDE CON LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE NÚMERO 1
2	PARTIDA UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX.	DEBIDO A QUE EN LAS BASES NO SE INCLUYÓ DESCRIPCIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA PARTIDA, SOLICITAMOS A LA	SE ATIENDE CON LA ACLARACIÓN DE LA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	531.341.2537	CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE NUESTRA MARCA. ¿SE ACEPTA?	CONVOCANTE NÚMERO 1
3	PARTIDA: UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL 531.341.2479	DEBIDO A QUE EN LAS BASES NO SE INCLUYÓ DESCRIPCIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA PARTIDA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE NUESTRA MARCA. ¿SE ACEPTA?	SE ATIENDE CON LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE NÚMERO 1
4	PARTIDA: TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES 531.254.0049	DEBIDO A QUE EN LAS BASES NO SE INCLUYÓ DESCRIPCIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA PARTIDA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE NUESTRA MARCA. ¿SE ACEPTA?	SE ATIENDE CON LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE NÚMERO 1
5	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDA A LA TRADUCCIÓN FIEL DEL DOCUMENTO REFERIDO
6	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
7	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES TECNOLÓGICAMENTE A LO SOLICITADO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, LO SOLICITADO EN BASES ES LO MÍNIMO REQUERIDO
8	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CONSIDERANDO LA CRISIS MUNDIAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO, PERMITA EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA DE 5 DÍAS A 60 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO, PARA LA ENTREGA TOTAL DEL EQUIPO RELACIONADOS A LA PARTIDA 531.924.0031, ¿SE ACEPTA?	MANIFIESTA EL AREA REQUERENTE, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA EL TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA SERÁ DE 40 DÍAS HÁBILES
9	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 1 DE LA CÉDULA, CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL TIENE DIFERENTES TAMAÑOS DE MONITOR QUE BENEFICIEN LA CORRECTA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA PLATAFORMA, SOLICITAMOS	PUEDEN OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MONITOR EN COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN 19". CONTROL DE BRILLO, CONTROL DE ESTABILIDAD DE RETROILUMINACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOMATIC BACKLING STABILITY, BLS; ESTA TECNOLOGÍA ASEGURA UN CALENTAMIENTO RÁPIDO Y UNA ILUMINACIÓN UNIFORME DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO). PANEL IN-PLANE SWITCHING (IPS) PARA OBTENER UN ÁNGULO DE VISIÓN Y UNA REPRODUCCIÓN DE LA ESCALA DE GRISES ÓPTIMOS." LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
10	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 2 DE LA CÉDULA, EL RANGO DINÁMICO EN EL ULTRASONIDO ES EL QUE PERMITE REALIZAR UNA DIFERENCIA ENTRE LOS TEJIDOS A ESTUDIAR POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE EL VALOR MÍNIMO DEBE SER MAYOR A 270DB	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 2 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
11	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 4 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP (HASTA 1200 IMÁGENES EN BLANCO Y NEGRO). ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y EN MODO DÚPLEX DE HASTA 1200 IMÁGENES EN COLOR Y 2D PARA SELECCIÓN Y REVISIÓN RETROSPECTIVA. FUNCIONA CON IMÁGENES 2D Y ARMÓNICAS TISULARES, CON EL MODO M Y CON LOS MODOS DOPPLER PULSADO, DOPPLER CONTINUO, DOPPLER COLOR Y COLOR POWER ANGIO", LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 4 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
12	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 5 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "FORMADOR DE HACES DE BANDA ANCHA COMPLETAMENTE DIGITAL." LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 5 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
13	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 6 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "TECLADO ALFANUMÉRICO QWERTY CON TECLA DE GLOBALIZACIÓN PARA CONVERSIÓN AL IDIOMA LOCAL (INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO Y ESPAÑOL). TRACKBALL CON TECLAS DE SELECCIONAR E INTRO PARA FACILITAR LA NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA." LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 6 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
14	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 7 DE LA CÉDULA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. "500GB DE ESPACIO EN DISCO DURO." ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 7 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
15	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 8 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "ALMACENAMIENTO DIGITAL DIRECTO DE IMÁGENES ÚNICAS EN COLOR Y BLANCO Y NEGRO EN DISCO DURO INTERNO, MEMORIA FLASH USB Y CD/DVD. POSIBILIDAD DE EXPORTAR CLIPS AVI E IMÁGENES BMP A MEMORIA FLASH USB PARA SU VISUALIZACIÓN EN PC." LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 8 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
16	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 9 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA: SALIDA S-VIDEO" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 9 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
17	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 10 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "MODOS DE IMAGEN: IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES THI, IMÁGENES ARMÓNICAS DE PULSO INVERTIDO" LO CUAL CUMPLE CON LO	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 11 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
18	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 11 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "MEJORA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRASTE, REDUCE LOS ARTEFACTOS, INCREMENTA LA VISIBILIDAD DE LOS PATRONES DE TEXTURA TISULAR Y MEJORA LA DEFINICIÓN DE LOS BORDES Y LA CONTINUIDAD. XRES Y SONOCT PARA REDUCIR ARTEFACTOS POR RUIDO" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 11 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
19	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 12 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "ZOOM DIGITAL RECONSTRUIDO DE 16 NIVELES EN FORMATO PANORÁMICO." LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 12 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
20	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 13 DE LA CÉDULA, CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL TIENE DIFERENTES NOMBRES COMERCIALES PARA REFERIRSE A 'COMPOSICIÓN ESPACIAL' Y EN NUESTRA LITERATURA SE UTILIZA 'IMÁGENES COMPUESTAS EN TIEMPO REAL SONOCT', SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: "TECLA DE OPTIMIZACIÓN 2D CON HASTA TRES AJUSTES. COMPOSICIÓN DE IMÁGENES EN ORIENTACIÓN DEL HAZ DE ALTA PRECISIÓN PARA ADQUIRIR MÁS INFORMACIÓN DE LA IMAGEN TISULAR Y REDUCIR LOS ARTEFACTOS GENERADOS POR EL ÁNGULO DE INCIDENCIA DEL TRANSDUCTOR SOBRE LA PIEL", LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 13 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
21	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 16 DE LA CÉDULA, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON 8	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 16 DE LA CEDULA DE LAS BASES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA																																							
		IMÁGENES (UNA POR CADA INCISO DEL PUNTO 16) DEMOSTRANDO TODOS LOS MODOS DE IMAGEN QUE SE OFERTAN Y QUE CUMPLEN CON LAS 8 FUNCIONALIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO																																							
22	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 17 DE LA CÉDULA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. "RUEDAS GIRATORIOS DE CUATRO VÍAS CON BLOQUEO DE FRENADO INDIVIDUAL "¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO 17 DE LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO																																							
23	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 19 DE LA CÉDULA, CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL TIENE DIFERENTES TÉRMINOS PARA REFERIRSE A 'LICENCIA' Y EN NUESTRA LITERATURA SE UTILIZA 'APLICACIONES', SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR AMBOS TÉRMINOS COMO EQUIVALENTES, LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEIMIENTO LLEGA HASTA EL NUMERAL 17																																							
24	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 20 DE LA CÉDULA, CONSIDERANDO QUE LAS CAPACIDADES DICOM DE UN EQUIPO MÉDICO SE ENCUENTRAN ENUNCIADAS DENTRO DE UN DOCUMENTO 'DICOM CONFORMANCE STATEMENT' SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS CUATRO INCISOS DE ESTE PUNTO 20 DESDE ESTE DOCUMENTO: NOTE: This DICOM Conformance Statement applies to ClearVue 500 3.3, ClearVue 550 3.3, ClearVue 650 3.3 and ClearVue 850 3.3 systems unless a note is present describing any different behavior or support. Table 1 provides an overview of the supported network services. <table><tr><th colspan="3">Table 1 NETWORK SERVICES</th></tr><tr><th>Networking SOP Classes</th><th>User of Service (UCI)</th><th>Provider of Service (SCP)</th></tr><tr><td colspan="3">Transfer</td></tr><tr><td>Ultrasound Image Storage</td><td>Yes*</td><td>No</td></tr><tr><td>Ultrasound Multiframe Image Storage</td><td>Yes*</td><td>No</td></tr><tr><td>Storage Commitment Push Model</td><td>Yes*</td><td>No</td></tr><tr><td>Comprehensive SR</td><td>Yes*</td><td>No</td></tr><tr><td colspan="3">Workflow Management</td></tr><tr><td>Modality Worklist</td><td>Yes*</td><td>No</td></tr><tr><td>Modality Performed Procedure Step</td><td>Yes*</td><td>No</td></tr><tr><td colspan="3">Print Management</td></tr><tr><td>Basic Grayscale Print Management</td><td>Yes*</td><td>No</td></tr><tr><td>Basic Color Print Management</td><td>Yes*</td><td>No</td></tr></table> LO CUAL CUMPLE CON LAS FUNCIONALIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Table 1 NETWORK SERVICES			Networking SOP Classes	User of Service (UCI)	Provider of Service (SCP)	Transfer			Ultrasound Image Storage	Yes*	No	Ultrasound Multiframe Image Storage	Yes*	No	Storage Commitment Push Model	Yes*	No	Comprehensive SR	Yes*	No	Workflow Management			Modality Worklist	Yes*	No	Modality Performed Procedure Step	Yes*	No	Print Management			Basic Grayscale Print Management	Yes*	No	Basic Color Print Management	Yes*	No	LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEIMIENTO LLEGA HASTA EL NUMERAL 17
Table 1 NETWORK SERVICES																																										
Networking SOP Classes	User of Service (UCI)	Provider of Service (SCP)																																								
Transfer																																										
Ultrasound Image Storage	Yes*	No																																								
Ultrasound Multiframe Image Storage	Yes*	No																																								
Storage Commitment Push Model	Yes*	No																																								
Comprehensive SR	Yes*	No																																								
Workflow Management																																										
Modality Worklist	Yes*	No																																								
Modality Performed Procedure Step	Yes*	No																																								
Print Management																																										
Basic Grayscale Print Management	Yes*	No																																								
Basic Color Print Management	Yes*	No																																								
25	CLAVE SAICA: 531.924.0031 - ULTRASONÓGRAFO. (PORTATIL)	REFERENTE AL PUNTO 21 DE LA CÉDULA, CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL TIENE DIFERENTES RANGOS DE FRECUENCIA PARA LA FABRICACIÓN DE SUS	LA CEDULA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEIMIENTO LLEGA HASTA EL NUMERAL 17																																							



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		TRANSDUCTORES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PROPONER TRANSDUCTORES CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1MHZ, LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD CLÍNICA PARA LOS ESTUDIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
26	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO: 3.3	DQE: 70% O MAYOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "DETECTOR PLANO: DQE DE 0.70", PUESTO QUE EL SÍMBOLO DE PORCENTAJE (%) QUE SE ESCRIBE DESPUÉS DEL NÚMERO SIGNIFICA QUE SE VA A DIVIDIR AL NÚMERO ENTRE 100 Y EN NUESTRA REFERENCIA SE EXPRESA LA MISMA CANTIDAD DIVIDIDA ENTRE 100 ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
27	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO: 3.4	PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE 16 BITS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "DETECTOR PLANO: CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL DE 16 BITS", DADO QUE LA PROFUNDIDAD DE IMAGEN SE REFIERE A LA CANTIDAD DE BITS DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA GUARDAR INFORMACIÓN EN UN PÍXEL EN UNA IMAGEN DIGITAL Y LA CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL DEL DETECTOR CORRESPONDE A LA ETAPA DE ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
28	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO: 4.1	MOTORIZADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ARCO EN C MOTORIZADO EN SU MOVIMIENTO VERTICAL; ESTO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD, PERMITE DISMINUIR EL PESO DEL ARCO Y SE POSICIONE CON FACILIDAD, FAVORECIENDO SU OPERABILIDAD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
29	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO 4.5	CON MOVIMIENTO VERTICAL MOTORIZADO MÍNIMO DE 38 CM, ENTENDEMOS QUE EL RECORRIDO VERTICAL ES MUY IMPORTANTE PARA EL POSICIONAMIENTO POR DEBAJO DE LA MESA DEL TUBO DE RAYOS X, UN RECORRIDO AMPLIO MEJORA LAS OPCIONES DE POSICIONAMIENTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MESA QUE SE USE Y DISMINUYE LA DOSIS Y MEJORA LA IMAGEN AL LOGRAR COLOCAR EL DETECTOR MÁS CERCANO AL ÁREA DE INTERÉS. PONEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA CONVOCANTE QUE EL RECORRIDO VERTICAL SEA MOTORIZADO E IGUAL O	PUEDEN OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS OFERENTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		MAYOR A LOS 45 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
30	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO 7.8	MODO DE CINE DIGITAL PULSADO O EXPOSICIÓN DIGITAL PULSADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "MODO DE EXPOSICIÓN PULSADO", ESTO DEBIDO A QUE TODA LA CADENA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN Y PROCESAMIENTO ES DIGITAL ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS OFERENTES
31	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO 7.9	TIPO DE EXAMEN O PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE BOLO PREDEFINIDO, CON SUSTRACCIÓN CON TOLERANCIA AL MOVIMIENTO (MTS), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PARTE DE LOS "PROGRAMAS DISPONIBLES CON LA EXTENSIÓN VASCULAR: SEGUIMIENTO DE BOLO, MODO DE FLUOROSCOPIA CON SUBSTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES EN TIEMPO REAL PARA COMPENSAR LOS EFECTOS DEL MOVIMIENTO"; LOS CUALES SE INTEGRAN PARA EL USO PREVISTO EN LA DESCRIPCIÓN ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS OFERENTES
32	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11	CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL IMPACTO ECOLÓGICO DE MANEJAR Y ENTREGAR MATERIAL IMPRESO Y CONSIDERANDO EL CADA VEZ MAYOR DESUSO QUE TIENEN LOS MANUALES IMPRESOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR EL MANUAL DE OPERACIÓN DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL Y EN FORMATO DIGITAL ¿SE ACEPTA?	ES OBLIGATORIO PRESENTAR IMPRESO PORTADA, HOJAS REFERENCIADAS Y CONTRAPORTADA DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS, ADEMÁS DEBERÁ ADJUNTAR EN FORMA ELECTRÓNICA EN PDF, TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLETOS. EN CASO QUE NO ESTE COMPLETO EN EL FORMATO ELECTRÓNICO, SE DESECHARÁ LA PROPUESTA.
33	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO 4.1	PARA EL PUNTO DE LAS BASES: 4.1 MUESTRAS / 4.1.1 PARA LAS PARTIDAS DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN... SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE INDIQUEN LOS PUNTOS A EVALUAR PARA LA PARTIDA NÚMERO 5 CORRESPONDIENTES A LA CLAVE COMPENDIO: 531.341.2571	DEBERÁ ATENDER PUNTO 4.1.1 DE BASES, PARA LA PARTIDA 5 NO SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
34	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO 3.1	DICE "MOTORIZADO", DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR MOVIMIENTO MOTORIZADO DE ALTURA DEL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA CEDULA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
35	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO 7.1	CON FINES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MOSTRARLO EN CATÁLOGOS COMO PANTALLA PLANA DE SILICÓN AMORFO TRIXELL. ¿SE ACEPTA?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA CEDULA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
36	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11 PUNTO 7.9	DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR AJUSTE PARA LA ADQUISICIÓN Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CON SUSPENSIÓN DE RUIDO EN ESTUDIOS DEPENDIENDO LA ANATOMÍA DE INTERÉS. ¿ES CORRECTO?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA CEDULA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
37	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" CLAVE SAICA: 531.341.2248-11	CON FINES DE REFERENCIACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA MOSTRARLO EN NUESTROS CATÁLOGOS COMO EXTENSIÓN DE MANEJO DE DOLOR LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO ¿ES CORRECTO?	NO ES CLARA SU PREGUNTA, A QUÉ PUNTO SE REFIERE
38	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO MÚLTIPLES CAMAS PUNTO 3.1.	SOLICITAN RESOLUCION DE PANTALLA DE 3 MB, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, RESOLUCION DE PANTALLA DE 1920 X 1080 ¿SE ACEPTA)	ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 6
39	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO MÚLTIPLES CAMAS PUNTO 18	AL SER SAMIH UN SISTEMA HOSPITALARIO MÉDICO ELECTRÓNICO QUE SIRVE PARA ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES, CONSIDERAMOS QUE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE SAMIH EN LA CENTRAL DE MONITOREO ES UN ERROR DE REDUNDANCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
40	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES PUNTO 1.18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION QUE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL, PARA NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
41	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO MÚLTIPLES CAMAS PUNTO 3.1.	SOLICITAN RESOLUCION DE PANTALLA DE 3 MB, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, RESOLUCION DE PANTALLA DE 1920 X 1080 ¿SE ACEPTA)	ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 6
42	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO MÚLTIPLES CAMAS PUNTO 18	AL SER SAMIH UN SISTEMA HOSPITALARIO MÉDICO ELECTRÓNICO QUE SIRVE PARA ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES, CONSIDERAMOS QUE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE SAMIH EN LA CENTRAL DE MONITOREO ES UN ERROR DE REDUNDANCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	
43	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES PUNTO 1.18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION QUE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL, PARA NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
44	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS PUNTO 3.1.	SOLICITAN RESOLUCION DE PANTALLA DE 3 MB, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, RESOLUCION DE PANTALLA DE 1920 X 1080 ¿SE ACEPTA)	ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 6
45	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS PUNTO 18	AL SER SAMIH UN SISTEMA HOSPITALARIO MÉDICO ELECTRÓNICO QUE SIRVE PARA ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES, CONSIDERAMOS QUE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE SAMIH EN LA CENTRAL DE MONITOREO ES UN ERROR DE REDUNDANCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
46	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES PUNTO 1.18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION QUE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL, PARA NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
47	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS PUNTO 3.1.	SOLICITAN RESOLUCION DE PANTALLA DE 3 MB, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, RESOLUCION DE PANTALLA DE 1920 X 1080 ¿SE ACEPTA)	ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 6
48	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS PUNTO 18	AL SER SAMIH UN SISTEMA HOSPITALARIO MÉDICO ELECTRÓNICO QUE SIRVE PARA ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES, CONSIDERAMOS QUE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE SAMIH EN LA CENTRAL DE MONITOREO ES UN ERROR DE REDUNDANCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA CEDULA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
49	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES PUNTO 1.18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION QUE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL, PARA NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPECTAR LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
50	PARTIDA 47 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PUNTO 8	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR PARA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE,	PUEDEN OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO A



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		COMPARTIMIENTO EN LA BASE PARA EFECTOS PERSONALES LO CUAL CUMPLE LA FUNCIÓN REQUERIDA ¿SE ACEPTA?	LOS DEMÁS OFERENTES
51	PARTIDA 52 REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAPACIDAD 20 PIES CÚBICOS PUNTO 6	DICE: MONITOR ELECTRÓNICO QUE PERMITE EL REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS MINIMO 2 DIAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON UN GRAFICADOR CIRCULAR DE 4" PARA REGISTRAR INFORMACIÓN POR 7 DÍAS 24 HORAS, SE ACEPTA ?	NO SE ACEPTA
52	NUMERAL 4.6.2 PROPUESTA ECONÓMICA SUBNUMERAL 1	MENCIONAN QUE DENTRO DEL ANEXO 20 SE DEBERÁ COLOCAR CÓDIGO CABMSDF, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INDICAR DONDE SE ENCUENTRA DESGLOSADO ESTE CÓDIGO O PROPORCIONARLO PARA CADA PARTIDA SOLICITADA. FAVOR DE ACLARAR	MANIFIESTA LA CONVOCANTE QUE PUEDE PRESENTAR SU PROPUESTA SIN INCLUIR DICHO CÓDIGO
53	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	DENTRO DE LAS BASES NI EN LOS ANEXOS 1.8 Y 1.1 NO SE ENCUENTRAN TODAS LAS CÉDULAS DE LAS PARTIDAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA UNA DE LAS CÉDULAS FALTANTES. ¿SE ACEPTA?	ATENDER PRECISIÓN NÚMERO 1 DE LA CONVOCANTE
54	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR LAS CÉDULAS DE LAS PARTIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DESGLOSADAS DENTRO DE LAS BASES, ES DECIR, NOS PROPORCIONE LAS CÉDULAS PARA LAS PARTIDAS: 1, 3, 4, 6, 7, 20-31, 33-42, 44-46, 48-52, 53, 55-58, 60, 62-65, 70-76, 78-80, 82-86, 88-90, 92, 94, 96-110, 112, 117, 119.	ATENDER PRECISIÓN NÚMERO 1 DE LA CONVOCANTE
55	NUMERAL 4.7 PROPUESTAS, SUBNUMERAL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 4.7.1.1. ÚLTIMO PÁRRAFO	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERÁ INTEGRAR CON EL ANEXO 19, SEGUIDO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ES DECIR, ÚNICAMENTE, DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA ÚNICAMENTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	SE REFIERE A QUE SE DEBE REQUISITAR UN ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA POR PARTIDA QUE SE OFERTE. ADJUNTANDO EN SU RESPECTIVO ANEXO 19, LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBIDAMENTE REFERENCIADA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE CADA PUNTO DE LAS CEDULAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
56	NUMERAL 4.7 PROPUESTAS, SUBNUMERAL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 4.7.1.1. ÚLTIMO PÁRRAFO	EN CASO DE OFERTAR MÁS DE UNA PARTIDA ENTENDEMOS QUE LA MANERA CORRECTA DE INTEGRAR LA PROPUESTA TÉCNICA SERÁ ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS DE LA PRIMER PARTIDA, ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS DE LA SEGUNDA PARTIDA, POR LO QUE EL ANEXO 19 DEBERÁ SER POR CADA PARTIDA OFERTADA. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
57	NUMERAL 4.7 PROPUESTAS, SUBNUMERAL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 4.7.1.3	ENTENDEMOS QUE EN ESTE NUMERAL SE DEBERÁN CONSIDERAR ÚNICAMENTE LAS NORMAS Y/O CERTIFICADOS QUE APLIQUEN A LA PARTIDA OFERTADA. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO Y SE DEBERÁ ATENDER POR TIPO DE BIEN ASI COMO LAS ESPECIFICAS MENCIONADAS EN CADA CEDULA
58	NUMERAL 4.7 PROPUESTAS, SUBNUMERAL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 4.7.1.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO IMPRESA A COLOR, YA QUE ACTUALMENTE LA MAYORÍA DE LOS FABRICANTES FIRMAN DE MANERA DIGITAL LAS CARTAS. ¿SE ACEPTA?	PUEDA ADJUNTARSE ASI LA CARTA, PERO DEBERÁ AGREGAR COPIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ENVIA EL DOCUMENTO, EN CASO DE QUE NO SE ANEXE LA IMPRESIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO, SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
59	NUMERAL 4.7 PROPUESTAS, SUBNUMERAL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 4.7.1.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE SE LLEGUE A DIFERIR LA FECHA DE APERTURA SE PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO CON LA FECHA QUE SE ESTABLECIÓ EN BASES ORIGINALMENTE, EN ESTE CASO DEL 26 DE JULIO DEL 2022. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
60	NUMERAL 4.7 PROPUESTAS, SUBNUMERAL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 4.7.1.4	DEBIDO A QUE VARIOS DE LOS FABRICANTES SON EXTRANJEROS, CUENTAN CON FILIALES O REPRESENTACIONES EN MÉXICO EXCLUSIVAS PARA REPRESENTARLOS, SOLICITAMOS SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DE LA FILIAL EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	LA CARTA DE APOYO DEBERÁ SER DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
61	NUMERAL 4.7 PROPUESTAS, SUBNUMERAL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 4.7.1.7	SOLICITAN ...ASÍ COMO UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA, SOLICIMOS SE PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, ENTREGAR CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA O ACTA DE ENTREGA INSTALACIÓN CAPACITACIÓN FIRMADA POR EL CLIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PUEDE ADJUNTAR, CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA FIRMADA POR EL CLIENTE
62	NUMERAL 4.7 PROPUESTAS, SUBNUMERAL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 4.7.1.9...CERTIFICADOS O DIPLOMAS...EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO	DEBIDO A LA SITUACIÓN MUNDIAL LOS FABRICANTES OPTARON POR EL ENVÍO DE CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE MANERA DIGITAL O ELECTRÓNICA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ENTREGANDO IMPRESIÓN A COLOR DE LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS EMITIDOS POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE ADJUNTARSE ASI LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN, PERO DEBERÁ AGREGAR COPIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ENVIA EL DOCUMENTO, EN CASO DE QUE NO SE ANEXE LA IMPRESIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO, SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
63	ANEXO 29	ALGUNAS PARTIDAS NO CUENTAN CON EL DESGLOSE DE TIEMPO DE ENTREGA EN EL ANEXO 29, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDAN PROPORCIONAR EL TIEMPO DE ENTREGA APARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	ATENDER LA PRECISIÓN 2 POR PARTE DE LA CONVOCANTE
64	ANEXO 29	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARAE SI LOS DÍAS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 29 SON DÍAS HÁBILES O NATURALES. FAVOR DE ACLARAR	SE TRATA DE DIAS NATURALES
65	4.1 MUESTRAS	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCATE REQUIERE ÚNICAMENTE MUESTRAS DE LAS PARTIDAS ENLISTADAS EN ESTE PUNTO CUMPLIENDO LOS LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DESCRITOS, ES DECIR, MUESTRAS DE LAS PARTIDAS DE IMAGEN PARA LAS PARTIDAS: 3, 4, 6, 7, 23 Y 111, PARTIDAS DE CENTRALES DE MONITOREO Y MONITORES PARTIDAS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15, PARTIDAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO	ATENDER LA PRECISIÓN 1 POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		MÉDICO: 31, 33, 35, 39, 66, 67, 89, 90, 94, 98, 100, 104, 108, 164, 173 Y 180, MAS LAS ADICIONALES PARA INSTRUMENTAL. ¿ES ESTO CORRECTO?	
66	4.1 MUESTRAS	PARA LAS MUESTRAS DE LAS CENTRALES DE MONITOREO Y MONITORES (PARTIDAS DE LA 8 A LA 15), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PRESENTANDO VIDEO QUE DEMUESTRE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
67	NUMERAL 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN	ENTENDEMOS QUE LA CARTA SOLICITADA EN EL TERCER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL, SERÁ ENTREGADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SERÁ MEDIANTE ESCRITO LIBRE
68	ANEXO 1.8	ENTENDEMOS QUE LOS NÚMEROS DE PARTIDA, CLAVES, CANTIDADES E INFORMACIÓN EN GENERAL SERÁ TOMADA DE LA PRIMER PESTAÑA DEL ANEXO 1.8 DENOMINADA "CONCENTRADO" DEBIDO A QUE LAS CANTIDADES DE LA SEGUNDA PESTAÑA DE DICHO ANEXO DENOMINADA "HOJA 2" NO COINCIDEN CON LAS PUBLICADAS EN BASES. ¿ES ESTO CORRECTO?	DEBERAN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA HOJA DENOMINADA "CONCENTRADO". ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LS PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
69	4.2 VISITAS	EL DÍA 20 DE JULIO SE REALIZÓ LA VISITA AL ÁREA SIN EMBARGO SE COMENTO EN LA MISMA QUE ALGUNAS PARTIDAS SE CANCELABAN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR LAS PARTIDAS QUE SE REQUIEREN. FAVOR DE ACLARAR	SE DEBERÁ ATENDER A LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE.
REPREGUNTA			
		SE SOLICITA SE ACLARE LA DEFINICIÓN A LA QUE HACE MENCIÓN EL ÁREA TÉCNICA, REFERENTE A LOS MONITORES	PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 6, DEBERÁ SER DE 2 MEGAPIXELES

4. - INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	DICE: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		DISTRITO FEDERAL, LA DESCRIPCIÓN, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CANTIDADES Y UNIDAD DE MEDIDA SE DETALLA EN EL ANEXO TÉCNICO, EN SU NUMERAL 2.1- "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTAS BASES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONE LAS DESCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS FALTANTES O QUE NOS INDIQUE CUÁL ES EL LISTADO DEFINITIVO DE PARTIDAS A ADQUIRIR, DE ACUERDO CON EL LISTADO DEL ANEXO 1.8. FAVOR DE ACLARAR.	PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
2	2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN	DICE: ... LOS LICITANTES DEBERÁN MANIFESTAR EL CONTENIDO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL CON EL QUE CUENTAN LOS BIENES QUE OFERTA, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN. PREGUNTA: EN EL CASO DE MI REPRESENTADA, LOS BIENES QUE OFERTAREMOS SON DE IMPORTACIÓN, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL Y QUE SERÁ EL PORCENTAJE QUE INCLUIREMOS EN NUESTRA PROPUESTA ES 0. ¿ES ESTO CORRECTO?	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA ESTE, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

3	2.3 PERÍODO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ANEXO 1.8 PRESCRIPCIONES DE BIENES ANEXO 29	DICE: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL LUGAR DE ENTREGA Y LAS CONDICIONES DE ENTREGAS SON LAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 2.5.1. "LUGAR DE ENTREGA" Y 2.5.2. "CONDICIONES DE ENTREGA" ... LA ENTREGA, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.1 "FICHAS TÉCNICAS", DE LA PARTIDA QUE OFERTE ... EL LICITANTE DEBERÁ ATENDER LOS PLAZOS DE ENTREGA SEÑALADOS EN EL ANEXO 29. PREGUNTA: YA QUE NO SE MENCIONAL EL PLAZO DE ENTREGA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS ENLISTADAS EN EL ANEXO 1.8, ENTENDEMOS QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS: 1, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 78, 114, 116, Y 117; SERÁ DE 120 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO. ¿ES ESTO CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
4	4.1 MUESTRAS	DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 4.1 "MUESTRAS". PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO SE REQUERIRÁ LA MUESTRA PARA LAS PARTIDAS ENLISTADAS EN EL NUMERAL 4.1., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS	EL OFERENTE DEBERÁ REGISTRAR SU INGRESO Y ESPERAR EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO CONFORME REGISTRARON SU TURNO PARA LA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		INDIQUE CUÁNTO TIEMPO DEBERÁN PERMANECER LAS MUESTRAS EN SUS INSTALACIONES Y SI EL MISMO DÍA DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS SE REQUIERE REALIZAR UNA DEMOSTRACIÓN O SI USTEDES NOS LLAMARÁN PARA PROGRAMARLA. FAVOR DE ACLARAR.	REVISIÓN DE LA MUESTRA, LA CUAL SERÁ EVALUADA EN PRESENCIA DEL ESPECIALISTA DEL PRODUCTO DEL OFERENTE, REGRESANDOSÉ AL MOMENTO DE CONCLUIR LA EVALUACIÓN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS A EVALUAR, DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO OFERTADO.
5	4.1 MUESTRAS	PREGUNTA: EN EL CASO DE QUE PARA DIFERENTES PARTIDAS SE OFERTEN LOS MISMOS MODELOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA, QUE AMPARE LA TOTALIDAD DE PARTIDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PERO EN EL ANEXO 1.3 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS DEBERÁ QUEDAR EN ESPECÍFICO LAS PARTIDAS QUE TIENEN EL MISMO MODELO
6	4.1 MUESTRAS	PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LA LOGÍSTICA DE ENVÍO Y RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE LA FECHA QUE TIENE PROGRAMADA PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS MISMAS. FAVOR DE ACLARAR.	LAS MUESTRAS SE ENTREGARÁN EL MISMO DÍA
7	4.1 MUESTRAS	DICE: ANEXO 1.3 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI EN LA COLUMNA "TIPO DE INSUMO" DEL ANEXO 1.3, SE DEBERÁ ESCRIBIR LA PALABRA EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ ESCRIBIR, EQUIPO MÉDICO Ó MOBILIARIO Ó INSTRUMENTAL SEGÚN CORRESPONDA A LA PARTIDA QUE OFERTE
8	4.1 MUESTRAS	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE PARA LAS PARTIDAS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 SE PERMITA CUMPLIR ESTE REQUISITO MEDIANTE VIDEO DEMOSTRATIVO O BIEN, QUE SE PERMITA QUE LOS LICITANTES TRASLADEMOS AL PERSONAL A CARGO DE VERIFICAR LAS MUESTRAS AL DOMICILIO DE ALGÚN CLIENTE CON EL QUE TENGAMOS INSTALADO UN EQUIPO CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE SER PRESENCIAL

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

9	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS	DICE: B) INDICAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COMPLETO DEL LICITANTE, FECHA, NÚMERO Y OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI SERÁ SUFICIENTE CON INCLUIR EL	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CONSIDERANDO QUE DICHOS DATOS SE DEBEN SEÑALAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
---	-----------------------------------	--	---



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COMPLETO DEL LICITANTE, FECHA, NÚMERO Y OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA. ¿ES ESTO CORRECTO?	
10	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS	DICE: F) LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE QUE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUIERA DE MÁS DE UNA PÁGINA, ÉSTE DEBERÁ SER FIRMADO ÚNICAMENTE EN LA QUE SE INDICA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O, EN SU CASO, EL DE LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE.
11	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS	DICE: D) SIN TACHADURAS, NI ENMENDADURAS, EN IDIOMA ESPAÑOL O CON TRADUCCIÓN SIMPLE Y NO DEBERÁ CONTENER EL LOGOTIPO DE "LA CONVOCANTE". PREGUNTA: POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL, DEBEMOS ENTENDER QUE LA TRADUCCIÓN SIMPLE SERÁ ÚNICAMENTE DE LOS RENGLONES UTILIZADOS PARA REFERENCIAR. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
12	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	DICE: LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PRESENTE NUMERAL (INCISOS "A" AL "L"), DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DEL SOBRE ÚNICO (CAJA, PAQUETE, ETC.), DE FORMA IMPRESA Y ESCANEADA DE MANERA LEGIBLE Y COMPLETA (EN FORMATO PDF) EN CD O DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (USB) Y ADEMÁS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE, LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PRESENTADA SERÁ DEVUELTA AL TÉRMINO DE SU REVISIÓN. PREGUNTA: EN EL CASO DE LOS INCISOS: A), F), G), H), I), J), K) Y L), SOLICITAMOS QUE SE PERMITA PRESENTAR COMO ORIGINAL LA IMPRESIÓN DE LOS MISMOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ENTREGAR COMO SE SOLICITA EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
13	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	DICE: G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: ...	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE RESULTAN APLICABLES, ASÍ COMO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		PREGUNTA: EN EL CASO DE MI REPRESENTADA, EL DOMICILIO FISCAL NO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR EL ANEXO 4 DEBIDAMENTE REQUISITADO. ¿ES ESTO CORRECTO?	LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO
14	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	DICE: L) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON DICHO REQUISITO SE DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE ADVIERTE QUE AL LICITANTE NO SE LE IDENTIFICARON ADEUDOS ANTE EL INFONAVIT, Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DE APORTAR EL CINCO POR CIENTO DE LOS SALARIOS CUBIERTOS A SUS TRABAJADORES Y DE RETENER Y ENTERAR LOS DESCUENTOS PARA AMORTIZACIONES DE CRÉDITO. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, DEBERÁ ANEXAR LOS ENTEROS CORRESPONDIENTES A LOS DOS DE BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES.
15	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO A	DICE: A. ATRAVÉS DEL ANEXO 3 DE ESTAS BASES, EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA CUMPLIDO DEBIDAMENTE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 8.2, 8.3 Y 8.4 DE LA CIRCULAR GENERAL PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ... PREGUNTA: EN EL CASO DE MI REPRESENTADA, EL DOMICILIO FISCAL NO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE DEBEREMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR EL ANEXO 4 DEBIDAMENTE REQUISITADO. ¿ES ESTO CORRECTO?	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LES RESULTAN APLICABLES, EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO
16	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO G	DICE: G. DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.2 DE ESTAS BASES, "LOS LICITANTES" DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE INDIQUE EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL CON EL QUE CUENTAN LOS BIENES QUE OFERTAN, SEA CUAL SEA ÉSTE Y EL PAÍS DE ORIGEN. ANEXO 9.	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA ESTE, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		PREGUNTA: EN EL CASO DE MI REPRESENTADA, LOS BIENES QUE OFERTAREMOS SON DE ORIGEN EXTRANJERO, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE EN EL ANEXO 9 "MANIFESTACIÓN DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL" ESCRIBIREMOS 0% DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. ¿ES ESTO CORRECTO?	
17	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO R	DICE: R. ÚNICAMENTE PARA LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTEN CON OTRO U OTROS PARTICIPANTES PROPUESTA DE MANERA CONJUNTA ... PREGUNTA: EN EL CASO DE MI REPRESENTADA NO PRESENTAREMOS NUESTRA PROPUESTA DE MANERA CONJUNTA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE SE INDIQUE QUE LO SOLICITADO NO NOS APLICA. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

18	4.6 PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA	DICE: EL PARTICIPANTE DEBERÁ ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL MODELO DEL ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA" ... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DEL ESPACIO QUE INDICA "PARA LOGOTIPO DE LA EMPRESA", SE REFIEREN A QUE SE DEBERÁ INSERTAR EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA LICITANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
19	4.7 PROPUESTAS 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DICE: 4.1.7.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO: PARA TODAS LAS PARTIDAS EL OFERENTE, DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL, CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDA LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LA ADJUDICACIÓN QUE SE DERIVE DE ESTE PROCEDIMIENTO ... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁ EL APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO A UN SOLO DISTRIBUIDOR POR PARTIDA. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO
20	4.7 PROPUESTAS 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DICE: DICHAS CARTAS DE APOYO DEBERÁ CONTAR CON SELLO Y FIRMA DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE A LA ENTREGA DE PROPUESTAS Y DENTRO DEL	NO ES CORRECTO, DE PREFERENCIA SE DEBERÁ ANEXAR CARTA EN ORIGINAL, PERO TAMBIÉN PUEDEN AGREGAR



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		SOBRE SE DEBERÁ ENTREGAR LA CARTA ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿ES ESTO CORRECTO?	CARTA IMPRESA, ADJUNTANDO EL CORREO ELECTRONICO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ENVÍA LA CARTA, SIN ESTO SE CONSIDERARA PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARA LA PROPUESTA
21	4.7 PROPUESTAS. 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.5 GUÍAS MECÁNICAS 4.7.1.6 CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA DEMOSTRAR ESTOS REQUISITOS MEDIANTE CARTA COMPROMISO DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR LO INDICADO EN DICHS NUMERALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
22	4.7 PROPUESTAS. 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.9 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	DICE: 4.7 PROPUESTAS. 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA. 4.1.7.9 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO ... LOS INGENIEROS DE SERVICIO ENLISTADOS SERÁN LOS ÚNICOS QUE PODRÁN DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE NUMERAL ES DEL PERSONAL DE SERVICIO QUE PROPORCIONARÁ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
23	4.7 PROPUESTAS. 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA	PREGUNTA: EN CASO DE QUE ALGÚN DOCUMENTO Y/O ESCRITO SOLICITADO NO NOS APLIQUE, SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE EL NUMERAL NO APLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
24	4.7 PROPUESTAS. 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.19 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS	DICE: 4.7 PROPUESTAS. 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA. 4.7.1.19 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS: LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A QUE COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBERÁ INCLUIR EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA EMPRESA PARA LA ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
25	4.7 PROPUESTAS. 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.19 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS	DICE: 4.7 PROPUESTAS. 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA. 4.7.1.19 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS: LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS. PREGUNTA: EN EL CASO DEL ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS, LAS	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN LO MISMO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		EMPRESAS PODRÍAN LLAMARLOS DE MANERA DIFERENTE, AUNQUE EL OBJETIVO Y ALCANCE SEAN LOS MISMOS; POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA PRESENTAR Y DEMOSTRAR LOS PROCEDIMIENTOS AUNQUE SEAN NOMBRADOS DE MANERA DIFERENTE POR CADA LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	
26	TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR AQUELLOS PUNTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN ALGÚN TIPO DE MANUAL O FOLLETO, PERO QUE SI SE CUMPLEN CON CARTA BAJO PROTESTA, DE PARTE DEL FABRICANTE DE DECIR LA VERDAD QUE SE CUMPLE CON EL PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ REFERENCIAR CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS O SU EQUIVALENCIA DE ACUERDO A MARCA Y MODELO OFERTADO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EQUIVALENTE
27	TODAS LAS PARTIDAS	YA QUE EXISTEN MANUALES QUE SUELEN CONTENER DEMASIADA INFORMACIÓN Y POR TANTO DEMASIADAS HOJAS, Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE LES ENTREGARAN MANUALES DE USUARIO, SERVICIO, ETC. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITAN ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS PARTES REFERENCIADAS DEL MANUAL DE USUARIO. O DE CUALQUIER OTRO MANUAL O FOLLETO PARA DEMOSTRAR LOS PUNTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SE DEBERA PRESENTAR IMPRESO PORTADA, HOJAS REFERENCIADAS Y CONTRAPORTADA DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS, Y DEBERÁ ENTREGAR EN FORMA ELECTRONICA EN PDF, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLETOS. EN CASO QUE NO ESTEN COMPLETOS LOS ARCHIVOS DIGITALES, SE CONSIDERARAR COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
28	PARTIDA 2 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO. 5.2 PARA INSTRUMENTOS HUECOS Y NO HUECOS.	ENTENDEMOS QUE CON INSTRUMENTOS HUECOS Y NO HUECOS, SE REFIERE A QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE ESTERILIZAR INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS CON LÚMENES RÍGIDOS LARGOS.	INSTRUMENTOS HUECOS Y NO HUECOS SE REFIERE A CANULADOS O NO CANULADOS
29	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 3.1. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO DE 3 MB.	ENTENDEMOS QUE LA RESOLUCIÓN DE UNA PANTALLA SE PUEDE EXPRESAR EN MEGABYTES O BIEN EN PÍXELES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE MÍNIMO 3MB O BIEN 1920 X 1200 PÍXELES O PUNTOS, YA QUE ESTE TIPO DE RESOLUCIONES SON DE ALTA CALIDAD.	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 6 DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES
30	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	AL CONTAR CON UN ALMACENAMIENTO DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICO, ES POSIBLE QUE SE PRESENTEN ERRORES DE ALMACENAMIENTO, YA QUE AL TENER UNA	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	16.1 ALMACENAMIENTO DE EVENTOS MANUAL Y AUTOMÁTICOS.	OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO MANUAL, LA INFORMACIÓN SOLO SE GUARDARA CUANDO SE SELECCIONA DICHA OPCIÓN POR LA PARTE USUARIA Y ESTO PUEDE OCASIONAR PERDIDA DE INFORMACIÓN, POR LO CONTRARIO SI EL ALMACENAMIENTO ES DE MANERA AUTOMÁTICA, LA PARTE USUARIO NO DEBE HACER NADA, Y ASÍ, SE TIENE UNA CERTEZA QUE LA INFORMACIÓN SIEMPRE SE GUARDARA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS SEA DE FORMA MANUAL Y/U OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	
31	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 17.1 FORMATO PDF PARA IMPRESIÓN	EXISTEN DIFERENTES MANERAS DE IMPRIMIR LOS SUCESOS MOMENTANEOS DEL PACIENTE, ENTRE ELLAS QUE EL EQUIPO GENERE UN PDF Y ENSEGUIDA IMPRIMIRLO, ACTUALMENTE EXISTEN TECNOLOGÍAS LAS CUALES PERMITEN IMPRIMIR EN TIEMPO REAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO TECNOLOGÍA LA CUAL PERMITA IMPRIMIR EN TIEMPO REAL LOS SUCESOS DEL PACIENTE SIN NECESIDAD DE GENERAR ANTERIORMENTE UN ARCHIVO PDF. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
32	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 17.2 CAPACIDAD DE EXPORTAR REGISTROS EN FORMATO EXCEL O PDF A UN DISPOSITIVO USB.	LA EXPORTACIÓN DE DATOS DE UN PACIENTE EN CUALQUIER TIPO DE FORMATO, PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS COMO LOS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE, LO CUAL PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS AL TENER LA INFORMACIÓN DE ALGÚN PACIENTE EN UNA MEMORIA TIPO USB, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
33	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.CINCO MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS MODULARES CON PANTALLA DE 15" COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.	ENTRE MAYOR SEA EL TAMAÑO DE UNA PANTALLA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, MAYOR INFORMACIÓN SE PUEDE VISUALIZAR SIMULTÁNEAMENTE, COMO LO SON VALORES NUMÉRICOS Y CURVAS, Y DADO QUE PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITAN 8 CURVAS DE MANERA SIMULTANEA, UN MONITOR DE 12" PUEDE TENER LA MISMA CANTIDAD DE CURVAS Y VALORES NUMÉRICOS. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR MONITOR MODULAR DE 12" COMO MÍNIMO SIEMPRE Y CANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
34	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.18. QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS (EMIRADI) EN FORMATO DICOM, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SE REQUIERE	LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS ES UNA TECNOLOGÍA PROPIA DE UNA MARCA EN ESPECIFICO, Y DADO QUE ESTA LICITACIÓN ES DE LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO ES TECNOLOGIA PROPIA DE UNA MARCA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.		
35	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.19.8. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS.	UN DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 12 DERIVACIONES SE DA EN LA MAYORÍA DE LAS MARCAS, Y DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PUEDE SER CON CABLE DE 5, 6 O 10 LATIGUILLOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 12 DERIVACIONES CON UN CABLE DE PACIENTE DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO PODRÁ SER CON CABLE DE 5 O 6 LATIGUILLOS SOLAMENTE
36	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.20 SPO2	¿REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA MEDIR EL SPO2 EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN?	PUEDA OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
37	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.22.1 EN AL MENOS UN CANAL	ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE UNA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN AL MENOS DOS CANALES, YA QUE EN EL PUNTO 1.22.2, SE SOLICITA UNA MONITORIZACIÓN SIMULTANEA DE DOS TEMPERATURAS T1 Y T2. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
38	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.25.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS POR TÉCNICA MAINSTREAM, ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO.	EN LAS DIFERENTES MARCAS EN EL MERCADO LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA VARÍA DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ALGUNAS MARCAS MANEJAN TECNOLOGÍA SIDESTREAM Y OTRAS MAINSTREAM, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA HACER LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA POR MEDIO DE SIDESTREAM O MAINSTREAM, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LAS CAPACIDADES DE HACER LA MEDICIÓN PARA TODO TIPO DE PACIENTES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
39	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 2. ECG: DOS CABLES TRONCALES Y DOS CABLES DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS, DOS DE ECG DE 5 PUNTAS Y UN CABLE DE LATIGUILLOS DE 10 PUNTAS POR MONITOR	CADA MARCA DE MONITORES EN EL MERCADO UTILIZA SI PROPIA TECNOLOGÍA, EXISTEN MARCAS QUE DESARROLLAN CABLES DE PACIENTE (LATIGUILLOS) DE 5 O 6 DERIVACIONES Y QUE MUESTRAN LA MISMA INFORMACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA UTILIZAR CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 5 O 6 PUNTAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
40	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 3.1. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO DE 3 MB.	ENTENDEMOS QUE LA RESOLUCIÓN DE UNA PANTALLA SE PUEDE EXPRESAR EN MEGABYTES O BIEN EN PÍXELES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE MÍNIMO 3MB O BIEN 1920 X 1200 PÍXELES O PUNTOS, YA QUE ESTE TIPO DE RESOLUCIONES SON DE ALTA CALIDAD.	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 6 DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES
41	PARTIDA 10	AL CONTAR CON UN ALMACENAMIENTO DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICO, ES POSIBLE	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 16.1 ALMACENAMIENTO DE EVENTOS MANUAL Y AUTOMÁTICOS.	QUE SE PRESENTEN ERRORES DE ALMACENAMIENTO, YA QUE AL TENER UNA OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO MANUAL, LA INFORMACIÓN SOLO SE GUARDARA CUANDO SE SELECCIONA DICHA OPCIÓN POR LA PARTE USUARIA Y ESTO PUEDE OCASIONAR PERDIDA DE INFORMACIÓN, POR LO CONTRARIO SI EL ALMACENAMIENTO ES DE MANERA AUTOMÁTICA, LA PARTE USUARIO NO DEBE HACER NADA, Y ASÍ, SE TIENE UNA CERTEZA QUE LA INFORMACIÓN SIEMPRE SE GUARDARA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS SEA DE FORMA MANUAL Y/O OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	
42	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 17.1 FORMATO PDF PARA IMPRESIÓN	EXISTEN DIFERENTES MANERAS DE IMPRIMIR LOS SUCESOS MOMENTANEOS DEL PACIENTE, ENTRE ELLAS QUE EL EQUIPO GENERE UN PDF Y ENSEGUIDA IMPRIMIRLO, ACTUALMENTE EXISTEN TECNOLOGÍAS LAS CUALES PERMITEN IMPRIMIR EN TIEMPO REAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO TECNOLOGÍA LA CUAL PERMITA IMPRIMIR EN TIEMPO REAL LOS SUCESOS DEL PACIENTE SIN NECESIDAD DE GENERAR ANTERIORMENTE UN ARCHIVO PDF. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
43	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 17.2 CAPACIDAD DE EXPORTAR REGISTROS EN FORMATO EXCEL O PDF A UN DISPOSITIVO USB.	LA EXPORTACIÓN DE DATOS DE UN PACIENTE EN CUALQUIER TIPO DE FORMATO, PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS COMO LOS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE, LO CUAL PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS AL TENER LA INFORMACIÓN DE ALGÚN PACIENTE EN UNA MEMORIA TIPO USB, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
44	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1. CINCO MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS MODULARES CON PANTALLA DE 15" COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.	ENTRE MAYOR SEA EL TAMAÑO DE UNA PANTALLA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, MAYOR INFORMACIÓN SE PUEDE VISUALIZAR SIMULTÁNEAMENTE, COMO LO SON VALORES NUMÉRICOS Y CURVAS, Y DADO QUE PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITAN 8 CURVAS DE MANERA SIMULTANEA, UN MONITOR DE 12" PUEDE TENER LA MISMA CANTIDAD DE CURVAS Y VALORES NUMÉRICOS. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR MONITOR MODULAR DE 12" COMO MÍNIMO SIEMPRE Y CANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
45	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.18. QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS (EMIRADI) EN FORMATO DICOM, DE ACUERDO A	LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS ES UNA TECNOLOGÍA PROPIA DE UNA MARCA EN ESPECIFICO, Y DADO QUE ESTA LICITACIÓN ES DE LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.	PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	
46	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.20.8. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS.	UN DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 12 DERIVACIONES SE DA EN LA MAYORÍA DE LAS MARCAS, Y DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PUEDE SER CON CABLE DE 5, 6 O 10 LATIGUILLOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 12 DERIVACIONES CON UN CABLE DE PACIENTE DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
47	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.21 SPO2	¿REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA MEDIR EL SPO2 EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
48	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.23.1 EN AL MENOS UN CANAL	ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE UNA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN AL MENOS DOS CANALES, YA QUE EN EL PUNTO 1.23.2, SE SOLICITA UNA MONITORIZACIÓN SIMULTANEA DE DOS TEMPERATURAS T1 Y T2. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
49	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.26.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS POR TÉCNICA MAINSTREAM, ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO.	EN LAS DIFERENTES MARCAS EN EL MERCADO LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA VARÍA DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ALGUNAS MARCAS MANEJAN TECNOLOGÍA SIDESTREAM Y OTRAS MAINSTREAM, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA HACER LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFIA POR MEDIO DE SIDESTREAM O MAINSTREAM, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LAS CAPACIDADES DE HACER LA MEDICION PARA TODO TIPO DE PACIENTES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
50	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.28 ECG: DOS CABLES TRONCALES Y DOS CABLES DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS, DOS DE ECG DE 5 PUNTAS Y UN CABLE DE LATIGUILLOS DE 10 PUNTAS POR MONITOR	CADA MARCA DE MONITORES EN EL MERCADO UTILIZA SI PROPIA TECNOLOGÍA, EXISTEN MARCAS QUE DESARROLLAN CABLES DE PACIENTE (LATIGUILLOS) DE 5 O 6 DERIVACIONES Y QUE MUESTRAN LA MISMA INFORMACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA UTILIZAR CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 5 O 6 PUNTAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO CORRESPONDE LA PREGUNTA EN EL PUNTO 1.28
51	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.31. PANI: DOS BRAZALETES ADULTO REUSABLE, UN BRAZALETE ADULTO OBESO REUSABLE PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, INCLUIR DOS MANGUERAS DE CONEXIÓN CON CONECTOR	ENTENDEMOS QUE LOS BRAZALETES SOLICITADOS SON INCORRECTOS, YA QUE EL MONITOR ES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 8, DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	PARA LOS BRAZALETES POR MONITOR.		
52	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 3.1. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO DE 3 MB.	ENTENDEMOS QUE LA RESOLUCIÓN DE UNA PANTALLA SE PUEDE EXPRESAR EN MEGABYTES O BIEN EN PÍXELES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE MÍNIMO 3MB O BIEN 1920 X 1200 PÍXELES O PUNTOS, YA QUE ESTE TIPO DE RESOLUCIONES SON DE ALTA CALIDAD.	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 6, DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES
53	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 16.1 ALMACENAMIENTO DE EVENTOS MANUAL Y AUTOMÁTICOS.	AL CONTAR CON UN ALMACENAMIENTO DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICO, ES POSIBLE QUE SE PRESENTEN ERRORES DE ALMACENAMIENTO, YA QUE AL TENER UNA OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO MANUAL, LA INFORMACIÓN SOLO SE GUARDARA CUANDO SE SELECCIONA DICHA OPCIÓN POR LA PARTE USUARIA Y ESTO PUEDE OCASIONAR PERDIDA DE INFORMACIÓN, POR LO CONTRARIO SI EL ALMACENAMIENTO ES DE MANERA AUTOMÁTICA, LA PARTE USUARIO NO DEBE HACER NADA, Y ASÍ, SE TIENE UNA CERTEZA QUE LA INFORMACIÓN SIEMPRE SE GUARDARA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS SEA DE FORMA MANUAL Y/O OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
54	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 17.1 FORMATO PDF PARA IMPRESIÓN	EXISTEN DIFERENTES MANERAS DE IMPRIMIR LOS SUCESOS MOMENTANEOS DEL PACIENTE, ENTRE ELLAS QUE EL EQUIPO GENERE UN PDF Y ENSEGUIDA IMPRIMIRLO, ACTUALMENTE EXISTEN TECNOLOGÍAS LAS CUALES PERMITEN IMPRIMIR EN TIEMPO REAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO TECNOLOGÍA LA CUAL PERMITA IMPRIMIR EN TIEMPO REAL LOS SUCESOS DEL PACIENTE SIN NECESIDAD DE GENERAR ANTERIORMENTE UN ARCHIVO PDF. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
55	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 17.2 CAPACIDAD DE EXPORTAR REGISTROS EN FORMATO EXCEL O PDF A UN DISPOSITIVO USB.	LA EXPORTACIÓN DE DATOS DE UN PACIENTE EN CUALQUIER TIPO DE FORMATO, PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS COMO LOS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE, LO CUAL PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS AL TENER LA INFORMACIÓN DE ALGÚN PACIENTE EN UNA MEMORIA TIPO USB, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
56	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES OCHO MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS MODULARES CON PANTALLA DE 15" COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.	ENTRE MAYOR SEA EL TAMAÑO DE UNA PANTALLA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, MAYOR INFORMACIÓN SE PUEDE VISUALIZAR SIMULTÁNEAMENTE, COMO LO SON VALORES NUMÉRICOS Y CURVAS, Y DADO QUE PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITAN 8 CURVAS DE MANERA SIMULTANEA, UN MONITOR DE 12" PUEDE TENER LA MISMA CANTIDAD DE CURVAS Y VALORES NUMÉRICOS. POR LO	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR MONITOR MODULAR DE 12" COMO MÍNIMO SIEMPRE Y CANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR. ¿SE ACEPTA?	
57	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.18. QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS (EMIRADI) EN FORMATO DICOM, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.	LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS ES UNA TECNOLOGÍA PROPIA DE UNA MARCA EN ESPECIFICO, Y DADO QUE ESTA LICITACIÓN ES DE LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
58	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.21.8. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS.	UN DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 12 DERIVACIONES SE DA EN LA MAYORÍA DE LAS MARCAS, Y DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PUEDE SER CON CABLE DE 5, 6 O 10 LATIGUILLOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 12 DERIVACIONES CON UN CABLE DE PACIENTE DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
59	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.22 SPO2	¿REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA MEDIR EL SPO2 EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN?	YA SE CONTESTÓ
60	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.24.1 EN AL MENOS UN CANAL	ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE UNA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN AL MENOS DOS CANALES, YA QUE EN EL PUNTO 1.24.2, SE SOLICITA UNA MONITORIZACIÓN SIMULTANEA DE DOS TEMPERATURAS T1 Y T2. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
61	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.27.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS POR TÉCNICA MAINSTREAM, ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO.	EN LAS DIFERENTES MARCAS EN EL MERCADO LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA VARÍA DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ALGUNAS MARCAS MANEJAN TECNOLOGÍA SIDESTREAM Y OTRAS MAINSTREAM, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA HACER LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFIA POR MEDIO DE SIDESTREAM O MAINSTREAM, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LAS CAPACIDADES DE HACER LA MEDICION PARA TODO TIPO DE PACIENTES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
62	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.32 ECG: DOS CABLES TRONCALES Y DOS CABLES DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS, DOS DE ECG DE 5 PUNTAS Y UN CABLE DE	CADA MARCA DE MONITORES EN EL MERCADO UTILIZA SI PROPIA TECNOLOGÍA, EXISTEN MARCAS QUE DESARROLLAN CABLES DE PACIENTE (LATIGUILLOS) DE 5 O 6 DERIVACIONES Y QUE MUESTRAN LA MISMA INFORMACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	LATIGUILLOS DE 10 PUNTAS POR MONITOR	PERMITA UTILIZAR CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 5 O 6 PUNTAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	
63	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 3.1. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO DE 3 MB.	ENTENDEMOS QUE LA RESOLUCIÓN DE UNA PANTALLA SE PUEDE EXPRESAR EN MEGABYTES O BIEN EN PÍXELES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE MÍNIMO 3MB O BIEN 1920 X 1200 PÍXELES O PUNTOS, YA QUE ESTE TIPO DE RESOLUCIONES SON DE ALTA CALIDAD.	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 6 DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES
64	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 16.1 ALMACENAMIENTO DE EVENTOS MANUAL Y AUTOMÁTICOS.	AL CONTAR CON UN ALMACENAMIENTO DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICO, ES POSIBLE QUE SE PRESENTEN ERRORES DE ALMACENAMIENTO, YA QUE AL TENER UNA OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO MANUAL, LA INFORMACIÓN SOLO SE GUARDARA CUANDO SE SELECCIONA DICHA OPCIÓN POR LA PARTE USUARIA Y ESTO PUEDE OCASIONAR PERDIDA DE INFORMACIÓN, POR LO CONTRARIO SI EL ALMACENAMIENTO ES DE MANERA AUTOMÁTICA, LA PARTE USUARIO NO DEBE HACER NADA, Y ASÍ, SE TIENE UNA CERTEZA QUE LA INFORMACIÓN SIEMPRE SE GUARDARA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS SEA DE FORMA MANUAL Y/O OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO CORRESPONDE EL PUNTO REFERENCIADO A SU PREGUNTA
65	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 17.1 FORMATO PDF PARA IMPRESIÓN	EXISTEN DIFERENTES MANERAS DE IMPRIMIR LOS SUCESOS MOMENTANEOS DEL PACIENTE, ENTRE ELLAS QUE EL EQUIPO GENERE UN PDF Y ENSEGUIDA IMPRIMIRLO, ACTUALMENTE EXISTEN TECNOLOGÍAS LAS CUALES PERMITEN IMPRIMIR EN TIEMPO REAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO TECNOLOGÍA LA CUAL PERMITA IMPRIMIR EN TIEMPO REAL LOS SUCESOS DEL PACIENTE SIN NECESIDAD DE GENERAR ANTERIORMENTE UN ARCHIVO PDF. ¿SE ACEPTA?	NO CORRESPONDE EL PUNTO REFERENCIADO A SU PREGUNTA
66	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 17.2 CAPACIDAD DE EXPORTAR REGISTROS EN FORMATO EXCEL O PDF A UN DISPOSITIVO USB.	LA EXPORTACIÓN DE DATOS DE UN PACIENTE EN CUALQUIER TIPO DE FORMATO, PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS COMO LOS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE, LO CUAL PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS AL TENER LA INFORMACIÓN DE ALGÚN PACIENTE EN UNA MEMORIA TIPO USB, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO CORRESPONDE EL PUNTO REFERENCIADO A SU PREGUNTA
67	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES SIETE MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS MODULARES CON PANTALLA DE 15" COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.	ENTRE MAYOR SEA EL TAMAÑO DE UNA PANTALLA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, MAYOR INFORMACIÓN SE PUEDE VISUALIZAR SIMULTÁNEAMENTE, COMO LO SON VALORES NUMÉRICOS Y CURVAS, Y DADO QUE PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITAN 8 CURVAS DE MANERA SIMULTANEA, UN MONITOR DE 12"	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		PUEDE TENER LA MISMA CANTIDAD DE CURVAS Y VALORES NUMÉRICOS. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR MONITOR MODULAR DE 12" COMO MÍNIMO SIEMPRE Y CANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR. ¿SE ACEPTA?	
68	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.18. QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS (EMIRADI) EN FORMATO DICOM, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.	LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS ES UNA TECNOLOGÍA PROPIA DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO, Y DADO QUE ESTA LICITACIÓN ES DE LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO CORRESPONDE EL PUNTO REFERENCIADO A SU PREGUNTA
69	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.21.8. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS.	UN DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 12 DERIVACIONES SE DA EN LA MAYORÍA DE LAS MARCAS, Y DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PUEDE SER CON CABLE DE 5, 6 O 10 LATIGUILLOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 12 DERIVACIONES CON UN CABLE DE PACIENTE DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
70	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.22 SPO2	¿REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA MEDIR EL SPO2 EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN?	YA SE CONTESTÓ
71	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.24.1 EN AL MENOS UN CANAL	ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE UNA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN AL MENOS DOS CANALES, YA QUE EN EL PUNTO 1.24.2, SE SOLICITA UNA MONITORIZACIÓN SIMULTANEA DE DOS TEMPERATURAS T1 Y T2. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
72	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.27.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS POR TÉCNICA MAINSTREAM, ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO.	EN LAS DIFERENTES MARCAS EN EL MERCADO LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA VARÍA DEPENDIENDO LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ALGUNAS MARCAS MANEJAN TECNOLOGÍA SIDESTREAM Y OTRAS MAINSTREAM, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA HACER LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA POR MEDIO DE SIDESTREAM O MAINSTREAM, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LAS CAPACIDADES DE HACER LA MEDICIÓN PARA TODO TIPO DE PACIENTES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
73	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 22.1 ECG: DOS CABLES TRONCALES Y DOS CABLES DE PACIENTE PARA ECG DE AL	CADA MARCA DE MONITORES EN EL MERCADO UTILIZA SI PROPIA TECNOLOGÍA, EXISTEN MARCAS QUE DESARROLLAN CABLES DE PACIENTE (LATIGUILLOS) DE 5 O 6 DERIVACIONES Y QUE MUESTRAN LA MISMA	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	MENOS TRES PUNTAS, DOS DE ECG DE 5 PUNTAS Y UN CABLE DE LATIGUILLOS DE 10 PUNTAS POR MONITOR	INFORMACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA UTILIZAR CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 5 O 6 PUNTAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	
74	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 22.2 SPO2: DOS CABLES TRONCALES Y DOS SENSORES: UNO TIPO DEDAL Y UNO MULTISITIO PARA SPO2 REUSABLES POR MONITOR SOLICITADO.	ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE ÚNICAMENTE EL SENSOR TIPO MULTISITIO, YA QUE EL SENSOR TIPO DEDAL ES USADO EN ADULTOS, Y DADO QUE LOS MONITORES SON PARA UCIN, ESTE SENSOR NO ES NECESARIO, FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
75	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES PANI: CUATRO BRAZALES NEONATAL REUSABLE, PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, INCLUIR DOS MANGUERAS DE CONEXIÓN CON CONECTORES PARA LOS BRAZALETES, POR CADA MONITOR DE SIGNOS VITALES SOLICITADO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR 4 BRAZALETES PARA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATALES O 40 BRAZALETES DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
76	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 23. 500 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO/PEDIÁTRICO.	ENTENDEMOS QUE SE REQUIEREN 500 ELECTRODOS PARA ECG NEONATALES, ¿ES CORRECTO?	SE REQUIEREN 250 NEONATALES Y 250 PEDIÁTRICOS
77	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES 25. 500 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO/PEDIÁTRICO.	ENTENDEMOS QUE SE REQUIEREN 500 ELECTRODOS PARA ECG NEONATALES, ¿ES CORRECTO?	SE REQUIEREN 250 NEONATALES Y 250 PEDIÁTRICOS
78	PARTIDA 24 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE 531.053.0372	DADO QUE NO SE PUBLICO LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE , ENTENDEMOS QUE NOS DEBEREMOS APEGAR A LA CLAVE 531.053.0372 , LA CUAL FUE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE POR TANTO DEBEREMOS APEGARNOS A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, ¿ES CORRECTO? 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE 1. DESCRIPCIÓN 1.1 GABINETE: 1.1.1 MONTAJE PARA UN VAPORIZADOR DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA, QUE PERMITE HACER EL CAMBIO DE AGENTE ANESTÉSICO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA SIN OCASIONAR FUGAS. 1.1.2 CON CUATRO CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS. 1.1.3 YUGOS PARA CILINDROS DE 02 Y N20. 1.1.4 CON AL MENOS UN CAJÓN	DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACION NUMERO UNO POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.1.5 MESA DE TRABAJO 1.1.6 DISPOSITIVO DE MONTAJE (A LA MÁQUINA) PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.1.7 CUATRO RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL 1.1.8 MANÓMETROS INTER CONSTRUÍDOS DE PRESIÓN CON DESPLIEGUE DIGITAL EN LA PANTALLA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA. CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2 VERDE, N2O- AZUL, AIRE- AMARILLO): 1.1.8.1 TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE) 1.1.8.2 DOS PARA CILINDROS (O2, N2O) 1.1.9 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 90 MIN. 1.1.10 CON ILUMINACIÓN LED PARA EL ÁREA DE TRABAJO REGULABLE EN INTENSIDAD. 1.2 VAPORIZADORES DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA. 1.2.1 SE SUMINISTRAN DOS VAPORIZADORES DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA (SEVOFLURANE Y DESFLURANE, SELECCIONABLE ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS) (INDICAR MARCA Y MODELO): 1.2.2 INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DEL AGENTE ANESTÉSICO Y EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR. 1.2.3 ADAPTADOR PARA EL LLENADO DEL VAPORIZADOR, EN CASO DE REQUERIRSE. 1.3 SUMINISTRO DE GAS FRESCO, CON HERRAMIENTAS VISUALES QUE FACILITEN EL AJUSTE ÓPTIMO DEL FLUJO DE GAS FRESCO. 1.3.1 FLUJÓMETROS ELECTRÓNICOS CON DESPLIEGUE DIGITAL PARA O2, N2O Y AIRE, CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES:(O2 VERDE, N2O- AZUL, AIRE- AMARILLO). 1.3.2 MEZCLADOR ELECTRÓNICO 1.3.3 GUARDA HIPÓXICA DE 28% 1.3.4 SUMINISTRO DE OXÍGENO DIRECTO O DUCHA DE O2. 1.4 CIRCUITO DE PACIENTE (SISTEMA DE RESPIRACIÓN): 1.4.1 UN CÁNISTER REUSABLE. 1.4.1.1 CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 700 ML, QUE PERMITA HACER EL CAMBIO DE CAL SODADA MIENTRAS EL VENTILADOR ESTA EN FUNCIONAMIENTO. 1.4.1.2 REUSABLE Y ESTERILIZABLE 1.4.1.3 CON FILTRO DE POLVO 1.4.1.4 CON SISTEMA QUE PERMITA EL CAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA SIN OCASIONAR FUGAS 1.4.2 CON TRAMPA DE AGUA, SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUÍDO.	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.4.3 SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR. 1.4.4 CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN). 1.4.5 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO O PASIVO. 1.4.6 TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX. 1.4.7 VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN ELECTRÓNICA (APL) 1.4.8 VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN 1.4.9 VÁLVULA DE CONMUTACIÓN BOLSA-VENTILADOR. 1.4.10 MANÓMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS 1.4.11 BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL. 1.5 VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUÍDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA: 1.5.1 TECLADO SENSIBLE AL TACTO TIPO LED O TECNOLOGÍA SUPERIOR. 1.5.2 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. 1.5.3 PANTALLA: 1.5.3.1 TIPO LED O TECNOLOGÍA SUPERIOR. 1.5.3.2 TAMAÑO MÍNIMO DE 15" 1.5.3.3 CONFIGURABLE POR EL USUARIO. 1.5.3.4 DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN FORMA NUMÉRICA. 1.5.3.5 DESPLIEGUE DE AL MENOS 4 CURVAS SIMULTÁNEAS. ADEMÁS DE LOS BUCLES: FLUJO/VOLUMEN Y VOLUMEN/PRESIÓN, CON ALMACENAMIENTO DE UN BUCLE. 1.5.4 MODOS DE VENTILACIÓN: 1.5.4.1 CONTROLADO POR VOLUMEN. 1.5.4.2 CONTROLADO POR PRESIÓN. 1.5.4.3 SIMV (VENTILACIÓN MANDATARIA INTERMITENTE SINCRONIZADA) CON PRESIÓN CONTROL Y PRESIÓN SOPORTE. 1.5.4.4 PRESIÓN SOPORTE 1.5.5 CONTROL Y AJUSTE DE: 1.5.5.1 VOLUMEN CORRIENTE PROGRAMABLE EN EL RANGO DE 20 A 1600 ML 1.5.5.2 PRESIÓN LÍMITE CON RANGO DE 0 A 80 CMH2O 1.5.5.3 PRESIÓN INSPIRATORIA CON RANGO DE 0 A 80 CMH2O 1.5.5.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA CON RANGO DE 4 A 100 ESPIRACIONES POR MINUTO 1.5.5.5 PEEP ELECTRÓNICO CON RANGO DE 0 A 50 CMH2O 1.5.5.6 RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA 1.5.5.7 PAUSA INSPIRATORIA. 1.5.5.8 SENSIBILIDAD POR FLUJO Y PRESIÓN.	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.5.5.9 PRESIÓN SOPORTE 1.5.6 DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR. 1.5.6.1 FRACCIÓN INSPIRADA Y ESPIRADA DE OXIGENO POR TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA 1.5.6.2 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO 1.5.6.3 VOLUMEN MINUTO INSPIRADO 1.5.6.4 PRESIÓN MEDIA 1.5.6.5 PRESIÓN PICO 1.5.6.6 PEEP 1.5.6.7 FRECUENCIA RESPIRATORIA 1.5.6.8 COMPLIANCE DINÁMICA Y ELASTANCIA DINÁMICA 1.5.7 DESPLIEGUE DE CURVAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR; CURVA DE FLUJO, PRESIÓN, VOLUMEN, FIAA, ETCO2 Y ETCO2 1.5.7.1 DESPLIEGUE DE CURVA DE FLUJO 1.5.7.2 DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN/VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO 1.5.8 SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR O MONITOR DE SIGNOS VITALES). 1.5.8.1 FIO2 ALTA Y FIO2 BAJA 1.5.8.2 VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO 1.5.8.3 PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS Y PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS BAJA. 1.5.8.4 APNEA 1.5.8.5 PRESIÓN BAJA DE SUMINISTRO DE GAS 1.5.8.6 FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO 1.5.8.7 FALLA EN LA MEDICIÓN PARA TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA 1.5.8.8 FUGA EN CIRCUITO DE PACIENTE 1.5.8.9 FALLA EN SENSOR DE PRESIÓN 1.5.8.10 FALLA EN SENSOR DE FLUJO 1.5.9 CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL. 1.5.10 COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O COMPENSACIÓN DE LA DISTENSIBILIDAD. 1.5.11 INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC. 1.5.12 INDICADOR DE BATERÍA BAJA 1.6 SISTEMA DE COMPROBACIÓN QUE VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA, QUE DESCARGA LOS DIARIOS ASÍ COMO LAS CAPTURAS DE PANTALLA POR MEDIO DE PUERTO USB, PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS. 1.7 MONITOR DE SIGNOS VITALES (INDICAR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)	
--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.7.1 MONITOR MODULAR (INDICAR MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO DE CADA MÓDULO) 1.7.2 ACCESO A FUNCIONES Y MENPUS A TRAVÉS DE: PANTALLA SENSIBLE AL TACTO Y BOTONES DE MEMBRANA. 1.7.3 PANTALLA POLICROMÁTICA DE TECNOLOGÍA TFT COLOR TIPO LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR, DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO. 1.7.4 SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILADOR. 1.7.5 DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS, DE AL MENOS 12 CURVAS SIMULTÁNEAS 1.7.6 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL 1.7.7 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, DE MÍNIMO 24 HORAS. 1.7.8 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 90 MIN COMO MÍNIMO. 1.7.9 MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DESPLEGADOS EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES O EN EL VENTILADOR. 1.7.9.1 ECG 1.7.9.1.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA. 1.7.9.1.2 12 DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1.7.9.1.3 DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE OCHO CURVAS A ELEGIR DE 12 DERIVACIONES DE ECG. 1.7.9.1.4 ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES. 1.7.9.1.5 ANÁLISIS DE ARRITMIAS. 1.7.9.1.6 CONTROL DE ACTIVACIÓN DE FILTROS EN LA SEÑAL. 1.7.9.1.7 DETECCIÓN DE MARCAPASOS 1.7.9.1.8 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR 1.7.9.2 CO2. 1.7.9.2.1 POR MEDIO DE SIDESTREAM O MAINSTREAM. 1.7.9.2.2 DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO. 1.7.9.3 SPO2: CON MEDICIÓN EN PULSOS DÉBILES Y EN PACIENTES EN MOVIMIENTO. 1.7.9.3.1 CURVA DE PLETISMOGRAFÍA. 1.7.9.3.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. 1.7.9.4 TEMPERATURA EN MÍNIMO DOS CANALES, CON CRECIMIENTO A FUTURO DE CUATRO O MÁS CANALES DE TEMPERATURA. 1.7.9.4.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA. 1.7.9.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA.	
--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.7.9.5.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA) 1.7.9.5.2 AJUSTE AUTOMÁTICA DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. 1.7.9.5.3 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO Y CUANDO EL MONITOR DETECTE ALGÚN CAMBIO HEMODINÁMICO. 1.7.9.6 RESPIRACIÓN 1.7.9.6.1 CURVA DE RESPIRACIÓN 1.7.9.6.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA. 1.7.9.7 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. 1.7.9.7.1 DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA. 1.7.9.7.2 ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS TRANSDUCTORES. 1.7.9.7.3 AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALAS. 1.7.9.8 GASES: 1.7.9.8.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO. 1.7.9.8.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO. 1.7.9.8.3 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS. 1.7.9.8.4 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO. 1.7.9.8.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA (MAC) MAC Y. 1.7.9.8.6 DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTÁNEOS Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA. 1.7.10 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES, CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 1.7.10.1 FRECUENCIA CARDIACA. 1.7.10.2 CO2. 1.7.10.3 SATURACIÓN DE OXÍGENO. 1.7.10.4 TEMPERATURA. 1.7.10.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). 1.7.10.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA. 1.7.10.7 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. 1.7.10.8 AGENTES ANESTÉSICOS. 1.7.11 ALARMA DE APNEA. 1.7.12 ALARMA DE ARRITMIA. 1.7.13 CON SILENCIADOR DE ALARMAS. 1.7.14 MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR. 1.7.14.1 MODOS DE ESTIMULACIÓN: TREN DE CUATRO, TETÁNICO Y ESTÍMULO ÚNICO O SIMPLE.	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	2 ACCESORIOS 2.1 UNA (1) MANGUERA DE SUMINISTRO POR CADA GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2: VERDE, N2O: ZUL, AIRE-AMARILLO) CON: 2.1.1 CONECTOR PARA TOMA MURAL DE INSTALACIÓN DE CADA UNIDAD MÉDICA. 2.1.2 REGULADOR DE PRESIÓN EXTERNO PARA O2 Y AIRE. 2.1.3 UNA (1) TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA MURAL DE AIRE (MANGUERA COLOR AMARILLO). LA TRAMPA DE AGUA SE OFERTA EN CONJUNTO CON EL REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE. 2.2 DOS (2) CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLE Y ESTERILIZABLE. 2.3 UN (1) CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL REUSABLE Y ESTERILIZABLE. 2.4 UN (1) CIRCUITO DE REINHALACIÓN PARCIAL TIPO BAIN SEMICERRADO O EQUIVALENTE, REUSABLE Y ESTERILIZABLE. 2.5 BOLSAS PARA VENTILACIÓN REUSABLES, ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX, CON CAPACIDAD DE: 2.5.1 UNA (1) BOLSA DE UN LITRO +/- 10% 2.5.2 UNA (1) BOLSA DE DOS LITROS +/- 10% 2.5.3 UNA (1) BOLSA DE TRES LITROS +/- 10% 2.5.4 UNA (1) BOLSA DE 500 ML PARA PACIENTES NEONATALES. 2.6 PARA SPO2: 2.6.1 UN (1) CABLE TRONCAL REUSABLE. 2.6.2 UN (1) SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE. 2.6.3 UN (1) SENSOR MULTISITIO REUSABLE. 2.7 PARA TEMPERATURA: 2.7.1 UN (1) SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O DE SUPERFICIE). 2.7.2 UN (1) SENSOR DE TEMPERATURA RECTAL (CATÉTER), REUSABLE. 2.8 PARA PRESIÓN NO INVASIVA: 2.8.1 UNA (1) MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. 2.8.2 BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INVASIVA, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: 2.8.2.1 UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE ADULTO. 2.8.2.2 UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE BARIÁTRICO. 2.8.2.3 UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. 2.9 PARA ECG 2.9.1 UN (1) CABLE TRONCAL Y DE PACIENTE PARA ECG DE SEIS PUNTAS REUSABLE.	
--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	2.9.2 PARA PACIENTE NEONATAL UN (1) CABLE TRONCAL Y DE PACIENTE ECG DE TRES PUNTAS, REUSABLE. 2.10 PARA CO2, DEPENDIENDO DE LA TÉCNICA OFERTADA (SIDESTREAM). 2.10.1 PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: 2.10.1.1 UN (1) SENSOR REUSABLE Y CABLE. 2.10.1.2 UN (1) ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE O VEINTE (20) ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES. 2.10.2 PARA CO2 POR TÉCNICA SIDESTREAM: 2.10.2.1 DIEZ (10) TRAMPAS DE AGUA (EN CASO DE REQUERIRSE) 2.10.2.2 VEINTE (20) LÍNEAS DE MUESTREO Y ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS. 2.10.3 PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM. 2.10.3.1 VEINTE (20) LÍNEAS DE MUESTREO Y ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS. 2.11 PARA PRESIÓN INVASIVA, DOS (2) CABLES TRONCALES PARA EL TRANSDUCTOR. 2.12 PARA LA MONITORIACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR: TRANSDUCTOR PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO. 2.13 SENSOR DE FLUJO INTEGRADO. 3 CONSUMIBLES 3.1 ELECTRODOS PARA ECG, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: 3.1.1 CIEN (100) ELECTRODOS PARA PACIENTE ADULTO. 3.1.1.2 CIEN (100) ELECTRODOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. 3.1.1.3 CIEN (100) ELECTRODOS PARA PACIENTE NEONATAL. 3.2 UNA (1) MANGUERA DE CONEXIÓN REUSABLE Y VEINTE (20) BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATAL, EN DOS MEDIDAS DIFERENTES. 3.3 MASCARILLAS TRANSPARENTES CON SELLO LIBRE DE FUGAS, LIBRES DE LÁTEX, DESECHABLES DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: 3.3.1 VEINTE (20) MASCARILLAS PARA PACIENTE ADULTO. 3.3.2 VEINTE (20) MASCARILLAS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. 3.3.3 VEINTE (20) MASCARILLAS PARA PACIENTE NEONATAL. 3.4 CINCUENTA (50) ELECTRODOS PARA ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR. 3.6 DIEZ (10) KITS DE TRANSDUCTOR PARA PRESIÓN INVASIVA, DESECHABLES. 3.7 UN (1) FILTRO PARA SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES, EN CASO DE	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		OFERTAR TECNOLOGÍA DE EVACUACIÓN PASIVO. 4 REFACCIONES 4.1 NO REQUIERE 5 INSTALACIÓN 5.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 110 V +/- 10%, 60 HZ 5.2 NEUMÁTICA: AIRE, OXÍGENO Y N2O	
79	PARTIDA 25 531.562.1010. LAMPARA QUIRURGICA DOBLE LED	DADO QUE NO SE PUBLICO LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA LAMPARA QUIRURGICA DOBLE LED , ENTENDEMOS QUE NOS DEBEREMOS APEGAR A LA CLAVE 531.941.0279 , LA CUAL FUE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE POR TANTO DEBEREMOS PAGARNOS A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, ¿ES CORRECTO? 531.562.1010. LAMPARA QUIRURGICA DOBLE LED 1.1.- LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED 1.2.- MONTAJE: 1.2.1.- LAMPARA CON ANCLAJE A TECHO. 1.3.-DOS BRAZOS PORTA LÁMPARA CADA UNO CON: 1.3.1.- GIRO ROTATORIO DE 360° 1.3.2.- AJUSTE VERTICAL DE BRAZO RESORTE DE 45°A -50° 1.3.3.- BRAZO ARTICULADO DE DOBLE ARCO. 1.4.- INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS CON LOS SISTEMAS DE TECHO DE FLUJO LAMINAR. 1.4.1.- SIN SOMBRAS CON DILUCIÓN DE LAS SOMBRAS EN PRESENCIA DE 2 MÁSCARAS Y UN TUBO. 1.4.2.- FUENTE DE LUZ: 1.4.2.1.- LUZ LED BLANCO 1.4.2.2.- ENSAMBLADO DE ACERO Y/O ALUMINIO. 1.4.2.3.- VIDA ÚTIL DEL LED DE HASTA 60,000 HORAS COMO MÍNIMO. 1.4.3.- TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE ENTRE 4200 °K A 5500 °K 1.4.4.- ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO DE 95% 1.4.5.- TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO: 1.4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 20 - 25CM EN 5 NIVELES DESDE LA CÚPULA 1.4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 100 CM AL 20% EN AMBOS MODELOS DE CÚPULA 1.4.6.- RADIANCIA < 500 W/M2 EN MODO ESTÁNDAR 1.4.7.- ILUMINACIÓN NOMINAL HOMOGÉNEA (EC) DE 130,000 LX A 1 METRO DE DISTANCIA MEDIANTE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN QUE PROPORCIONA UNA ILUMINACIÓN CONSTANTE DURANTE TODO EL	DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACION NUMERO UNO POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		PROCEDIMIENTO, CON AJUSTE TÁCTIL EN CÚPULA DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN EN 5 NIVELES DEL 10% AL 100% DE LA ILUMINACIÓN NOMINAL, CON MODO BOOST DE 160,000 LX Y CON ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN COLOR VERDE DE 500 LUXES DESDE LA CÚPULA 1.4.7.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. 1.4.8.- MANGO: 1.4.8.1.- DESMONTABLE. 1.4.8.2.- EMPUÑADURA ESTERILIZABLE 1.4.8.3.- EMPUÑADURA HECHA DE MATERIAL POROSO 1.4.8.4.- EMPUÑADURA DE ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE 1.4.8.5.- CON EL AJUSTE DEL DIÁMETRO DE CAMPO DESDE EL MANERA DE LA CÚPULA. 1.4.9.- TECLADO DE CONTROL EN LA CÚPULA PARA ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO DE ZOOM PARA CÁMARA, DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA, AJUSTE DEL DIÁMETRO DE LA ILUMINACIÓN Y ENCENDIDO Y APAGADO DE LUZ AMBIENTAL. 1.4.9.1.- ENCENDIDO. 1.4.9.2.- APAGADO. 1.4.9.3.- AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA. 1.4.9.4.- CONMUTACIÓN A ILUMINACIÓN AMBIENTAL PARA CIRUGÍAS DE MÍNIMA INVASIÓN. 1.4.9.5.- CON ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN COLOR VERDE DE 500 LUXES DESDE LA CÚPULA 1.4.10.- DISEÑO DE SUPERFICIES LISAS, LA PINTURA UTILIZADA REDUCE LA ADHESIÓN DE LAS BACTERIAS Y FACILITA LA LIMPIEZA MANUAL 1.4.11.- COLOCACIÓN DE LAS LÁMPARAS EN UN DIFERENTE PUNTO PARA CREAR UNA LUZ MAS INTENSA, SIMULANDO UN SOLO SATÉLITE. 1.5.- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS BATERÍAS DE RESPALDO CON AUTONOMÍA DE HASTA 3H Y TIEMPO DE CARGA DE 14 HORAS AL 100% 2.- ACCESORIOS: 2.1.- PANTALLA DE CONTROL CÚPULA MURAL CON POSIBILIDAD DE SINCRONIZACIÓN DE LAS CÚPULAS 2.2.- 5 MANGOS ESTERILIZABLES 3.- CONSUMIBLES: 3.1.- NO REQUIERE 4.- REFACCIONES: 4.1.- SEGÚN MARCA Y MODELO. 5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 5.1- VOLTAJE ELÉCTRICO: 100-240V AC, 60HZ 5.2.- LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DEBERÁ DE REALIZARSE EN CADA UNIDAD MÉDICA POR	
--	--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		PERSONAL CAPACITADO POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. 5.3.- CONTEMPLAR TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE ADECUADAMENTE EN LOS RANGOS QUE INDICA FÁBRICA. 6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE: 6.1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR POR EQUIPO, MANUAL DE OPERACIÓN DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. EN CASO DE QUE EL MANUAL SE ENCUENTRE EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁ ENTREGAR MANUAL ORIGINAL JUNTO CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DEL MANUAL. 6.2.- EL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DEBERÁ DE ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL.	
80	PARTIDA 26 531.941.0279. VENTILADOR DE TRaslado, PEDIÁTRICO ADULTO	DADO QUE NO SE PUBLICO LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE, ENTENDEMOS QUE NOS DEBEREMOS APEGAR A LA CLAVE 531.053.0372, LA CUAL FUE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE POR TANTO DEBEREMOS PAGARNOS A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, ¿ES CORRECTO? 531.941.0279. VENTILADOR DE TRASLADO, PEDIÁTRICO – ADULTO 1 DESCRIPCIÓN: 1.1 VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO. 1.2 PANTALLA INTEGRADA: 1.2.1 TIPO LCD-TFT, SENSIBLE AL TACTO. 1.2.2 A COLOR 1.2.3 TAMAÑO DE 12." COMO MÍNIMO. 1.2.4 CONFIGURABLE POR EL USUARIO. 1.2.5 PANTALLA, LA CUAL DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA VERTICAL DE GOTAS DE AGUA (AGUA GOTEANDO) O NEBULIZADA, DESDE CUALQUIER PUNTO Y DE FÁCIL LIMPIEZA, CON CERTIFICACIÓN IP21. 1.2.6 CON BLOQUEO DE PANTALLA PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN. 1.3 CONTROLES Y AJUSTES DE: 1.3.1 VOLUMEN CORRIENTE (ML). 1.3.1.1 LÍMITE INFERIOR: 2 O MENOR. 1.3.1.2 LÍMITE SUPERIOR: 2000 O EN MODO UNIVERSAL 4000 O MAYOR. 1.3.2 FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN) 1.3.2.1 LÍMITE INFERIOR: 0. 1.3.2.2 LÍMITE SUPERIOR: 190 L/M. O MAYOR 1.3.3 PRESIÓN CONTROL SOBRE PEEP O PRESIÓN INSPIRATORIA (CMH2O) 1.3.3.1 LÍMITE INFERIOR: 0. 1.3.3.2 LÍMITE SUPERIOR: 120 O MAYOR. 1.3.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM): 1.3.4.1 LÍMITE INFERIOR: 1 O MENOR.	DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACION NUMERO UNO POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.3.4.2 LÍMITE SUPERIOR: 160 O MAYOR. 1.3.5 TIEMPO INSPIRATORIO (S): 1.3.5.1 LÍMITE INFERIOR: 0.1 SEGUNDOS O MENOR. 1.3.5.2 LÍMITE SUPERIOR: 5 SEGUNDOS O MAYOR. 1.3.6 CON PAUSA INSPIRATORIA (PPAUSA). 1.3.7 CON PROLONGACIÓN ESPIRATORIA DE 30 SEG. 1.3.8 CONCENTRACIÓN DE O2 O FIO2 (%): 1.3.8.1 LÍMITE INFERIOR: 21. 1.3.8.2 LÍMITE SUPERIOR: 100. 1.3.9 RESPIRACIÓN MANUAL. 1.3.10 PEEP/CPAP (CM-H2O) 1.3.10.1 LÍMITE INFERIOR: 0. 1.3.10.2 LÍMITE SUPERIOR: 50 O MAYOR 1.3.11 PRESIÓN SOPORTE SOBRE PEEP, PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O): 1.3.11.1 LÍMITE INFERIOR: 0. 1.3.11.2 LÍMITE SUPERIOR: 120 O MAYOR 1.3.12 SALIDA PARA NEBULIZADOR CON TECNOLOGÍA DE TÁMIZ VIBRATORIO CON CONTROL DE TIEMPO DE NEBULIZACIÓN DESDE LA PANTALLA DEL VENTILADOR. 1.3.13 MECANISMO TRIGGER POR FLUJO Y POR PRESIÓN. 1.3.14 FIN DE LA INSPIRACIÓN 1.3.15 FLUJO BASE. 1.3.16 AJUSTE DE RETARDO INSPIRATORIO. 1.3.17 FUNCIÓN DE 100% DE O2 DURANTE 2 MINUTOS. 1.4 MODOS VENTILATORIOS: 1.4.1 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. 1.4.2 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. 1.4.2.1 VENTILACIÓN MANDATARIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE Y VOLUMEN CONTROL. 1.4.3 PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. 1.4.4 CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. 1.4.5 RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO POR VOLUMEN O PRESIÓN. 1.4.6 VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA LOS DOS TIPOS DE PACIENTE (ADULTO Y PEDIÁTRICO). 1.4.7 VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA EN ASISTO/CONTROL Y SIMV (VOLUMEN GARANTIZADO, AUTOFLOW, PRVC, VENTILACIÓN DE VOLUMEN PLUS. APV O VSYNC) 1.4.8 RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BILEVEL, BIFÁSICO O DUOPAP O BI-VENT O BIPAP) Y VENTILACIÓN	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). 1.4.9 VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) PC Y PS. 1.5 PARÁMETROS MONITORIZADOS: 1.5.1 PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. 1.5.2 PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. 1.5.3 PRESIÓN PAUSA, MESETA O PLATEAU. 1.5.4 PEEP. 1.5.5 FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA. 1.5.6 VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTÁNEA. 1.5.7 TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. 1.5.8 RELACIÓN L:E. 1.5.9 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. 1.5.10 CONCENTRACIÓN DE O2 O FIO2. 1.5.11 INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. 1.5.12 INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. 1.5.13 CÁLCULO DE COMPLIANCE. 1.5.14 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. 1.5.15 CÁLCULO DE ÍNDICE DE RESPIRACIÓN POCO PROFUNDA. 1.5.16 CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL) 1.5.17 CÁLCULO DEL TRABAJO RESPIRATORIO. 1.5.18 DESPLIEGUE DE AL MENOS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: 1.5.18.1 VOLUMEN-TIEMPO. 1.5.18.2 FLUJO-TIEMPO 1.5.18.3 PRESIÓN-TIEMPO. 1.5.19 DESPLIEGUE DE 2 LAZOS. 1.5.20 CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE 24 HORAS. 1.5.21 PORCENTAJE DE FUGAS. 1.5.22 CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1. 1.5.23 MEDICIÓN DE PEEPTOTAL. 1.6 ALARMAS: 1.6.1 VISIBLES Y AUDIBLES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. 1.6.2 PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y/O BAJA. 1.6.3 PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. 1.6.4 APNEA. 1.6.5 VOLUMEN MINUTO ALTO Y VOLUMEN MINUTO BAJO. 1.6.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. 1.6.7 FIO2 ALTA Y FIO2 BAJA. 1.6.8 BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. 1.6.9 FÁLLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 1.6.10 BAJO NIVEL DE BATERÍA. 1.6.11 VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR.	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.6.12 SILENCIO DE ALARMA. 1.6.13 PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE ALARMAS. 1.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1.7.1 MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO 1.7.2 MONITOREO DE FIO2 INTERNO O INTEGRADO. 1.7.3 SENSOR DE FLUJO REUSABLE ULTRASÓNICO INTEGRADO AL EQUIPO, LIBRE DE CAMBIO. 1.7.4 CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS QUE ASEGURE LA COMPENSACIÓN MÍNIMO AL 80% O SU EQUIVALENTE EN LITROS DEL VOLUMEN DE FUGA DURANTE LA VENTILACIÓN DEL PACIENTE. 1.7.5 BATERÍA DE RESPALDO, CON DURACIÓN DE RESPALDO DE 120 MINUTOS EN TOTAL COMO MÍNIMO. 1.7.6 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120 V+/-10%, PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO DUAL, CON SENSOR DE TEMPERATURA DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR QUE FUNCIONE PARA LOS DOS TIPOS DE PACIENTE (ADULTO Y PEDIÁTRICO), CON: 1.7.6.1 CON CARÁTULA DIGITAL QUE CONTINUAMENTE MUESTRA, EN LA MISMA PANTALLA, LAS TEMPERATURAS DEL GAS Y DE LA CÁMARA. 1.7.6.2 CON SELECCIÓN PARA SER UTILIZADO CON O SIN CIRCUITOS ALAMBRADOS. CABLE CALEFACTOR DE UNO O DOS RAMAS Y LO HACE DE FORMA AUTOMÁTICA. 1.7.6.3 CONTROL SEPARADO DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA. 1.7.6.4 CON ALARMA DE FALLO. 1.7.6.5 CON SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS PARA FUNCIONAR CON EL HUMIDIFICADOR. 1.7.6.6 COMPATIBLE CON EL VENTILADOR OFERTADO Y CON CIRCUITOS DE PACIENTE UNIVERSALES. 1.7.7 TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. 1.7.8 SISTEMA DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. 1.7.9 SUMINISTRO DE GASES DESDE TOMA MURAL. 1.7.9.1 AIRE. 1.7.9.2 OXÍGENO. 1.7.10 CON CASETE ESPIRATORIO DESMONTABLE PARA SU ESTERILIZACIÓN. 1.7.11 TIEMPO DE PAUSA INSPIRATORIA 1.7.12 CAPACIDAD DE DESPLEGAR CURVAS GRABADAS EN UN INTERVALO DE TIEMPO DE 30 SEGUNDOS, PUDIENDO EXPORTAR LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE UNA USB.	
--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		1.7.13 CON CAPACIDAD DE GUARDAR CAPTURAS DE PANTALLA, HASTA 40 CAPTURAS QUE PUEDAN SER EXPORTADAS POR MEDIO DE USB. 1.7.14 BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON FRENO EN CADA UNA DE LAS CUATRO RUEDAS. 1.7.15 CON SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO INTERNO DE AIRE POR MEDIO DE TURBINA. 2 ACCESORIOS: 2.1 DOS JUEGOS DE MANGUERAS (2 JUEGO) PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: 02: VERDE, AIRE: AMARILLO, CON CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD MÉDICA. 2.2 REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA SUMINISTRO DE GASES. 2.3 DOS (2) SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA. 2.4 UN (1) PULMÓN DE PRUEBA TAMAÑO ADULTO/PEDIÁTRICO. 2.5 UN (1) BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO DE PACIENTE. 2.6 BASE CON RUEDAS PARA MOVILIZAR EL EQUIPO, CON SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS. 2.7 UNA (1) TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA MURAL DE AIRE (MANGUERA COLOR AMARILLO). 3 CONSUMIBLES: 3.1 DIEZ (10) MASCARILLAS DESECHABLES PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, LIBRE DE LÁTEX, CON ARNÉS, PARA PACIENTE ADULTO. 3.2. DOS (2) VÁLVULAS DE EXHALACIÓN, EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA LO REQUIERA. 3.3 DIEZ (10) CIRCUITOS DE PACIENTE, DESECHABLES TAMAÑO ADULTO, CADA UNO CON TRAMPA DE AGUA Y CÁMARA PARA HUMIDIFICADOR DESECHABLES. 3.4 DIEZ (10) CIRCUITOS DE PACIENTE, DESECHABLES TAMAÑO PEDIÁTRICO, CADA UNO CON TRAMPA DE AGUA Y CÁMARA PARA HUMIDIFICADOR DESECHABLES. 4 INSTALACIÓN: 4.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 110 V +/- 10%, 60 HZ. 4.2 NEUMÁTICA: 4.2.1 OXÍGENO. 4.2.2 AIRE.	
81	PARTIDA 31 531.191.0391. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR – MARCAPASOS.	DADO QUE NO SE PUBLICO LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR – MARCAPASOS, ENTENDEMOS QUE NOS DEBEREMOS APEGAR A LA CLAVE 531.191.0391, LA CUAL FUE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE POR	DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACION NUMERO UNO POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	TANTO DEBEREMOS PAGARNOS A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, ¿ES CORRECTO? 531.191.0391. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR – MARCAPASOS. 1 DESCRIPCIÓN: 1.1 CARRO RODABLE CON SISTEMA DE FRENO QUE SOPORTE DESFIBRILADOR PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN, CARDIOVERSION Y DESFIBRILACIÓN DE ONDA BIFÁSICA CARDIOPULMONAR. 1.1.1. DE MATERIAL PLÁSTICO 1.1.2. ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS 1.1.3 DIMENSIONES: LONGITUD DE 750 MM A 970 MM, DE ANCHO 55 MM A 650 MM Y DE ALTURA ENTRE 900 MM A 1000 MM. 1.1.4 CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN. 1.1.5 CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE 12.5 CM DE DIÁMETRO 1.1.6 CON SISTEMA DE FRENADO EN DOS RUEDAS. 1.1.7 CON SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR MONITOR: 1.1.7.1 CON CAPACIDAD DE GIRO. 1.1.7.1.2 CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN. 1.1.7.1.3. CON DISPOSITIVO PARA SUJECCIÓN DEL DESFIBRILADOR. 1.1.8 SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. 1.1.9 CON CUATRO CAJONES: 1.1.9.1 2 CAJONES PEQUEÑOS Y 2 CAJONES INTERMEDIOS 1.1.9.2 SISTEMA DE SEGURIDAD: CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA. 1.1.10 CON POSTE PORTA VENOCLISIS AJUSTABLE E INTEGRADO. 1.1.11 TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO. 1.1.12 CON SISTEMA DE SUJECCIÓN PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E. 1.1.13 REANIMADOR PULMONAR (REUSABLE): 1.1.13.1 DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. 1.1.13.2 BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE Y AUTOINFLABLE. 1.1.13.2.1 TAMAÑO ADULTO: VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500 ML.	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		1.1.13.2.2 TAMAÑO PEDIÁTRICO: VOLUMEN DE LA BOLSA EN EL RANGO DE 500 A 600 ML. 1.1.13.2.3 TAMAÑO NEONATAL: VOLUMEN DE LA BOLSA DE 320 ML COMO MÁXIMO. 1.1.13.3 MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA: 1.1.13.3.1 TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, 1.1.13.3.2 ESTERILIZABLES EN VAPOR. 1.1.13.3.3 ROTACIÓN DE 360° ENTRE LA MASCARILLA Y LA VÁLVULA HACIA EL PACIENTE. 1.1.13.4 VÁLVULA DE NO RE-INHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. 1.1.13.5 VÁLVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESIÓN EN VÍAS RESPIRATORIAS A 40 +/- 5 CM DE H2O 1.1.13.6 CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. 1.1.14 EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL: 1.1.14.1 ILUMINACIÓN HALÓGENA, TIPO LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 2.5 VOLTS 1.1.14.2 MANGO: 1.1.14.2.1 HECHO DE METAL, ANTICORROSIVO 1.1.14.2.2 ACABADO ACANALADO 1.1.14.2.3 COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS 1.1.14.2.4 BATERÍA RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA O CON CARGADOR. CARGADOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO 1.1.14.3 HOJAS DE LARINGOSCOPIO: 1.1.14.3.1 DE ACERO INOXIDABLE. 1.1.14.3.2 RECTAS (MILLER) DE LA MISMA MARCA QUE EL MANDO, JUEGO DE 6 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 00, 0, 1, 2, 3 Y 4. 1.1.14.3.3 CURVAS, DE LA MISMA MARCA QUE EL MANDO, JUEGO DE 4 PIEZAS DE LOS NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4. 1.1.14.4 ESTUCHE PARA GUARDA DE MANGOS Y HOJAS. 1.1.15 TANQUE DE OXÍGENO TIPO E CON MANÓMETRO Y VÁLVULA REGULADORA. 1.1.16 DESFIBRILADOR: PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO. 1.1.16.1 CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA) 1.1.16.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA BIFÁSICA EN UN RANGO DE 2 A 270 JOULES	
--	--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.1.16.3 CAPACIDAD DE AUTO DESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 40 SEGUNDOS. 1.1.16.4 CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA. 1.1.16.5 TIEMPO DE CARGA DE HASTA 5 SEGUNDOS PARA MÁXIMA ENERGÍA. 1.1.16.6 CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA. 1.1.16.7 SISTEMA DE AUTO-TEST DEL EQUIPO. 1.1.16.8 INDICADOR DE CONTACTO DE LAS PALAS CON EL PACIENTE. 1.1.16.9 PALAS: 1.1.16.9.1 EXCITACIÓN EXTERNA 1.1.16.9.2 DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA 1.1.16.10 CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL 1.1.16.11 CON BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL 1.1.16.12 CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN CON SUPRESIÓN DE ARTEFACTOS 1.1.16.13 MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO: INTER CONSTRUÍDO USANDO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES. 1.1.16.13.1 AMPLITUD DE PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 8 MA O MENOR A 200 MA. 1.1.16.13.2 DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS. 1.1.16.13.3 FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 180 PULSOS POR MINUTO. 1.1.16.13.4 ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO). 1.1.16.13.5 DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA. 1.1.16.14 MONITOR: PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI), FRECUENCIA CARDIACA, SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (SPO2) 1.1.16.14.1 PANTALLA LCD A COLOR DE 6.5 PULGADAS. 1.1.16.14.2 CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 1.1.16.14.2.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA. 1.1.16.14.2.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. (SPO2) 1.1.16.14.2.3 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA.	
--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.1.16.14.2.4 DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFÍA 1.1.16.14.2.5 DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG 1.1.16.14.2.6 DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, Y V). 1.1.16.14.3 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA; MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO 1.1.16.14.4 DESPLIEGUE DE ENERGÍA SUMINISTRADA 1.1.16.14.5 INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE LA BATERÍA 1.1.16.15 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS) 1.1.16.16 DESPLIEGUE EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL, EN IDIOMA ESPAÑOL 1.1.16.17 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES: 1.1.16.17.1 SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN LA FRECUENCIA CARDIACA, SPO2 Y PANI 1.1.16.17.2 DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. 1.1.16.17.3 DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. 1.1.16.18 SISTEMA DE REGISTRO: 1.1.16.18.1 IMPRESIÓN INTEGRADA. 1.1.16.18.2 CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO. 1.1.16.18.3 MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. 1.1.16.19 BATERÍA: 1.1.16.19.1 RECARGABLE E INTEGRADA. 1.1.16.19.2 CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. 1.1.16.19.3 QUE PERMITA DAR AL MENOS 100 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO. 1.1.16.19.4. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 3 HORAS. 2. ACCESORIOS 2.1 PARA OXIMETRÍA DE PULSO: 2.1.1 CABLE TRONCAL 2.1.2 SENSOR REUSABLE DE DEDO ADULTO/PEDIÁTRICO 2.1.3 UN SENSOR REUSABLE MULTISITIO PARA PACIENTE NEONATAL 2.2 CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN COMPATIBLE CON EL EQUIPO. 2.3 CABLE DE PACIENTE DE 6 PUNTAS	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		2.4 BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA: 2.4.1 UN BRAZALETE ADULTO 2.4.2 UN BRAZALETE PEDIÁTRICO 2.4.3 MANGUERA Y CONECTOR PARA LOS BRAZALETES 3. CONSUMIBLES: 3.1 ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG (100 PIEZAS) 3.2 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES TRANSCUTÁNEOS PARA DESFIBRILACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y MARCAPASOS (10 PIEZAS) 3.3 GEL CONDUCTOR (5 TUBOS) 3.4 PAPEL PARA IMPRESIÓN (10 ROLLOS) 3.5 BOLSA CON 100 SELLOS DE GARANTÍA 3.6 FOCO PARA LARINGOSCOPIO	
82	PARTIDA 35 531.941.0980. VENTILADOR NEONATAL PEDIÁTRICO ADULTO	DADO QUE NO SE PUBLICO LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA VENTILADOR NEONATAL PEDIÁTRICO ADULTO, ENTENDEMOS QUE NOS DEBEREMOS APEGAR A LA CLAVE 531.941.0980, LA CUAL FUE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE POR TANTO DEBEREMOS PAGARNOS A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, ¿ES CORRECTO? 531.941.0980. VENTILADOR NEONATAL PEDIÁTRICO ADULTO 1.1. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: 1.1.1. TIPO LED, SENSIBLE AL TACTO. 1.1.2. A COLOR. 1.1.3. TAMAÑO DE 15". 1.1.4. CONFIGURABLE POR EL USUARIO. 1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1.2.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. 1.2.2. MONITOREO FIO2 INTERNO O INTEGRADO. 1.2.3. SENSOR DE FLUJO ULTRASONICO REUSABLE. 1.2.4. COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES. 1.2.5. O CON LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE PARA HACER EL AJUSTE Y LA COMPENSACIÓN DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. 1.2.6. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. 1.2.7. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR. 1.2.8. PERILLA SELECTORA Y PANTALLA SENSIBLE AL TACTO PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL.	DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACION NUMERO UNO POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.2.9. CON AL MENOS UN CONECTOR USB Y UN CONECTOR ETHERNET. 1.2.10. TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS Y QUE PERMITA ALMACENAR DATOS EN FORMA DE CAPTURAS DE PANTALLA, GRABACIONES, ASÍ COMO ARCHIVOS QUE INCLUYAN DIARIOS DE EVENTOS Y TENDENCIAS. 1.3. CONTROL DE PARÁMETROS DE: 1.3.1. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 2000 ML COMO MÍNIMO. 1.3.2. FLUJO INSPIRATORIO QUE CUBRE EL RANGO DE 0 A 119 L/MIN. 1.3.3. PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRE EL RANGO DE 0 CMH2O A 200 CMH2O. 1.3.4. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRE EL RANGO DE 4 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. 1.3.5. TIEMPO INSPIRATORIO CON RANGO DE 0.1 A 5 SEGUNDOS. 1.3.6. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. 1.3.7. PEEP/CPAP CON RANGO DE 0 A 50 CMH2O. 1.3.8. PRESIÓN SOPORTE (PSV) CON RANGO DE 0 A 118 CMH2O. 1.3.9. CON OPCIÓN MESETA INSPIRATORIA, DE PLATEAU O PAUSA INSPIRATORIA. 1.3.10. CON OPCIÓN DE PAUSA O PROLONGACIÓN ESPIRATORIA DE AL MENOS 30 SEGUNDOS 1.3.11. RESPIRACIÓN MANUAL. 1.3.12. SALIDA PARA NEBULIZADOR CON TECNOLOGÍA DE TÁMIZ VIBRATORIO, CON CONTROL EN PANTALLA DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO. 1.3.13. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y PRESIÓN. 1.3.14. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O PPAUSA. 1.3.15. BIAS FLOW, FLUJO BASE. 1.3.16. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN. 1.3.17. 100% DE O2 DURANTE 2 MINUTOS. 1.4. MODOS VENTILATORIOS: 1.4.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. 1.4.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. 1.4.3. PRESIÓN SOPORTE (PSV). 1.4.4. CPAP. 1.4.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN. 1.4.6. VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA EN ASISTO/CONTROL Y SIMV (PRVC).	
--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.4.7. VENTILACIÓN NO INVASIVA. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BILEVEL, BIFÁSICO O DUOPAP O BI-VENT O BIPAP) Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). 1.4.8. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS, CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN. 1.4.9. VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACIÓN: ASISTO-CONTROL, SIMV Y VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE. 1.5. PARÁMETROS MONITORIZADOS: 1.5.1. PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. 1.5.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. 1.5.3. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU. 1.5.4. PEEP. 1.5.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA. 1.5.6. VOLUMEN MINUTO. 1.5.7. RELACIÓN I:E. 1.5.8. VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. 1.5.9. FIO2. 1.5.10. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. 1.5.11. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. 1.5.12. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. 1.5.13. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. 1.5.14. CÁLCULO DE ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL 1.5.15. CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL). 1.5.16. CÁLCULO DEL TRABAJO RESPIRATORIO O PRESIÓN TRAQUEAL. 1.5.17. DESPLIEGUE DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: 1.5.17.1. VOLUMEN-TIEMPO. 1.5.17.2. FLUJO-TIEMPO. 1.5.17.3. PRESIÓN-TIEMPO. 1.5.18. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 LAZOS O LOOPS. 1.5.19. CON CRECIMIENTO A HERRAMIENTA QUE PROPORCIONE UNA PRESENTACIÓN RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN DE LOS VALORES VENTILATORIOS MEDIDOS, LA MECÁNICA PULMONAR Y EL INTERCAMBIO DE GASES QUE FACILITE MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO PULMONAR O EVALUAR OTRAS INTERVENCIONES RESPIRATORIAS 1.5.20. DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN EDI. 1.5.21. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS	
--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS DE 72 HORAS." 1.5.22. CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 1.5.23. MEDICIÓN DE AUTOPEEP O PEEPTOTAL. 1.5.24. CAPACIDAD A FUTURO DE MONITORIZAR CO2 Y SUS VALORES NUMÉRICOS EN PANTALLA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE 1.6. ALARMAS: 1.6.1. AUDIBLES Y VISUALES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. 1.6.2. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. 1.6.3. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. 1.6.4. APNEA. 1.6.5. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). 1.6.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. 1.6.7. FIO2 ALTA Y BAJA. 1.6.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. 1.6.9. BATERÍA BAJA. 1.6.10. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 1.6.11. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. 1.6.12. SILENCIO DE ALARMA. 2. ACCESORIOS: 2.1. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO DE PACIENTE. 2.2. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO DE LA MISMA MARCA QUE EL VENTILADOR, CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. 2.3. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA MARCA), CON 60 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO. 2.4. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE, AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE. 2.5. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. 2.6. TRES CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). 2.7. TRES MASCARILLAS REUSABLES LIBRES DE LÁTEX DE TAMAÑOS GRANDE, MEDIANO Y CHICO, UNA DE CADA TAMAÑO. 2.8. CON ARNÉS O SUJETADOR. 2.9. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES ADULTO/PEDIÁTRICA. 2.10. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES NEONATALES.	
--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		2.11. PULMÓN DE PRUEBA ADULTO/PEDIÁTRICO. PULMÓN DE PRUEBA NEONATAL. 2.12. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). 3. CONSUMIBLES: 3.1. DIEZ CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). 3.2. DIEZ CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). 3.3. CELDA O SENSOR DE OXÍGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. 3.4. DOS SENSORES DE TEMPERATURA. 3.5. 100 FILTROS DE BACTERIAS DESECHABLE. 4.- REFACCIONES: 4.1.- SEGÚN MARCA Y MODELO 5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 5.1.-LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DEBERÁ DE REALIZARSE EN CADA UNIDAD MÉDICA POR PERSONAL CAPACITADO POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, CONTEMPLANDO TODO EL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS. 5.2.- CORRIENTE ELÉCTRICA: 120 V +/- 10%, 60HZ. 6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE: 6.1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR POR EQUIPO, MANUAL DE OPERACIÓN DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. EN CASO DE QUE EL MANUAL SE ENCUENTRE EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁ ENTREGAR MANUAL ORIGINAL JUNTO CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DEL MANUAL. 6.2.- EL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DEBERÁ DE ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL.	
83	PARTIDA 41 531.572.0507. ULTRASÓNICA LAVADORA	DADO QUE NO SE PUBLICO LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA LAVADORA ULTRASÓNICA, ENTENDEMOS QUE NOS DEBEREMOS APEGAR A LA CLAVE 531.572.0507, LA CUAL FUE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE POR TANTO DEBEREMOS PAGARNOS A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, ¿ES CORRECTO? 531.572.0507. LAVADORA ULTRASÓNICA 1.- DESCRIPCIÓN: 1.1.- CON SELECTOR DE TIEMPO. 1.2.- FASE QUE ELIMINE EL OXIGENO DISUELTO EN LA SOLUCIÓN.	DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACION NUMERO UNO POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	1.3.- CON CONTROL GIRATORIO DE TIEMPO Y TEMPERATURA. 1.4.- CON DESPLIEGUE DE TIEMPOS Y TEMPERATURA. 1.5.- TIPO SOBREMESA. 1.6.- TINA DE ACERO INOXIDABLE. 1.7.- CANASTILLA COMPATIBLE CON LAS DIMENSIONES DE LA TINA. 1.8.- CON FUNCIÓN PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO SONORO EN EL LÍQUIDO LIMPIADOR.. 1.9.- GABINETE DE ACERO INOXIDABLE. 1.10.- LLENADO MANUAL. 1.11.- CON SALIDA A DRENAJE. 1.12.- CON CAPACIDAD DE AL MENOS 28 L. 1.13.- TRANSDUCTOR DE AL MENOS 37 KHZ. 1.14.- DIMENSIONES DE: 568 MM X 340 MM X 321 MM +/- 5 % 1.15.- PESO NO MAYOR A 11 KG 2.-ACCESORIOS: 2.1.- CANASTILLA DE MALLA. 3.- CONSUMIBLES: 3.1.- DETERGENTES ENZIMÁTICOS BAJOS EN ESPUMA.DESINFECTORAS. 4.- REFACCIONES: 4.1.- SEGÚN MARCA Y MODELO. 5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 5.1.- CORRIENTE ELÉCTRICA: 120 Ó 220 V / 60 HZ. 5.2.-LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DEBERÁ DE REALIZARSE EN CADA UNIDAD MÉDICA POR PERSONAL CAPACITADO POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. 5.3.- CONTEMPLAR TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE ADECUADAMENTE EN LOS RANGOS QUE INDICA FÁBRICA. 5.4. INSTALACIÓN DE AGUA Y DRENAJE. 6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE: 6.1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR POR EQUIPO, MANUAL DE OPERACIÓN DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. EN CASO DE QUE EL MANUAL SE ENCUENTRE EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁ ENTREGAR MANUAL ORIGINAL JUNTO CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DEL MANUAL. 6.2.- EL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DEBERÁ DE ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

5. - MAQUET MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1. INFORMACION GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL CARÁCTER CON EL CUAL ESTA CONVOCADA ESTA LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO TRATADOS O INTERNACIONAL ABIERTA	CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES DE CARÁCTER INTERNACIONAL EN EL QUE PUEDEN PARTICIPAR TANTO PROVEEDORES NACIONALES COMO EXTRANJEROS Y LOS BIENES A ADQUIRIR SEAN DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

2	ANEXO 1.8. PRESCRIPCION DE BIENES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS PARTIDAS SOLICITADAS EN ESTE ANEXO SON LAS PARTIDAS REQUERIDAS A OFERTAR POR LOS LICITANTES EN ESTE EVENTO DE LICITACIÓN.	SE DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE SEÑALADA COMO NÚMERO 1
3	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL TIEMPOS DE ENTREGA SOLICITADO PARA TODAS LAS PARTIDAS CONVOCADAS EN ESTE EVENTO	SE DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE SEÑALADA COMO NÚMERO 2
4	4.1. MUESTRAS	PARA LA PARTIDA 39 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRAULICA. EQUIPO PESA APROXIMADAMENTE 300 KG SIN INCLUIR LOS ACCESORIOS, LO QUE SE DIFICULTAN LAS MANIOBRAS DE DESPLAZAMIENTO EN ESPACIOS IRREGULARES Y/O PEQUEÑOS. POR LO CUAL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA PRESENTACIÓN DE UN CATÁLOGO O VIDEO DONDE SE DEMUESTREN LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LA EVALUACIÓN.	SE DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE SEÑALADA COMO NÚMERO 1
5	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS FICHAS TÉCNICAS DE TODAS LAS PARTIDAS REQUERIDAS EN ESTE EVENTO.	SE DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE SEÑALADA COMO NÚMERO 1



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

6. - MOBLIFARMA, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL AREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1. ANEXO 1.8 PARTIDA 164 "GUARDA PARA DOSIS UNITARIA"	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ADJUNTE LAS ESPECIFICACIONES QUE CORRESPONDEN A EL MOBILIARIO SOLICITADO PARA GUARDA DE DOSIS UNITARIA, YA QUE TAMPOCO SE ENCUENTRA LA DESCRIPCION EN EL ARCHIVO DE GUIAS CUAJIMALPA. RAR	SE DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE SEÑALADA COMO NÚMERO 1
2	ANEXO 1.8 PARTIDA 164 "GUARDA PARA DOSIS UNITARIA"	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE EL NUMERO DE PARTIDA PARA "GUARDA PARA DOSIS UNITARIA" YA QUE EN EL ARCHIVO EXCEL EN LA HOJA DE CONCENTRADO SE IDENTIFICA CON PARTIDA 164 Y EN HOJA 2 INDICA PARTIDA SUGERIDA "90" Y TAMPOCO SE ENCUENTRA LA DESCRIPCION DEL MOBILIARIO SOLICITADO	SE DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE SEÑALADA COMO NÚMERO 1

7. - RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.3. INCISO E) Y F)	¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE, Y LA DEMAS DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER RUBRICADA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	NUMERAL 4.5. INCISO G)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SI EL IMPUESTO PREDIAL Y EL IMPUESTO DEL AGUA NO LE APLIQUEN A MI REPRESENTADA POR QUE EL INMUEBLE QUE TIENE NUESTRO DOMICILIO FISCAL NO ES DE NUESTRA PROPIEDAD TENDREMOS QUE ADJUNTAR A NUESTRA PROPUESTA SOLO EL INSTRUMENTO LEGAL VIGENTE ACREDITANDO DICHO SUPUESTO. ES CORRECTO	EN CASO DE NO APLICAR DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DEL INSTRUMENTO LEGAL <u>VIGENTE</u> A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, MEDIANTE EL QUE SE ACREDITE DICHO SUPUESTO.

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

3	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.1.	SOLICITAN MUESTRAS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, 531.341.2537 UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX, 531.341.2479, UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, 531.254.0049, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES, 531.924.0031, ULTRASONOGRAFO (FIJO), PERO NO ESTÁN LAS CEDULAS TÉCNICAS DE DICHAS PARTIDAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CEDULAS RESPECTIVA.	SE DEBERÁ ATENDER A LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE SEÑALADA COMO NÚMERO 1
4	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.1.4.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CASO DE SER TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES QUE OFERTEMOS, SERA SUFICIENTE CON ADJUNTAR EL MANIFIESTO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.7.1.4. DEL ANEXO TÉCNICO SUSCRITO POR MI REPRESENTADA, ADJUNTANDO COPIA DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN QUE NOS EXPIDE EL FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	EN CASO DE SER LOS TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO, LA CARTA DE APOYO DEBERÁ SER POR EL FABRICANTE.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

5	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.1.7.	SOLICITAN PARA ESTE PUNTO Y PODER CORROBORAR QUE LOS BIENES SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA; - CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADOS - CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, COPIA DE LAS ACTAS ENTREGA RECEPCION Y REMISIONES DE ENTREGA FIRMADAS Y SELLADAS POR LAS INSTITUCIONES DONDE SE INSTALARON EQUIPOS DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS PRESENTADOS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.7 DE LAS BASES.
6	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.1.20.	SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL OFERENTE COMO DISTRIBUIDOR PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS EXPEDIDO POR COFEPRIS, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARÁN AVISOS DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL OFERENTE CON MODALIDAD B: ALMACÉN DE DEPÓSITO Y/O DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O REMEDIOS HERBOLARIOS O MEDICAMENTOS CONTROLADOS O MATERIA PRIMA PARA MEDICAMENTOS NO CONTROLADOS. TODA VEZ QUE COFEPRIS NO EXPIDE AVISOS DE FUNCIONAMIENTO COMO DISTRIBUIDORES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y TODO SE HACE A TRAVÉS DE HOMOClaves PREDEFINIDAS CON SUS RESPECTIVAS DESCRIPCIONES O MODALIDADES. SE ACEPTA.	SE ACEPTA, CON MODALIDAD B Y/O E
7	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.1.23	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI MI REPRESENTADA NO OFERTA PARTIDAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO, NOS PERMITA PRESENTAR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 4.7.1.23, DEL ANEXO TÉCNICO NO LE APLICA A MI REPRESENTADA. SE ACEPTA.	SI EN EL ANEXO 1.4 RESUMEN DE PARTIDAS OFERTADAS, NO SE ENLISTAN PARTIDAS DE INSTRUMENTAL, POR EL LICITANTE, ENTONCES EL PUNTO 4.7.1.23 NO LE APLICA, EN EL CASO EN QUE EN EL ANEXO 1.4 SE ENLISTEN PARTIDAS DE INSTRUMENTAL, EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.23
8	ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" Y FICHAS TÉCNICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES PROPORCIONARA LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS FALTANTES Y DARA UN	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		PERIODO PARA PODER REALIZAR PREGUNTAS SOBRE DICHAS PARTIDAS. ES CORRECTO.	
9	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" PUNTO 1.1. DE ALTA FRECUENCIA DE 60 HZ Y 15 KW DE POTENCIA O MAYOR.	PARA OBTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE IMAGEN SIN IMPORTAR LAS VARIABLES DE ADQUISICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITE POTENCIA DE 20 KW. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" PUNTO 1.4. CON FLUOROSCOPIA PULSADA DE 40 MA O MAYOR.	PARA OBTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE IMAGEN SIN IMPORTAR LAS VARIABLES DE ADQUISICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 120 MA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" PUNTO 1.2. CON RADIOGRAFÍA DIGITAL DE 75 MA O MAYOR	PARA OBTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE IMAGEN SIN IMPORTAR LAS VARIABLES DE ADQUISICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA DE RADIOGRAFÍA DIGITAL DE 200 MA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" PUNTO 2.4. DISIPACIÓN DE ENFRIAMIENTO DEL ÁNODO: 70,000 HU O MAYOR.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA TASA DE ENFRIAMIENTO CONTINUO DEL ÁNODO DE 60,000 HU. SE ACEPTA.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA
13	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO (PORTÁTIL) PUNTO 7.6 DOPPLER CONTINUO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL MODO DE OPERACIÓN DOPPLER CONTINUO, SERA UTILIZADO YA QUE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE REQUIERE DE UNA LICENCIA DE CARDIO Y EL ULTRASONIDO SOLO LO ESTÁN PIDIENDO PARA APLICACIONES DE GINECO-OBSTETRICIA Y CUIDADOS INTENSIVOS. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ RESPETAR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA E INCLUIR LAS LICENCIAS QUE SE REQUIERAN.
14	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO (PORTÁTIL) PUNTO 9 CONVERTIDOR DE BARRIDO DE CANALES DE PROCESO DIGITAL DESDE LA FORMACIÓN DEL HAZ	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DEBA SOLICITAR AL MENOS 4,000,000 CANALES DE PROCESAMIENTO PARA ASEGURAR QUE SE OFERTARÁ UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE ENTREGAR IMÁGENES DE ALTA CALIDAD ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
15	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO (PORTÁTIL) PUNTO 14 INCLUIR LICENCIAS DE SOFTWARE, SIN FECHA DE CADUCIDAD EN CASO DE QUE SE REQUIERA PARA EL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO A TRAVÉS DE UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLIRÁ CON DICHO PUNTO, TODA VES QUE ES IMPOSIBLE REFERENCIARLO A TREVES DE	SE ACEPTA, PARA TODOS AQUELLOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN ESTA PARTIDA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	FUNCIONAMIENTO COMPLETO DEL EQUIPO OFERTADO.	CATÁLOGOS, FOLLETOS O MANUALES. SE ACEPTA.	
16	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO (PORTÁTIL) ACCESORIOS PUNTO 3. TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ O MENOR A 9.0 MHZ O MAYOR	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA AUMENTAR EL RANGO DE ESCaneo SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, CON EL RANGO DE 3 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, ADEMÁS PARA UN MEJOR ESTUDIO Y MENOR INCOMODIDAD AL PACIENTE QUE LA APERTURA O CAMPO DE VISIÓN SEA DE AL MENOS 200 GRADOS O MAYOR ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	PUEDO OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES

8. - DISPOSITIVOS MÉDICOS MÉXICO, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.5 INCISO G)	CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN LO CIERTO, AL SER UN LICITANTE CON DIRECCIÓN FISCAL FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO ES NECESARIO PRESENTAR LOS COMPROBANTES DE PAGO DE IMPUESTOS CITADOS EN EL NUMERAL 4.5 E INCISO G). ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	DEBERÁ PRESENTAR LOS SUPUESTOS QUE LE RESULTAN APLICABLES Y LOS QUE NO LE APLICAN, EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO, A TRAVÉS DEL ANEXO 3 Y 4.

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

2	PARTIDA 87 NUMERAL 3	CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR, SOLICITAMOS QUE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA PUEDA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: RODAJAS DE HULE NEGRO DE 50.SMM (2") CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
---	----------------------	--	---



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

9. - SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.2	2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN MANIFESTAR EL CONTENIDO DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL CON EL QUE CUENTAN LOS BIENES QUE OFERTA, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN. PREGUNTA: EN CASO DE BIENES DE IMPORTACIÓN QUE NO CUENTEN CON GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL ALGUNO, SE DEBERÁ ESTABLECER EN 0% ¿ES CORRECTO?	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA ESTE, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

2	4.1	4.1 MUESTRAS DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, CONFORME A LO SOLICITADO EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 4.1 "MUESTRAS" PREGUNTA: EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL "MUESTRAS" MENCIONA LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES ULTRASONÓGRAFO (FIJO) PERO OBSERVAMOS QUE ESTAS PARTIDAS NO SE MENCIONAN EN EL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES", POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME SI ESTAS PARTIDAS FORMARÁN PARTE DE LOS BIENES A LICITAR	DEBERÁ ATENDER A LO MANIFESTADO EN LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
---	-----	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

3	4.1	4.1 MUESTRAS DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, CONFORME A LO SOLICITADO EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 4.1 "MUESTRAS" SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, PODRIAN INDICARNOS BAJO QUÉ NÚMERO DE PARTIDA DE PARTIDA SE IDENTIFICARÁN ESTAS. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ ATENDER A LO MANIFESTADO EN LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
4	4.1	4.1 MUESTRAS DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, CONFORME A LO SOLICITADO EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 4.1 "MUESTRAS" PREGUNTA: EN EL SUPUESTO QUE LOS BIENES QUE OFERTAREMOS AUN NO CUENTAN CON UNA BASE INSTALADA EN EL PAÍS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA, PRESENTAR LA MUESTRA FÍSICA DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE ESPECIFICAR A QUE PARTIDAS SE REFIERE
5	4.1	4.1 MUESTRAS DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, CONFORME A LO SOLICITADO EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 4.1 "MUESTRAS" PREGUNTA: EN EL NUMERAL 4.1.3 EQUIPO Y MOBILIARIOS MÉDICO, SE MENCIONA LA PARTIDA MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA, SIN EMBARGO, NO OBSERVAMOS QUE ESTA PARTIDA SE MENCIONE COMO PARTE DEL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS NOS ACLARE SI ESTE EQUIPO FORMARÁ PARTE DE LOS BIENES A LICITAR Y EN SU CASO A QUE NÚMERO DE PARTIDA CORRESPONDE. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ ATENDER A LO MANIFESTADO EN LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

6	4.2	4.2 VISITAS DICE: LOS LICITANTES REALIZARÁN LAS VISITAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 4.2 "VISITAS" PREGUNTA: EN EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 4.2 "VISITAS" SE MENCIONA LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN INSTALACIONES ESPECIALES (PARTIDAS 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,25,30,36,37,41,59,115 Y 163, SIN EMBARGO EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 1, 3,4,7,21, 25, 30, 36, 37, 41 Y 163, NO SABEMOS A QUE EQUIPOS SE REFIEREN YA QUE COMO TAL ESTAS PARTIDAS NO APARECEN EN EL CUADRO DE PARTIDAS DEL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES", POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE EQUIPOS SE REFIEREN.	DEBERÁ ATENDER A LO MANIFESTADO EN LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
---	-----	---	--

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

7	4.4	4.4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS DICE: PARA UN MEJOR CONTROL Y AGILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL HECHO DE PRESENTAR LA PROPUESTA SIN FOLIAR NO SERÁ CONSIDERADO UN FACTOR DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTO?	LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA). LO SEÑALADO EN ESTE PÁRRAFO, ES CON OBJETO DE UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y NO TENDRÁ FINES DE DESCALIFICACIÓN.
---	-----	--	---



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

8	4.5 INCISO G)	4.5 INCISO G) "CONSTANCIA DE ADEUDOS" PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA "CONSTANCIA DE ADEUDOS", NO PUEDA SER EMITIDA PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE HACER LA ENTREGA DE DICHA CONSTANCIA PREVIO AL COMUNICADO DE FALLO.	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE ACUSE DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO INGRESADO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE Y PRESENTANDO LA CONSTANCIA ORIGINAL PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
---	---------------	--	--

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

9	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA PARTIDAS: 1, 3, 4, 6, 7, 23, 25, 36, 37, 39, 45, 65, 84 PREGUNTA: CON EL FIN DE DAR CLARIDAD A LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LAS FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 6, 7, 23, 25, 36, 37, 39, 45, 65, 84, LO ANTERIOR PARA REALIZAR LOS CUESTIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES EN UNA SEGUNDA RONDA DE PREGUNTAS. ¿SE ACEPTA?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
---	-------------------------	---	---

10.- DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S. A. DE C. V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.1 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PROPUESTAS. G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES 4.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. PARA EL CASO DE PROVEEDORES CUYO DOMICILIO FISCAL NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LA CDMX, PODER PRESENTAR UNA CARTA DONDE EXPLIQUEMOS PORQUE ESTE PUNTO NO NOS APLICA ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ PRESENTAR LOS SUPUESTOS QUE LE APLICAN Y LOS QUE NO LE RESULTAN APLICABLES, EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	4.3 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS. H) CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODER PRESENTAR UNA CARTA DONDE NOS COMPROMETEMOS A TENER DICHA CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ¿SE ACEPTA?	DADO QUE EL SERVICIO DE LA PLATAFORMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES SE ENCUENTRA SUSPENDIDO PODRÁ PRESENTAR ACUSE DE SU TRÁMITE PARA EL REGISTRO EN EL PADRÓN Y PARA EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE REGISTRO
3	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. A. ANEXO 3	DICE: PARA EL CASO DE QUE MI DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE DICHO ANEXO. ENTIENDO QUE SOLO DEBEREMOS PONER QUE "APLICA" AL SUPUESTO "EL DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO." Y EN TODOS LOS DEMAS SUPUESTOS PONER "NO APLICA" ¿ES CORRECTO?	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO.

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

4	NUMERAL 4.7.1.1 PROPUESTA TECNICA	DICE: LOS OFERTANTES DEBERAN PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA CONFORME AL MODELO DEL ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA" EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO AUTOGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL. ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO POR LA PARTIDA OFERTADA Y DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS 1.1. Y 1.8 NOTAMOS UNA DIFERENCIA EN LAS PARTIDAS QUE SE	DEBERÁ ATENDER A LO MANIFESTADO EN LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
---	-----------------------------------	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		ENCUENTRAN EN EL ANEXO 1.1 Y 1.8. POR LO QUE LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARÉ ¿CUALES SON LAS PARTIDAS QUE ESTAN SUJETAS A ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION?	
5	PARTIDA 8 PUNTO 20	REFERENTE A LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES, ¿SE PUEDE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE SÍ PERMITA LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES, PERO SIN LA OPCIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES?	NO SE ACEPTA
6	PARTIDA 9, PUNTO 1.19.8	RESPECTO A LA FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS, SE PUEDE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE REALICE LAS 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 10 LATIGUILLOS, ¿O 7 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS?	NO SE ACEPTA
7	PARTIDA 9, PUNTO 1.24.3	RESPECTO AL ETIQUETADO DE LAS PRESIONES INVASIVA, SE AUTORIZA LA ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CON EL ETIQUETADO ÚNICAMENTE DE PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL Y ARTERIO PULMONAR?	NO SE ACEPTA
8	PARTIDA 66, PUNTO 2	¿SE PUEDE OFERTAR OTRO MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE LA MESA PUENTE, POR EJEMPLO, MADERA?	NO SE ACEPTA
9	PARTIDA 66, PUNTO 3	¿SE PUEDE OFERTAR OTRO MATERIAL PARA LA COLUMNA, POR EJEMPLO ALEACIÓN DE ALUMINIO?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
10	PARTIDA 66 PUNTO 6	REFERENTE A LAS RODAJAS, SE ACEPTA QUE AL MENOS DOS RUEDAS SEAN DE MÍNIMO 25MM Y DOS DE 50MM?	NO SE ACEPTA
11	PARTIDA 66, PUNTO 9	REFERENTE A LAS DIMENSIONES, SE SOLICITA QUE EL AJUSTE DE ALTURA VARIABLE SEA POR PISTÓN CON UN AJUSTE DE AL MENOS	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		DE 94 A 66CM, ASÍ COMO LAS DIMENSIONES QUE SEAN MÍNIMO DE 89CM X 44CM, ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	
12	PARTIDA 114	REFERENTE AL OXÍMETRO DE PULSO, SE SOLICITA QUE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEL EQUIPO SEA AL MENOS DE 30 HORAS DE USO CONTINUO, ¿SE ACEPTA ESTA SOLICITUD?	ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA 7
13	PARTIDA 67, PUNTO 2,	REFERENTE AL MATERIAL DEL BURO, ¿SE PUEDE OFERTAR UN MATERIAL DISTINTO AL SOLICITADO?, POR EJEMPLO DE POLIPROPILENO DE FÁCIL LIMPIEZA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
14	67, PUNTO 3	REFERENTE A LA ESTRUCTURA, ¿SE PUEDE OFERTAR UNO DISTINTO AL SOLICITADO?	NO SE ACEPTA
15	PARTIDA 10, PUNTO 20	REFERENTE A LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES, ¿SE PUEDE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE SÍ PERMITA LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES, PERO SIN LA OPCIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES?	NO SE ACEPTA
16	PARTIDA 11, PUNTO 1.20.8	RESPECTO A LA FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS, SE PUEDE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE REALICE LAS 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 10 LATIGUILLOS, ¿O 7 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS?	NO SE ACEPTA
17	PARTIDA 11, PUNTO 1.24.3	RESPECTO AL ETIQUETADO DE LAS PRESIONES INVASIVA, SE AUTORIZA LA ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CON EL ETIQUETADO ÚNICAMENTE DE PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL Y ARTERIO PULMONAR?	SU PREGUNTA ESTA MAL REFERENCIADA
18	PARTIDA 12, PUNTO 20	REFERENTE A LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES, ¿SE PUEDE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE SÍ PERMITA LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES, PERO SIN LA OPCIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES?	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

19	PARTIDA 13, PUNTO 1.21.8	RESPECTO A LA FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS, SE PUEDE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE REALICE LAS 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 10 LATIGUILLOS, ¿O 7 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS?	NO SE ACEPTA
20	PARTIDA 13, PUNTO 1.26.3	RESPECTO AL ETIQUETADO DE LAS PRESIONES INVASIVA, SE AUTORIZA LA ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CON EL ETIQUETADO ÚNICAMENTE DE PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL Y ARTERIO PULMONAR?	NO SE ACEPTA
21	PARTIDA 14, PUNTO 19	REFERENTE A LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES, ¿SE PUEDE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE SÍ PERMITA LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES, PERO SIN LA OPCIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES?	SU PREGUNTA ESTA MAL REFERENCIADA
22	PARTIDA 15, PUNTO 1.19.8	RESPECTO A LA FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS, SE PUEDE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE REALICE LAS 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 10 LATIGUILLOS, ¿O 7 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS?	SU PREGUNTA ESTA MAL REFERENCIADA
23	PARTIDA 15, PUNTO 1.21.8	RESPECTO AL ETIQUETADO DE LAS PRESIONES INVASIVA, SE AUTORIZA LA ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CON EL ETIQUETADO ÚNICAMENTE DE PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL Y ARTERIO PULMONAR?	SU PREGUNTA ESTA MAL REFERENCIADA

11. - ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PUNTO 2. INFORMACIÓN DE LOS BIENES, 2.4, I, INCISO D), PAGINA 8.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PUEDA ACLARAR A QUE SOLICITUD SE REFIERE PARA LA ENTREGA DE LOS	SE SOLICITA REPLANTEAR SU PREGUNTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		BIENES Y SI SERÁ HASTA QUE SEA ADJUDICADO.	

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

2	PUNTO 4, 4.1, 4.1.1, PAG 12.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE ME PERMITA ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LAS PARTIDAS A OFERTAR.	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
3	4, NORMAS Y CERTIFICACIONES, B, X, XI, XII, PAG 20.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTOS DOCUMENTOS SOLO APLICAN PARA EQUIPO MÉDICO.	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
4	4, NORMAS Y CERTIFICACIONES, B, XII, PAG 20.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INDICAR A QUE DOCUMENTO SE REFIERE PARA LA COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN.	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
5	ANEXO 1, PARTIDA 19, PAG 36.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR ENVASE CON 5 LITROS.	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
6	ANEXO 1, PARTIDA 19, PAG 36.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO CON 5 ENZIMAS; AMILASA, CELULASA, LIPASA, MANANASA Y PROTEASA, LO CUAL NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO.	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
7	ANEXO 1, PARTIDA 236, PAG 48.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS CONFIRME SI ES CORRECTA LA CANTIDAD DE 54,324 CAJAS CON 1000 PIEZAS.	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

8	SIN NUMERAL	EN CASO DE QUE NO PUEDA ASISTIR EL REPRESENTANTE LEGAL A LOS EVENTOS DE LICITACIÓN QUE INCLUYEN, ACLARACIÓN DE BASES, ENTREGA DE OFERTAS Y FALLO.	ES CORRECTO, PERO SI DESEAN REALIZAR UN MEJORAMIENTO DE PRECIOS EN EL ACTO DE FALLO, ES NECESARIO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE CUENTE CON FACULTADES SUFICIENTES.
---	-------------	---	---



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		¿PUEDE ASISTIR OTRA PERSONA CON CARTA PODER OTORGADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL?	
9	PUNTO 4, 4.4, G) CONSTANCIAS DE ADEUDOS, PAG 14.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME SI NOS APLICA LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUA, SI MI DOMICILIO FISCAL ES DEL ESTADO DE MÉXICO Y QUE DOCUMENTO DEBO PRESENTAR.	EN CASO DE NO APLICAR DEBERÁ DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DEL INSTRUMENTO LEGAL, <u>VIGENTE</u> A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, MEDIANTE EL QUE ACREDITE DICHO SUPUESTO.
10	PUNTO 4, 4.4, G) CONSTANCIAS DE ADEUDOS, PAG 14.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA EL CASO DE LAS CONSTANCIAS DE ADEUDOS RELATIVO AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y/O PREDIAL, NUESTRO INMUEBLE ES ARRENDADO, QUE DOCUMENTO DEBO PRESENTAR.	EN CASO DE NO APLICAR DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DEL INSTRUMENTO LEGAL, <u>VIGENTE</u> A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, MEDIANTE EL QUE ACREDITE DICHO SUPUESTO.
11	PUNTO 4.4 INCISO G) "CONSTANCIA DE ADEUDOS"	AL RESPECTO ME PERMITO COMENTAR QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE MÉXICO POR LO QUE NO ESTAMOS SUJETOS DE CONTRIBUCIONES EN LA CDMX. ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE LOS IMPUESTOS APLICABLES PARA MI REPRESENTADA EN EL ESTADO DE MÉXICO SON IMPUESTOS SOBRE NÓMINA E IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. DEBO ENTENDER QUE SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR LA CONSTANCIA DE IMPUESTOS ANTES MENTIONADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. FAVOR DE ACLARAR.	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN, EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO RESULTEN APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO.
12	PUNTO 4.4 INCISO G) "CONSTANCIA DE ADEUDOS"	EN EL CASO DE LA CONSTANCIA DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL ME PERMITO COMENTAR QUE EL INMUEBLE ES ARRENDADO. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ES SUFICIENTE PRESENTAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO? FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CÉRTIFICADA PARA COTEJO DEL INSTRUMENTO LEGAL, <u>VIGENTE</u> A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, MEDIANTE EL QUE ACREDITE DICHO SUPUESTO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

13	PUNTO 4.4 INCISO G) DE "CONSTANCIA ADEUDOS"	EN EL CASO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, ME PERMITO COMENTAR QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA EN VIRTUD DE QUE NO ESTAMOS SUJETOS Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR NINGUNA CONSTANCIA. FAVOR DE ACLARAR.	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO
14	PUNTO 4.4 INCISO G) DE "CONSTANCIA ADEUDOS"	EN EL CASO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, ME PERMITO COMENTAR QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA EN VIRTUD DE QUE NO ESTAMOS SUJETOS Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR NINGUNA CONSTANCIA. FAVOR DE ACLARAR.	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO
15	PUNTO 4.4 INCISO G) DE "CONSTANCIA ADEUDOS"	EN EL CASO DEL IMPUESTO POR LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ME PERMITO COMENTAR QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA EN VIRTUD DE QUE NO ESTAMOS SUJETOS Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR NINGUNA CONSTANCIA. FAVOR DE ACLARAR.	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO
REPREGUNTAS			
1	BASES PUNTO 4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL, INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS SE DEBE PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO CUANDO MI INMUEBLE EN QUE RESIDE EL DOMICILIO FISCAL NO SEA DE SU PROPIEDAD.	DEBERÁ LLENAR EL ANEXO 3 Y 4 Y DEBERÁ PRESENTAR CONTRATO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ASI COMO COPIA SIMPLE PARA COTEJO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

12. - SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PRE G. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS. PAGINA. 11	DICE: "LOS LICITANTES" DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPUESTAS POR ESCRITO EN UN SOLO SOBRE (PAQUETE, CAJA, ETC.) CERRADO DE MANERA INVOLABLE, QUE CONTENDRÁ LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA. ENTENDEMOS QUE LA PROPUESTA SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE FOLIADA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA) EN "UN SOLO SOBRE" EN CUAL CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: ✓ DOCUMENTACIÓN DEL NUMERAL 4.5.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA (EN ORIGINAL Y COPIA ÚNICAMENTE DE LOS INICIOS ("A AL L" ANEXANDO UNA USB CON EL ESCANEADO DE ESTOS INCISOS). ✓ DOCUMENTACIÓN DEL NUMERAL 4.5.1.- ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. ✓ DOCUMENTACIÓN DEL NUMERAL 4.6.1.- ANEXO 19 "FORMATO Y DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO (ANEXANDO UNA USB CON EL ANEXO 19 EN PDF Y EXCEL). ✓ DOCUMENTACIÓN DEL NUMERAL 4.6.2.- ANEXO 20 Y GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA EN ORIGINAL Y COPIA (ANEXANDO UNA USB CON EL ANEXO 20 EN PDF Y EXCEL). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	4.4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS. PAGINA. 11	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA EN CARPETAS LEFORT, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LA REVISIÓN DE LA MISMA SEA MÁS RÁPIDA Y PRACTICA PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PRE G. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
			(DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA). LO SEÑALADO EN ESTE PÁRRAFO, ES CON OBJETO DE UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y NO TENDRÁ FINES DE DESCALIFICACIÓN.
3	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. G). CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, "CONSTANCIA DE ADEUDOS" PAGINA. 12	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO DEBEMOS PRESENTAR EL ANEXO 3, ASÍ COMO LA "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ PRESENTAR LOS SUPUESTOS QUE LE APLICAN Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE RESULTAN APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO
4	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. G). CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, "CONSTANCIA DE ADEUDOS" PAGINA. 12	YA QUE EL TRÁMITE DE LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO LLEVA UN PROCESO EL CUAL PUEDE VARIAR EN MUCHOS ASPECTOS (DOCUMENTALMENTE, TIEMPO, ETC.). POR ESTE MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE TRÁMITE EN LA CUAL SE MUESTRA QUE YA FUE INGRESADA DICHA INFORMACIÓN, ASÍ MISMO UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NOS COMPROMETEMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS DICHA CONSTANCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE SU PROPUESTA INCLUYA LOS ACUSES DE RECIBIDOS POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE Y EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR DICHAS CONSTANCIAS EN ORIGINAL.
5	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO A Y B PAGINA. 13	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTOS INCISOS DEBEMOS PRESENTAR EL ANEXO 4, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL INCISO B. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE RESULTAN APLICABLES, EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PRE G. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
6	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO G PAGINA. 14	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA, PRESENTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO Y NO CONTENGAN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UN ANEXO ADECUADO A ESTA SITUACIÓN. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA ESTE, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.
7	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO R PAGINA. 15	ENTENDEMOS QUE ESTE INCISO ES UNO Y EXCLUSIVAMENTE PARA LAS EMPRESAS QUE PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA, POR LO TANTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

8	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA. ANEXO 19 "FORMATO PAGINA. 15 Y 16	ENTENDEMOS QUE ESTE ANEXO SE PRESENTARÁ POR PARTIDA OFERTADA, IMPRESO Y EN USB IDENTIFICADA EN FORMATO EXCEL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO Y DEBERÁ ATENDER TODO LO ESPECIFICADO EN EL PUNTO 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA
---	--	---	---

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

9	3.5 OPCIONES PARA PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE SOSTENIMIENTO CUMPLIMIENTO. PAGINA. 9 Y 10	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA PODEMOS PRESENTAR LAS SIGUIENTES OPCIONES: FIANZA. CHEQUE DE CAJA. CHEQUE CRUZADO. CHEQUE CERTIFICADO. BILLETE DE DEPÓSITO. CARTA DE CRÉDITO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LOS CHEQUES PRESENTEN LA LEYENDA DE NO NEGOCIABLES.
---	--	---	--

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

10	ANEXO TÉCNICO 4.1 MUESTRAS	SE ENTIENDE QUE, PARA LAS PARTIDAS NO MENTIONADAS EN ESTE PUNTO EL DOCUMENTO "ANEXO 1.3 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" NO SERÁ UN REQUERIMIENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
----	-------------------------------	---	-------------



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

11	ANEXO TÉCNICO 4.1 MUESTRAS	EN CASO QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NO. SE ENTIENDE QUE, PARA LAS PARTIDAS NO MENCIONADAS EN EL PUNTO, EL DOCUMENTO "ANEXO 1.3 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" SE PRESENTARÁ CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿ES CORRECTO?	PUEDEN HACERLO DE ESA FORMA, SOLO EN EL CASO QUE LAS PARTIDAS OFERTADAS POR SU REPRESENTADA NO ESTÉN MENCIONADAS EN EL PUNTO 4.1 MUESTRAS
12	ANEXO TÉCNICO 4.2 VISITAS	SE ENTIENDE QUE, EN CASO DE OFERTAR PARA PARTIDAS NO MENCIONADAS EN ESTE PUNTO, EL DOCUMENTO "ANEXO 1.6 CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA" SE PODRÁ PRESENTAR CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿ES CORRECTO?	PUEDEN HACERLO DE ESA FORMA, SOLO EN EL CASO QUE LAS PARTIDAS OFERTADAS POR SU REPRESENTADA NO ESTÉN MENCIONADAS EN EL PUNTO 4.2 VISITAS
13	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ÚNICAMENTE INCLUIR PORTADA, ÍNDICE Y PÁGINAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, ETC. ESTO CON EL FIN DE REDUCIR EL PESO DE LOS ARCHIVOS Y PERMITIR UN MANEJO MÁS EFICAZ. ¿SE ACEPTA?	PUEDEN OFERTARLO, PERO DEBERÁ INCLUIR SI O SI EN USB TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLETOS PRESENTADOS EN SU PROPUESTA IMPRESA, EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DIGITALES NO ESTÉN COMPLETOS, SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
14	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.4	SE ENTIENDE QUE EL FORMATO GENERAL DE LA CARTA DE APOYO ES LIBRE SIEMPRE Y CUANDO SE INCLUYAN LOS TEXTOS MENCIONADOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SEGÚN EL TIPO DE BIEN, SE COLOCA EL TEXTO QUE DEBERÁ TENER LA CARTA DE APOYO DE FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
15	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.4 CARTA DE APOYO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHO FORMATO DE CARTA DE APOYO SELLADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE AL PUNTO 4.7.1.4
16	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ENTENDEMOS QUE SI EN UN CONTRATO Y/O PEDIDOS HAY MÁS DE UNA PARTIDA DE LAS CUALES ESTAMOS OFERTANDO, SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR ÚNICAMENTE DICHO CONTRATO, MARCANDO LAS PARTIDAS A OFERTAR.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		¿SE ACEPTA?	
17	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ENTENDEMOS QUE LOS CONTRATO Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS DE LOS BIENES QUE OFERTAMOS, SERÁN DE LA MISMA NATURALEZA O SIMILARES CARACTERÍSTICAS. Y ESTO DEBERÁN DE ESTAR ACOMPAÑADOS CON CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA Y/O FACTURAS Y/O ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS Y/O CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
18	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DENTRO DEL ANEXO NO SE ENCUENTRAN INCLUIDAS TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS. ES POR ESTO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 22, 28, 29, 34, 35, 49, 62, 82, 88 Y 181.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
19	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, PARTIDA 32, INCISO 3.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UNA RESOLUCIÓN DE +/- 0.3 ° EN LA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA. DADO QUE EL CONTROL DE DICHA MEDICIÓN SI SE PUEDE DAR CON INTERVALOS DE 0.1° ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
20	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, PARTIDA 32, INCISO 3.4	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UN RANGO DE 22 A 65 % EN INCREMENTOS DE 1%. PARA PERMITIR UNA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
21	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, PARTIDA 32, INCISO 3.5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UN RANGO DE 40 A 95%. PARA PERMITIR UNA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
22	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, PARTIDA 32, INCISO 4.2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UNA RESOLUCIÓN DE +/- 0.3 ° EN LA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA. DADO QUE EL CONTROL DE DICHA MEDICIÓN SI SE PUEDE DAR CON INTERVALOS DE 0.1° ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
23	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, PARTIDA 32, INCISO 4.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CALENTADOR CON INCREMENTOS DE 10%. PARA PERMITIR UNA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
24	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, PARTIDA 32, INCISO 9.1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 8.5" PARA PERMITIR UNA LIBRE COMPETENCIA DADO QUE NO TIENE UN EFECTO DIRECTO EN EL CUIDADO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
25	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	EN EL ANEXO MENCIONADO NO SE ENCUENTRAN ENLISTADOS TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ESTÁN LICITANDO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS PLAZOS DE ENTREGA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN PRESENTE.	DEBERÁ ATENDER A LO INDICADO EN LA PRECISIÓN 2 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

13. - MEGAMED, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.5 DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G) "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE. • IMPUESTO PREDIAL • EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES • IMPUESTO SOBRE NÓMINA • IMPUESTO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS • IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS • IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE • DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA, (EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONCEPTO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA, (EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO), SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PRESENTAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (EN ORIGINAL Y COPIA) EN DONDE SE ENCUENTRA NUESTRO DOMICILIO FISCAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

2	4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE QUE ALGÚN NUMERAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO APLIQUE A MI REPRESENTADA, PODAMOS PRESENTAR ESCRITOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO APLICA. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE SER MÁS ESPECÍFICOS
---	-------------------------	--	------------------------------



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

3	4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCATE SE ACEPTE PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO, COPIA DEL PEDIDO, ASÍ COMO EL COMPROBANTE DE PAGO POR PARTE DE LA INSTITUCION, PRESENTADO EL ESTADO DE CUENTA PARA CORROBORAR EL DEPOSITO A NUESTRA EMPRESA; ESTO DEBIDO A QUE LA FIANZA CORRESPONDIENTE AUN SE ENCUENTRA VIGETE Y SE LIBERA HASTA QUE CUMPLE LA VIGECIA DE DOS O TRES AÑOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LOS PUNTOS SOLICITADOS EN 4.7.1.7
4	4.1.1 EQUIPOS DE IMAGEN	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL ES EL NUMERO DE PARTIDA PARA LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN LAS PÁGINAS 33, 34, 35, 36 Y 37 DE 382, TODA VEZ QUE NO ESTÁN RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BINES". ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
5	4.1.1 EN REFERENCIA A LOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN E LAS MUESTRAS FISICAS DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN...	ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR UNICAMENTE VIDEO DEMOSTRATIVO DONDE SE VISUALICE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN OFERTADO, ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DEL MISMO, ACOMPAÑADO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
6	PARTIDAS 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, 531.341.2537 UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX, 531.341.2479, UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, 531.254.0049, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES, 531.924.0031, ULTRASONOGRAFO (FIJO),	EN LAS BASES NO SE ENCUENTRAN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS, SOLICITAMOS QUE NOS PROPORCIONEN LAS DESCRIPCIONES PARA PODER REALIZAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
7	PARTIDA 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO,	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA DE AL MENOS 400 KHZ, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA ENTREGA DE KILOVOLTAJE DE MAYOR CALIDAD. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
8	PARTIDA 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO,	LOS EQUIPOS TELEMANDO CON BASCULACIÓN 90/90 PUEDEN REALIZAR PROYECCIONES DE FORMA VERTICAL 90° PARA TÓRAX, POR LO QUE LOS EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UNA DISTANCIA FOCAL DE 180 CM PARA ESTAS PROYECCIONES, SIN SER NECESARIO UN BUCKY DE PARED ADICIONAL, LO CUAL	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		HACE UN SISTEMA MAS FUNCIONAL ¿ES CORRECTO?	
9	PARTIDA 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO,	EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN DETECTOR DIGITAL DE 43 X 43 CM CON UNA MATRIZ DE 2800 X 2800 Y PIXEL DE 148µM O MENOR CON EFICIENCIA CUÁNTICA DQE DE ALMENOS 65%. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
10	PARTIDA 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO,	LOS EQUIPOS TELEMANDO EN SUS APLICACIONES INCLUYEN PROCESOS DINÁMICOS, POR LO QUE LAS FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN QUE SE DEBEN INCLUIR SON SUSTRACCIÓN DIGITAL DE IMAGEN O DSA, AJUSTE DE VENTANA, BRILLO, ZOOM, HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS Y ÁNGULSO, INGRESO DE TEXTO ENTRE OTRAS, ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
11	PARTIDA 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO,	CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN EQUIPO QUE SE PUEDA INTERFASAR CON MEDIOS DIGITALES DE IMAGEN, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LAS FUNCIONES DICOM PARA LE INTERCAMBIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
12	PARTIDA 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO,	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN CON MONITOR DE 19" DE AL MENOS 1 MEGA PIXEL, CON FUNCIONES DE POSTPROCESAMIENTO DE IMAGEN. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
13	PARTIDA 531.341.2537 UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA DE AL MENOS 400 KHZ, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA ENTREGA DE KILOVOLTAJE DE MAYOR CALIDAD. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
14	PARTIDA 531.341.2537 UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON DOS DETECTORES DIGITALES DE 43 X 43 CM CON UNA MATRIZ DE 2800 X 2800 Y PIXEL DE 148µM O MENOR CON EFICIENCIA CUÁNTICA DQE DE AL MENOS 65%. PARA MESA RADIOGRÁFICA Y BUCKY DE PARED ¿ES CORRECTO? 3.- CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO PUEDE SER USADO CON DIFERENTES PACIENTES Y EL ACCESO SEA FÁCIL, LA MESA O TABLERO DE PACIENTE DEBERÁ CONTAR CON UNA ALTURA VARIABLE DESDE 54 CM O MENOR A 85 CM O MAYOR Y DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE AL MENOS 160 CM, PARA LA COBERTURA DE PACIENTE ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

15	PARTIDA 531.341.2537 UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	PARA MAYOR FACILIDAD DE USO Y MEJORAR EL FLUJO DE PACIENTES EN LA SALA, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 1024 PROGRAMAS ANATÓMICOS PARA SELECCIÓN DE LA MEJOR TÉCNICA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
16	PARTIDA 531.341.2537 UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN CON MONITOR DE 19" DE AL MENOS 1 MEGA PIXEL, CON FUNCIONES DE POST PROCESAMIENTO DE IMAGEN. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
17	PARTIDA 531.341.2537 UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN EQUIPO QUE SE PUEDA COMUNICAR CON MEDIOS DIGITALES DE IMAGEN, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LAS FUNCIONES DICOM PARA LE INTERCAMBIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
18	PARTIDA 531.341.2479 UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL	PARA CONTAR CON UN EQUIPO DE AMPLIA COBERTURA DE PACIENTES, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN GENERADOR DE 30 KW O MAYOR ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
19	PARTIDA 531.341.2479 UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL	EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON ROTACIÓN DE COLUMNA O BRAZO DE +/- 90° PARA MAYOR VERSATILIDAD EN EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIDAD RADIOGRÁFICA ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
20	PARTIDA 531.341.2479 UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN DETECTOR DIGITAL DE 35X43 CM, CON TAMAÑO DE PIXEL DE 148µM Y 14 BIT DE PROFUNDIDAD O MAYOR ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
21	PARTIDA 531.341.2479 UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL	EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON BATERÍAS PARA MOVIMIENTO MOTORIZADO Y EXPOSICIÓN RADIOGRÁFICA. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
22	PARTIDA 531.341.2479 UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL	ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON UNA MEMORIA DE 320 GB O MAYOR PARA ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 15,000 IMÁGENES. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
23	PARTIDA 531.341.2479 UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON PANTALLA DE 19" LCD TFT TÁCTIL DE RESOLUCIÓN DE 120 X 1024 PÍXELES O MAYOR PARA CONTROL DE EQUIPO Y DESPLIEGUE DE IMAGEN COMPLETA ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

14. -ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO TÉCNICO PUNTO 4.7.1.4	SOLICITAN CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. PREGUNTA: POR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA PROPUESTA TAN CORTOS, SOLICITAMOS ENTREGAR LA CARTA DE APOYO DE LA FABRICANTE ESCANEADA Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAR LA CARTA ORIGINAL EMITIDA POR EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE PUEDE ADJUNTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, PERO DEBERÁ ADJUNTAR EL CORREO ELECTRÓNICO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE SE LE ESTÁ ENVIANDO LA CARTA, EN CASO DE NO ADJUNTAR EL CORREO ELECTRÓNICO, SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
2	ANEXO 29	PLAZOS DE ENTREGA, OMITIERON MENCIONAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA PARA LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 3 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PARTIDA 4 UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX, PARTIDA 6 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL Y LA PARTIDA 7 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES. PREGUNTA: ¿SERÍAN TAN AMABLES DE ACLARAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
3	ANEXO 29	PLAZOS DE ENTREGA PARA LA PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN UN TIEMPO DE ENTREGA DE 60 DÍA. PREGUNTA: DERIVADO DEL DESABASTO DE SEMICONDUCTORES A NIVEL MUNDIAL, OCASIONADO POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, ASÍ COMO LOS ACONTECIMIENTOS DE LA GUERRA DE RUSIA Y UCRANIA, TODOS LOS FABRICANTES DE EQUIPOS MÉDICOS TIENEN UN RETRASO CONSIDERABLE EN LA ENTREGA DE SUS EQUIPOS, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE SE PERMITA ENTREGAR LOS EQUIPOS EN 150 DÍAS. LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR MAYOR PROVEEDURÍA EN BENEFICIO DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. ¿SE ACEPTA?	EL PLAZO PARA LA ENTREGA SERÁ DE 80 DÍAS NATURALES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
4	ANEXO TÉCNICO PUNTO 4.1.1	SOLICITAN PUNTOS A EVALUAR DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS COMO PARTE DE EVALUACIÓN DE MUESTRA FÍSICA, POR EJEMPLO, EN EL PUNTO 3 SOLICITAN PONER LA DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DÓNDE SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PARA SU EVALUACIÓN, EN EL PUNTO 4 INCLUIR ORDEN DE SERVICIO DEL EQUIPO Y EN EL PUNTO 5 DATOS DEL JEFE DE SERVICIO O DEL INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA CORROBORAR LOS DATOS PRESENTADOS. PREGUNTA: COMO DE TODOS ES DE SU CONOCIMIENTO ACTUALMENTE TODAVÍA ESTAMOS EN UN ALTO ÍNDICE DE CONTAGIOS DE COVID Y LOS EQUIPOS DONDE PODRÍAMOS REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS ESTÁN EN HOSPITALES QUE SE CONSIDERAN COVID, POR LO QUE DIFÍCILMENTE NOS PERMITIRÁN ACCESO A REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITAS, SIN EMBARGO, SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR LOS ESTUDIOS REQUERIDOS (MUESTRA FÍSICA) DEL MODELO A OFERTAR CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS, DE UN EQUIPO DÓNDE EL FABRICANTE NOS PUEDA APOYAR EN CONSEGUIR LO SOLICITADO, LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
5	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	SOLICITAN LO SIGUIENTE: "3.1 PANTALLA PLANA CMOS O SILICIO AMORFO DE 25 X 25 CM O MAYOR O 30X 30 CM O MAYOR". PREGUNTA: AL PARECER EXISTE UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN YA QUE DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SOLICITADOS UN DETECTOR DE TAMAÑO 25 X 25 CM QUEDARÁ LIMITADO EN COBERTURA PARA LA REALIZACIÓN CORRECTA DE ESTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE EL DETECTOR A OFERTAR EN ESTE PUNTO SEA DE AL MENOS CON UN TAMAÑO DE 30 X 30 CM. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN MODIFICACIÓN DE BASES
6	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	SOLICITAN LO SIGUIENTE: "5.2 CON INTERRUPTOR DE PIEL Y CONTROL DE MANO". PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL INTERRUPTOR ES DE PIE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
7	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	SOLICITAN LO SIGUIENTE: "CON CARRO, CON SISTEMA DE FRENO Y FIJACIÓN PARA LOS MONITORES" PREGUNTA: LA FIJACIÓN DE LOS MONITORES Y EL SISTEMA DE FRENADO DEPENDEN DEL DISEÑO DE CADA FABRICANTE Y DURANTE EL ESTUDIO Y/O PROCEDIMIENTO NO REPRESENTA UN BENEFICIO PARA EL PACIENTE O EL USUARIO, POR LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, LO ANTERIOR NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
8	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	SOLICITAN LO SIGUIENTE: "TIPO DE EXAMEN O PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE BOLO PREDEFINIDO, CON SUSTRACCIÓN CON TOLERANCIA AL MOVIMIENTO (MTS)". PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR LA NOMENCLATURA DE SOFTWARE O APLICACIÓN QUE MANEJA CADA FABRICANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO, EN ESTE CASO LA NOMENCLATURA SUSTRACCIÓN CON TOLERANCIA AL MOVIMIENTO (MTS) ES PROPIO DE UN FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO REFERENCIE QUE ES LA MISMA APLICACIÓN
9	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	SOLICITAN LO SIGUIENTE: "COMUNICACIÓN AL SISTEMA DE RIS-PACS EMIRADI". PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE COMUNICARSE AL SISTEMA PACS DEL HOSPITAL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SE REQUIERE QUE PUEDA COMUNICARSE AL SISTEMA RIS-PACS (EMIRADI) ASÍ COMO AL SAMIH, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.8
10	PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	SOLICITAN LO SIGUIENTE: "DOS LENTES EMPLOMADOS, PARA PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS. Y DOS GUANTES EMPLOMADOS, PARA PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTA". PREGUNTA: AL PARECER HAY UN ERROR DE CONCEPTO, SI BIEN LOS LENTES Y GUANTES EMPLOMADOS SON PARA USARSE COMO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SI HAY EN EL MERCADO GUANTES FLEXIBLES PARA UTILIZARSE DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIONISMO, SIN EMBARGO, EL FABRICANTE NO HACE MENCIÓN DE	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		UTILIZARSE (TANTO LOS LENTES COMO LOS GUANTES) COMO ACCESORIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA INTERVENCIONISMO. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR LENTES Y GUANTES EMPLOMADOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO QUE SE ENTREGARAN ESTOS ACCESORIOS PARA UTILIZARSE COMO LO REQUIEREN. ¿SE ACEPTA?	
11	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	ENTENDEMOS QUE LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LAS PARTIDAS 3,4,6, 7 Y 23 SE DARÁN A CONOCER EL DÍA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
12		DADO QUE LAS FICHAS TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA DIGITAL Y FLUROSCOPIA DIGITAL CON TELEMANDO, UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX, UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE MULTICORTES DE 16 O DE 29 CORTES, ENTRE OTRAS, AÚN NO SE HA PUBLICADO Y NO CONOCEMOS EL NIVEL DE EQUIPO QUE ESTÁ SOLICITANDO LA CONVOCANTE, NI EL MODELO CON QUE SE VA A PARTICIPAR Y DADO QUE EN LOS REQUISITOS DE LAS ENTREGA DE MUESTRAS SOLICITAN QUE ESTAS SEAN DE MISMO MODELO A OFERTAR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECORRA EL DÍA DE LA ENTREGA DE MUESTRA. ¿SE ACEPTA?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
13	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	DADO QUE LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LAS PARTIDAS 3,4,6,7 Y 23 AÚN NO SE HAN PUBLICADO Y QUE NO CONOCEMOS EL NIVEL DE EQUIPO QUE ESTÁ SOLICITANDO LA CONVOCANTE, NI EL MODELO CON QUE SE VA A PARTICIPAR PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN ENTREGAR LA CARTA DE FABRICANTE EN COPIA SIMPLE ¿SE ACEPTA?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
14		PREGUNTA: AL SER UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL, SE PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO, DONDE AQUELLOS PAÍSES CUENTEN O NO CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. ¿ES ESTO CORRECTO?	SI, PODRÁ OFERTAR EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
15	23 ULTRASONÓGRAFO.(FIJO) 531.924.0031-1 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR PARA PROPÓSITO GENERAL. (ADULTO, PEDIÁTRICO, GINECOLÓGICO)EQUIPO MÉDICO 1	DICE: UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR PARA PROPÓSITO GENERAL. (ADULTO, PEDIÁTRICO, GINECOLÓGICO). PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PUEDAN COMPARTIR LA CÉDULA TÉCNICA DE ESTA PARTIDA, TODA VEZ QUE SOLO SE DESCRIBE DE MANERA GENERAL.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
16	ANEXO 1.6	DERIVADO DE QUE LA CONVOCANTE DENEGÓ EL ACCESO PARA PERMITIRNOS REALIZAR LA VISTA EN TIEMPO Y FORMA AL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA, ENTENDEMOS QUE EN CASO DE REQUERIR LAS PARTIDAS 3,4, 6, 7 Y 23 NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO CONTAR CON EL ACTA SELLADA DE DICHA VISITA. ¿ES CORRECTO?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
17	ANEXO TÉCNICO PUNTO 4.7.1.5 GUÍAS MECÁNICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REACTIVARA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA YA QUE ESTO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS MECÁNICAS DEFINITIVAS, ESTE ÚLTIMO COMO REQUISITO INDISPENSABLE EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE

15. - EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA S.A.P.I. DE C.V.. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL AREÁ TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.7 PROPUESTAS, 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.7.1.1 PROPUESTA TÉCNICA. PÁG. 39	DICE:" LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIADOS COMO SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA..." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN CON SOLO LAS HOJAS REFERENCIADAS DONDE DESCRIBA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, YA QUE HAY MANUALES CON MÁS DE 500 HOJAS, FACILITANDO LA REVISIÓN Y AYUDANDO AL ECOSISTEMA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	SE DEBERÁ PRESENTAR IMPRESO PORTADA, HOJAS REFERENCIADAS Y CONTRAPORTADA DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS, Y EN FORMA ELECTRONICA EN PDF, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLETOS. EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO NO ESTE COMPLETO, SE DESECHARÁ LA PROPUESTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	4.7 PROPUESTAS, 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.7.1.2 RESUMEN DE LAS PARTIDAS OFERTADAS. PÁG. 39.	PARA EL ANEXO 1.4 SOLICITADO EN ESTE PUNTO, ENTENDEMOS QUE EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN SE PONDRÁ LA DESCRIPCIÓN CORTA QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, SI NO ES CORRECTO FAVOR DE INDICAR SI SE NECESITA LA DESCRIPCIÓN QUE COMPLETA QUE ESTÁ EN CADA FICHA TÉCNICA, FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ COLOCAR LA "DESCRIPCIÓN DEL COMPENDIO" ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1.
3	4.7 PROPUESTAS, 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES, 2. PARA MOBILIARIO MÉDICO. 2.2 CERTIFICADOS, 2.2.2. PÁG. 41.	DICE:" CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DEL FABRICANTE DEL ACERO, EN EL QUE SE MENCIONE COMO CLIENTE AL FABRICANTE DEL MOBILIARIO MÉDICO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE CERTIFICADO SEA OPCIONAL, YA QUE SE ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL ESTAR SOLICITANDO QUE APAREZCA EL NOMBRE DEL FABRICANTE DE MOBILIARIO EN UN DOCUMENTO PROPIO DE UN TERCERO O DISTRIBUIDOR, NO DEL FABRICANTE DE MOBILIARIO MÉDICO. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	NO SE ACEPTA.
4	4.7 PROPUESTAS, 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.7.1.5 GUÍAS MECÁNICAS, PÁG. 44.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR GUÍAS MECÁNICAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO PDF IMPRESAS Y SI RESULTAMOS ADJUDICADOS PRESENTAR EN FORMATO ELECTRÓNICO AUTOCAD (USB O CD) Y PDF. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	SE ACEPTA
5	4.7 PROPUESTAS, 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, PÁG. 44.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR POR LO MENOS UN CONTRATO O PEDIDO REFERENTE A LA VENTA O SERVICIO DE RENTA O ARRENDAMIENTO, DE EQUIPO MÉDICO, BIOMÉDICO O MOBILIARIO O INSTRUMENTAL, CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. ESTO PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA	NO SE ACEPTA.
6	4.7 PROPUESTAS, 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.7.1.9 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO, PÁG. 45.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR SOLO COPIA DE CERTIFICADO O DIPLOMA DE CAPACITACIÓN DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO, YA QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SON PROPIOS DE ESTAS PERSONAS NO DE LOS LICITANTES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	SE ACEPTA
7	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, TODAS LAS PARTIDAS	ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON ENUNCIATIVAS, MÁS NO LIMITATIVAS POR LO QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O	LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUBLICADAS EN EL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'P' and various initials.

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SUPERIORES NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	PRESENTE PROCEDIMIENTO SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS LAS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CABALMENTE CADA UNA DE ELLAS.
8	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, TODAS LAS PARTIDAS	ENTENDEMOS QUE PARA LOS BIENES QUE DESCRIBE EN LAS FICHAS TÉCNICAS, LA PARTE DE CONSUMIBLES NO SE DEBE DE PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS NI CERTIFICADOS DE CALIDAD SOLO DEL EQUIPO PRINCIPAL, ACCESORIOS Y REFACCIONES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 4.7.1.3. PUNTO 1.2,3,4,5. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	NO ES CORRECTO. LOS CONSUMIBLES QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO DEBERÁ PRESENTARLO Y EN CASO DE NO REQUERIRLO PODRÁ PRESENTAR CARTA DE NO REQUERIMIENTO EMITIDO POR COFEPRIS O PRESENTAR COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER JUSTA Y CABALMENTE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIBLE.
9	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO DOF OFICIAL, SOLO LA CARATULA Y LA HOJA DE REFERENCIA DEL PRODUCTO. O EN SU CASO SOLO PRESENTAR DOF 1 SOLA VEZ CON TODOS LOS PRODUCTOS QUE LO REQUIERAN. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUEDE PRESENTAR TODO EL COMUNICADO DEL DOF DE LA FECHA SOLICITADA, REFERENCIANDO ADECUADAMENTE CADA BIEN CON PARTIDA, PARTIDA NO REFERENCIADA Y ETIQUETADA, SE TOMARÁ COMO NO CUMPLIMIENTO
10	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA PARA EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL UNA TOLERANCIA EN MEDIDAS DE +-10%. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	SE ACEPTA PARA EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO. NO SE ACEPTA PARA PARTIDAS DE INSTRUMENTAL
11	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS EN CADA FICHA PODER PRESENTAR MÍNIMO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DE 1 A 2 MARCAS PARA CUMPLIR CON EL VOLUMEN DE INSUMOS SOLICITADOS YA QUE HAY PARTIDAS CON REQUERIMIENTOS, QUE SOBREPASAN EL ABASTO DE UNA MARCA DERIVADO A LA PANDEMIA, ESTOS CUMPLIENDO CON LA COMPATIBILIDAD DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	
12	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS EN CADA FICHA PODER PRESENTAR MÍNIMO 2 MARCAS PARA CUMPLIR CON EL VOLUMEN DE INSUMOS SOLICITADOS YA QUE HAY PARTIDAS CON REQUERIMIENTOS, QUE SOBREPASAN EL ABASTO DE UNA MARCA DERIVADO A LA PANDEMIA, ESTOS CUMPLIENDO CON LA COMPATIBILIDAD DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	SE RESPONDIÓ EN LA PREGUNTA ANTERIOR.
13	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2. PUNTO 1.3, PÁG 59.	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO LICITATORIO SE PERMITIRÁ PRESENTAR A EVALUACIÓN EQUIPO CON CAPACIDAD ÚTIL DE VOLUMEN DE 102 LITROS. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
14	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2. PUNTO 2.1, PÁG. 59.	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE PRESENTAR PARA SU EVALUACIÓN EQUIPO CUYA PUERTA CUENTA CON MECANISMOS DE SEGURIDAD SOLICITADOS, AUNQUE SE TRATA DE UNA SOLA PUERTA Y NO DOS. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
15	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2. PÁG. 59.	ENTENDEMOS QUE AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL PODEMOS PRESENTAR PARA SU EVALUACIÓN EQUIPO DE ORIGEN CHINO QUE CUMPLE CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOLICITADOS DE FABRICACIÓN Y CALIDAD. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	NO SE LIMITA, SIN EMBARGO, SE SUGIERE QUE NO SEA DE ORIGEN CHINO
16	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2. PUNTO 10, PÁG 59.	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR PARA SU EVALUACIÓN EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON SISTEMA DE MONITOREO REMOTO PROPIO DE LA MARCA REPRESENTADA, QUE OPTIMIZA EL SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN SU FUNCIONAMIENTO. SIENDO ESTO	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO.	
17	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS QUE SE AJUSTEN LOS TIEMPOS DE ENTREGA MÍNIMOS DE 40 DÍAS, YA QUE DERIVADO DE LA PANDEMIA Y EL VOLUMEN SOLICITADO EN VARIAS PARTIDAS ES DIFÍCIL CUMPLIR CON ESOS TIEMPOS EN ESPECÍFICO LAS PARTIDAS QUE PIDEN 5, 7,15 Y 20 DÍAS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA	DEBERA ATENDER LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CADA BIEN CONFORME AL ANEXO 29, O EN SU CASO ESPECIFICAR A QUE PARTIDA
REPREGUNTAS			
1	REPREGUNTA 3 4.7 PROPUESTAS, 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES, 2 PARA MOBILIARIO MÉDICO. 2.2 CERTIFICADOS, 2.2.2 PAGINA 41.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL, LO CUAL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE ESTÁ OFERTANDO A LA INSTITUCIÓN EN BENEFICIO DE LA MISMA Y DE LOS PACIENTES, ¿SE ACEPTA? EN CASO DE NO ACEPTARSE, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-MÉDICA PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL ACERO. FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA, EL CERTIFICADO DE FABRICANTE DE ACERO NOS DA CERTEZA DE QUE EL MOBILIARIO OFERTADO SEA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, IMPLICANDO QUE POR LO MENOS LA DURABILIDAD DEL MOBILIARIO SEA DE 5 AÑOS.
2	REPREGUNTA 14 ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2 PUNTO 2.1 PÁGINA 59	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA YA QUE LA CARACTERÍSTICA OFERTADA NO DEMERITA LA CALIDAD DEL PRODUCTO, NI LA OPERACIÓN DEL MISMO. EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-MÉDICA	LA CEYE DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, ESTA DISEÑADA Y CONSTRUIDA BAJO LA NORMA NOM-016-SSA3- 2012 QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, DE INFRAESTRUCTURA DE HOSPITALES Y CONSULTORIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA, QUE CUENTA CON ÁREA BLANCA Y ÁREA GRIS, MOTIVO POR EL CUAL ESTA AUTOCLAVE REQUIERE LAS DOS PUERTAS.
3	REPREGUNTA 16 ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2 PUNTO 10 PÁGINA 59	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR PARA SU EVALUACIÓN, EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CON SISTEMA DE MONITOREO REMOTO PROPIO DE LA	LO QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO 10, ES QUE CUENTE CON CONECTIVIDAD A RED TCP/IP POR MEDIO DE ETHERNET Y LO SOLICITADO EN LA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		MARCA REPRESENTADA, QUE OPTIMIZA EL SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN SU FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA? EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-MEDICA, YA QUE LA CARACTERÍSTICA OFERTADA NO DEMERITA LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA OPERACIÓN DEL MISMO.	PREGUNTA 16 ES UN SISTEMA DE MONITOREO REMOTO, LO CUAL NO ES SIMILAR.
--	--	--	--

16. - NEUMEDICA HOMECARE, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL AREÁ TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PROPUESTA TECNICA NUMERAL 4.7.1.9 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO PUNTO 2	SOLICITAN COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL Y/O TITULO ACADÉMICO ENTENDEMOS QUE AL SER PERSONAL TÉCNICO EL QUE REALIZA LOS MANTENIMIENTOS, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO, NO SE SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTA POR NO PRESENTAR ESTE PUNTO.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE AL NUMERAL 4.7.1.9 DE LA PROPUESTA TECNICA
2	PROPUESTA TECNICA NUMERAL 4.7.1.9 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO PUNTO 4	SOLICITAN COPIA LEGIBLE DE DOCUMENTO DEBIDAMENTE MEMBRETADO DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA A LA CUAL SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO, DONDE SE DEMUESTRE QUE EL (LOS) INGENIERO(S) Y/O TÉCNICO(S) REALIZO EN AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO TRES AÑOS) EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI BASTA CON PRESENTAR COPIA DE UNA ORDEN DE SERVICIO DE ALGUNA INSTITUCIÓN DONDE SE HALLA PRESTADO LOS SERVICIOS	ES CORRECTA SU APRECIACION



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
3	PROPUESTA TECNICA NUMERAL 4.7.17 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAN CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SOLICITAMOS PODER ENTREGAR FACTURA CON EL SELLO DE ENTREGA DE CONFORMIDAD, DEBIDO A QUE EN OCASIONES NOS GENERAN PEDIDOS CON TIEMPO DE ENTREGA MINIMO Y SIN NECESIDAD DE PRESENTAR FIANZA	DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.7
4	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	SOLICITAN TIEMPO DE ENTREGA PARA EL INSTRUMENTAL DE 60 Y 84 DIAS SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 120 DIAS YA QUE EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS TARDAN MAYOR TIEMPO AL SER DE IMPORTACION	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ ATENDER A LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS
5	FICHA TECNICA PARTIDA 77 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	ACCESORIOS PUNTO 2. SOLICITAN 500 ESPECULOS REUSABLE DE DIFERENTES TAMAÑOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO ENCARECER EL EQUIPO Y PODER OFERTAR UN MEJOR PRECIO PODER OFERTAR ESPECULOS DESECHABLES PEDIATRICO Y ADULTO	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 5
6	TODOS LOS SETS DE INSTRUMENTAL	SOLICITAN ...SER RESISTENTES A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO. PREGUNTA: EL ACERO INOXIDABLE TIENES SUS CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS, ESTAS RESISTENCIAS SOLICITADAS SE DEBERÁN CUMPLIR DE ACUERDO A ESTAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ACERO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
7	TODOS LOS SETS DE INSTRUMENTAL	SOLICITAN. GRABADO LASER EN CADA INSTRUMENTO "H.G. CUAJIMALPA 2022". PREGUNTA: ESTA ES UNA LEYENDA MUY LARGA, LA PUEDEN HACER MAS CORTA, PARA PODER COLOCARLA EN UN MAYOR NUMERO DE INSTRUMENTOS. YA QUE ALGUNOS POR SUS DIMENSIONES NO VA A SER POSIBLE HACERLO	PODRÁ AGRABAR CUAJIMALPA 2022
8	PARTIDA 123, INCISO 128	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR SIN RANURA	LA PREGUNTA ESTÁ MAL REFERENCIADA
9	PARTIDA 123, INCISO 29	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	PARTIDA 124, INCISO 37	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR,	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	
11	PARTIDA 125, INCISO 47	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	PARTIDA 126 INCISO 23	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
13	PARTIDA 128, INCISO 13	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR CURVA	NO SE ACEPTA
14	PARTIDA 129, INCISO 19	SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL TAMAÑO DE LA PUNTA Y SE OMITA LA MEDIDA DE 90°	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE PINZAS SATINSKY DEBAKEY VASCULAR DE 90°
15	PARTIDA 129, INCISO 20	SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL TAMAÑO DE LA PUNTA Y SE OMITA LA MEDIDA DE 130°	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE PINZAS SATINSKY DEBAKEY VASCULAR DE 130°
16	PARTIDA 129, INCISO 47	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	PARTIDA 130, INCISO 55	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	PARTIDA 130, INCISO 69	FAVOR DE ESPECIFICAR EL DIAMETRO MINIMO DEL ALAMBRE QUE DEBE CORTAR	DEBERÁ SER DE ACERO INOXIDABLE DE 0.18 O 0.20
19	PARTIDA 134, INCISO 3	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	PARTIDA 137, INCISO 41	SOLICITAMOS AMPLIEN LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE ESTE PERFORADOR ES UN EQUIPO	ATENDER LA PRECISIÓN TECNICA NÚMERO 9 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
21	PARTIDA 139, INCISO 36	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
22	PARTIDA 140 INCISOS 20 Y 21	AMBOS ÍTEM¿MS TIEN LA MISMA DESCRIPCIÓN, COTIZAMOS LOS DOS RENGLONES?	SE ELIMINA EL RENGLÓN O INCISO 21



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
23	PARTIDA 140, INCISO 22	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	NO SE ACEPTA
24	PARTIDA 141, INCISO 12	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	NO SE ACEPTA
25	PARTIDA 141, INCISO 14	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTA DE 18 CM	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
26	PARTIDA 141, INCISO 36	SOLICITAMOS NOS INDIQUEN SI ES CORRECTO EL MODELO	SE ELIMINA DICHO PUNTO
27	PARTIDA 142, INCISO 7	ESTA MEDIDA ES MUY GRANDE PARA ESTE SET. SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR DE 8 A 9 CM	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
28	PARTIDA 146, INCISO 16	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
29	PARTIDA 151, INCISO 28	QUE MODELO DE ABREBOCAS REQUIEREN	SE REQUIERE ABREBOCAS, ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 11
30	PARTIDA 153, INCISOS 1 Y 15	EN AMBOS RENGLONES ES EL MISMO INSTRUMENTO, DEBEMOS COTIZAR AMBOS?	SE ELIMINA EL RENGLÓN 16 Y ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 2
31	PARTIDA 154, INCISO 4	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
32	PARTIDA 155, INCISO 1	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
33	PARTIDA 156, INCISO 17	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
34	PARTIDA 157, INCISO 23	SOLICITAN JUEGO DE ESPECULOS, ES CUAL SE CONFORMA DE 3 MEDIDAS DIFERENTES, DEBEMOS OFERTAR UN JUEGO CON 3 PIEZAS, O UN JUEGO CON 3 PIEZAS DE CADA MEDIDA.	DEBERÁ CONSIDERAR UN JUEGO CON 3 MEDIDAS DIFERENTES
35	PARTIDA 159, INCISO 2	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
36	PARTIDA 162, INCISO 3	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LONG 285 MM, MEDIDA ESTANDAR, COMO SE ESPECIFICA EN LA PARTIDA 131 INCISO 2	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DERIVADO DE LA CANTIDAD DE PREGUNTAS Y PRECISIONES A LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SE
APLAZA LA CONTINUIDAD DEL PRESENTE EVENTO.-----

SE REANUDA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DE
JULIO DE 2022, CONTINUANDO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

17. - CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES
CUESTIONAMIENTOS:

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 2.5.2 CONDICIONES DE ENTREGA PÁG. 32 DE LAS BASES	DICE: POR ÚLTIMO, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES DE LAS PARTIDAS NÚMEROS 1,2,3,4,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,21,25,30,36,37,41, 59, 115 Y 163 EL TIEMPO MÁXIMO PARA SU INSTALACIÓN DEBERÁ DE SER QUINCE DÍAS HÁBILES. PREGUNTA: DEBIDO A LOS RETRASOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO A NIVEL MUNDIAL Y DEBIDO A QUE NUESTROS BIENES SON DE IMPORTACIÓN, SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN CONSIDERE UN TIEMPO MÁXIMO DE INSTALACIÓN DE 40 DÍAS HÁBILES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	NUMERAL 4.1.2 LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN, CLAVE COMPENDIO 531.619.04.03 PÁG. 35 DE LAS BASES.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MONITORES DE LA MISMA MARCA DE DIFERENTE MODELO AL PROPUESTO, PERMITIENDO DEMOSTRAR QUE LA CONECTIVIDAD ES CON MONITORES DE LA MISMA MARCA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
3	PARTIDA 8, PUNTO 3.1	DICE: RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA H. CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON RESOLUCIÓN DE 2.3 MB, YA QUE NO DEMERITA LA FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN QUE SE REQUIERE AL NO SER UN EQUIPO DE DIAGNÓSTICO ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 6
4	PARTIDA 8, PUNTO 21	DICE: CON POSIBILIDAD DE COMUNICARSE CON TODAS LAS CENTRALES DE MONITOREO DEL H.G. CUAJIMALPA. (PARTIDAS 10, 12 Y 14) PREGUNTA: DEBIDO A QUE CADA MARCA DESARROLLA UN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICO PARA SUS CENTRALES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA H. CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
5	PARTIDA 9, PUNTO 1.2	DICE: MONITOR MODULAR A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD O TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA H. CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA MICROMODULAR QUE PERMITE CRECER LOS PARÁMETROS	SU PREGUNTA ES CONFUSA, FAVOR DE ACLARARLA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DE MONITORIZACIÓN INSERTANDO LOS CABLES DE PI Y/O CO2 Y/O BIS, ETC. EN LOS CONECTORES MULTIMED Y QUE SON RECONOCIDOS POR EL MONITOR EN CUANTO SE CONECTAN, ¿SE ACEPTA?	
6	PARTIDA 9, PUNTO 1.19.8	DICE: FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA H. CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE 6 LATIGUILLOS PERMITIENDO EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
7	PARTIDA 9, PUNTO 1.25.2	DICE: MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS POR TÉCNICA MAINSTREAM. ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA H. CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA TÉCNICA DE MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA PARA LOS 5 MONITORES, YA QUE DE ESTA MANERA SE MINIMIZAN ERRORES OPERATIVOS POR EL MANEJO DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
8	PARTIDA 9, PUNTO 2	DICE: ECG: DOS CABLES TRONCALES Y DOS CABLES DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS, DOS ECG DE 5 PUNTAS Y UN CABLES DE LATIGUILLO DE 10 PUNTAS POR CADA MONITOR. PREGUNTA:	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA H. CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE 6 PUNTAS, ¿SE ACEPTA?	
9	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA	PREGUNTA: A EFECTO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, ¿ES POSIBLE QUE SE AMPLIEN LOS PLAZOS MÍNIMOS A 45 DÍAS HÁBILES? A FIN DE QUE SEA FACTIBLE PRESENTAR MEJORES CONDICIONES DE PRECIO PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DEBERÁ ATENDER LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CADA BIEN CONFORME AL ANEXO 29 O BIEN ESPECIFICAR A QUE PARTIDAS SE REFIERE
10	NUMERAL 4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS INCISOS E) Y F)	DICEN: E) RUBRICADAS POR QUIEN SUSCRIBA LA PROPUESTA POR LO MENOS EN EL ANVERSO DE TODAS SUS HOJAS. F) LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE. RESPUESTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI LA PROPUESTA A PRESENTAR POR MI REPRESENTADA IRÁ CON RUBRICA Y FIRMA AUTÓGRAFA POR LO MENOS EN EL ANVERSO DE TODAS LAS HOJAS QUE LA CONFORMAN, O SE PUEDE PRESENTAR CON RUBRICA POR LO MENOS EN EL ANVERSO DE TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMAN EL DOCUMENTO Y EN LA HOJA Y/O PÁGINA FINAL FIRMA AUTÓGRAFA. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

18. - DEWIMED, S.A., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	TODAS LAS PARTIDAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS BIENES QUE REQUIERE SON LOS INDICADOS EN LA PAGINAS 358-371 O LOS REFERIDOS EN EL ANEXO 29.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
2	TODAS LAS PARTIDAS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SEA TAN AMABLE DE PROPORCIONAR UNA LISTADO DE PARTIDAS EDITABLE DONDE CONTENGA CLAVE DE COMPENDIO Y CLAVE SAICA, TIPO DE BIEN Y CANTIDADES	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
3	TODAS LAS PARTIDAS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SEA TAN AMABLE DE PROPORCIONAR LAS FICHAS CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE SOLICITA DE MANERA EDITABLE.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
4	ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PÁGINAS 50 A LA 58 DE LAS BASES.	EL LISTADO QUE SE MUESTRA Y DESBRIBE LOS BIENES POR PARTIDA, CLAVES, TIPO DE BIEN Y CANTIDADES EN EL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" NO INCLUYE TODAS LAS PARTIDAS QUE SE DESCRIBEN EN EL LISTADO DE ACTAS PARA RECEPCIÓN DE BIENES DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA A PARTIR DE LA PÁGINA 358 Y HASTA LA PÁGINA 372 DE LAS MISMAS BASES. POR LO TANTO, TAMPOCO SE INCLUYEN FICHAS TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS FALTANTES EN EL PRIMER LISTADO Y TAMPOCO CONCUERDAN LAS PARTIDAS A LAS QUE LES CORRESPONDE UNA GUÍA MECÁNICA COMO LAS PUBLICADAS EN LOS ANEXOS 1.1.1.G Y 1.1.1.H., ASÍMISMO ESTÁN OMITIDAS EN EL ANEXO 29 "PLAZOS DE ENTREGA" EN LAS PÁGINAS 380, 381 Y 382 DE ESTAS MISMAS BASES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR LAS PARTIDAS QUE ESTÁ SOLICITANDO EN BASES E INCLUIR TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS DE ÉSTAS	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
5	NUMERAL 4.1.3 PÁGINA 36 DE LAS BASES	EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, LA CUARTA FILA DESCRIBE MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		ELECTROHIDRÁULICA A EVALUAR LOS PUNTOS 1,2,4,5, TODO EL PUNTO 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20. SIN EMBARGO NO HAY FICHA TÉCNICA PUBLICADA EN LAS BASES QUE CORRESPONDA A ESTE EQUIPO Y NO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PREGUNTA 1: ¿LA MUESTRA FÍSICA DE ESTE EQUIPO SIGNIFICA QUE DEBEMOS LLEVAR UNA MESA QUIRÚRGICA AL LUGAR DE EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS Y AHÍ SERÁN EVALUADOS LOS PUNTOS MENCIONADOS PREGUNTA 2: ¿LA CONVOCANTE PUBLICARÁ LA FICHA TÉCNICA DE ESTE EQUIPO QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN BASES?	PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
6	"LISTADO DE ACTAS PARA RECEPCIÓN DE BIENES DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA" PÁGINAS 358 A LA 372 DE LAS BASES.	EN EL LISTADO MENCIONADO SE ENCUENTRAN PARTIDAS QUE EN EL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" NO SE ENCUENTRAN Y, POR LO TANTO, TAMPOCO SUS FICHAS TÉCNICAS. LAS PARTIDAS DE INTERÉS PARA MI REPRESENTADA Y QUE NO ESTÁN EN EL ANEXO 1 SON LAS SIGUIENTES: 25, 36, 38, 39, 40, 45, 58, 65, 71 Y 82. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR QUÉ PROCEDERÁ CON ESTAS PARTIDAS Y SI PUBLICARÁN SUS FICHAS TÉCNICAS. FAVOR DE ACLARAR.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
7	ANEXO 29 PÁGINAS 380 A 382 DE LA CONVOCATORIA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR A LOS PROVEEDORES QUE OFERTEN EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO TENER UN PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE MÁXIMO 90 DÍAS NATURALES. LO ANTERIOR A RAZÓN DE LA ALTA DEMANDA Y EL AÚN NO REESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DE LOS FABRICANTES Y EMPRESAS ENCARGADAS DE LOGÍSTICA DEBIDO A LAS RESTRICCIONES POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR	DEBERA ATENDER LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CADA BIEN CONFORME AL ANEXO 29 O BIEN SEÑALAR LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS A LAS QUE SE REFIERE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SARSCOV-2 Y SUS VARIANTES, ASÍ COMO EL DESABASTO EN SEMICONDUCTORES LO CUAL AFECTA EL TIEMPO DE ENTREGA. ¿SE ACEPTA?	

**LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES
CUESTIONAMIENTOS:**

4	NUMERAL 4.5 INCISO G) CONSTANCIAS DE ADEUDOS CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: • IMPUESTO PREDIAL, • IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, • IMPUESTO SOBRE NÓMINA, • IMPUESTO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, • IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, • IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, • DERECHOS SOBRE SUMINISTRO DE AGUA, (EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). LAS CONSTANCIAS DEBEN SER ACREDITADAS CON EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL LICITANTE. PARA EL CASO DE LAS CONSTANCIAS DE ADEUDO RELATIVO AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y/O PREDIAL, LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS MISMAS DEBERÁ SER DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PARA LAS DEMÁS CONSTANCIAS, LA FECHA DE EXPEDICIÓN NO DEBE SER MAYOR A 60 DÍAS NATURALES	PARA CUMPLIR CON LAS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO, CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES, SOLICITAMOS SE ACEPTÉ PRESENTAR LAS MISMAS, EMITIDAS POR MEDIOS REMOTOS (ELECTRÓNICO) EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, YA QUE ÉSTAS, CUENTAN CON LA MISMA VALIDÉZ OFICIAL, SIENDO LA MISMA DEPENDENCIA LA QUE LAS EMITE TANTO EN FÍSICO COMO EN MEDIOS DIGITALES, LO CUAL GARANTIZA LA VERACIDAD DE DICHAS CONSTANCIAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PERO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LAS CONSTANCIAS ORIGINALES Y PARA LA APERTURA DE PROPUESTA DEBERÁ PRESENTAR LOS RECIBOS DE ACUSE ORIGINALES
---	--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL		
5	NUMERAL 4.5.1 INCISO G) SOLICITUD DE GRADO NACIONAL	DICHO GRADO PUEDE SER INFERIOR AL 50% O EN SU CASO OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA ESTE, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.
6	NUMERAL 4.5.1 INCISO N) DOMICILIO FISCAL	EN CASO QUE NUESTRO DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ¿LA CONVOCANTE REQUIERE DE ALGÚN DOCUMENTO O CARTA DONDE SE MANIFIESTE NUESTRO DOMICILIO O UN SIMPLE ESCRITO DE NO APLICA?	DEBERÁ PRESENTAR LO SOLICITADO EN EL INCISO N) DEL NUMERAL 4.5.1 DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO FIRMADO POR LA PERSONA FACULTADA, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LA (S) PERSONA (S) AUTORIZADA (S) PARA ESE EFECTO. NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO SI EL LICITANTE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
7	NUMERAL 4.5.1 INCISO R)	¿ENTENDEMOS QUE EL FORMATO 25 MANIFESTACIÓN MIPYME ÚNICAMENTE APLICA PARA EMPRESAS QUE PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
8	NUMERAL 4.5.1 INCISO R)	¿ENTENDEMOS QUE EN DICHO PUNTO SOLO SE REQUIERE INFORMACIÓN PARA EMPRESAS QUE PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA, Y EN CASO DE NO PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON NINGUNA OTRA EMPRESA PODEMOS INTEGRAR MANIFIESTO QUE REFIERA QUE DICHA INFORMACIÓN NO APLICA PARA NUESTRA PROPUESTA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

9	NUMERAL 4.7.1.1 PROPUESTA TÉCNICA	"EN CASO DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA PARTIDA, LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INTEGRARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS DE LA PRIMERA PARTIDA Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA COMPLEMENTAR LAS PARTIDAS EN LAS QUE SE PARTICIPARÁ". ENTENDEMOS QUE LO REQUERIDO ES INTEGRAR LA PROPUESTA TÉCNICA CON: 1. ANEXO TÉCNICO 2. CATÁLOGOS 3. MANUALES 4. GUÍA MECÁNICA EN CASO DE APLICAR ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.7.1.1 DEBERÁ PRESENTAR UN ANEXO 19 POR PARTIDA OFERTADA ASÍ COMO SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA COMPLETAR LAS PARTIDAS EN LAS QUE SE PARTICIPARÁ.
10	NUMERAL 4.7.1.1 PROPUESTA TÉCNICA	EN CASO QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR TENGA RESPUESTA EN SENTIDO NEGATIVO, Y SE REFIERA A QUE DEBERÁ INTEGRARSE CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL 4.7.1 AL 4.7.1.23 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL HECHO QUE SE TENGAN QUE IMPRIMIR LOS MISMO DOCUMENTOS TANTAS VECES SEAN NECESARIOS POR CADA PARTIDA, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL IMPACTO CLIMÁTICO QUE SE PRODUCE CON LAS LICITACIONES FÍSICAS. Y SE NOS PERMITA HACER LA IMPRESIÓN DE CADA REQUISITO UNA VEZ EL CUAL SE ENLISTE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE RESPALDE DE MANERA CLARA, CONCISA Y LEGIBLE. ¿SE ACEPTA?	NO ES CLARA SU PREGUNTA, FAVOR DE REPLANTEAR
11	NUMERAL 4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICADOS	ENTENDEMOS QUE EN EL ANEXO 1.5 DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO "CUMPLIMIENTO DE NORMAS", SOLO SE SEÑALARÁN LAS NORMAS QUE APLIQUEN A LOS BIENES OFERTADOS, INCLUYENDO NORMAS DE CADA FICHA TÉCNICA NACIONALES E INTERNACIONALES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBE TOMAR EN CUENTA LO QUE EN ESE PUNTO INDICA EN ESPECÍFICO POR TIPO DE EQUIPO ADEMÁS DE LO MENCIONADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS A OFERTAR
12	NUMERAL 4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICADOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS DOCUMENTOS COMO REGISTROS SANITARIOS, D.O.F. Y CERTIFICADOS DE CALIDAD PUEDAN SER ENTREGADOS POR FAMILIA, ESTO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL IMPACTO CLIMÁTICO QUE SE PRODUCE CON LAS LICITACIONES FÍSICAS. IDENTIFICANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE RESPALDE DE MANERA CLARA, CONCISA Y LEGIBLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN EMBARGO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SANITARIOS NO ESTÉN REFERENCIADOS SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA

			DESECHARA LA PROPUESTA
13	NUMERAL 4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PERÍODO DE LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO DE 3 A 5 AÑOS, YA QUE SOLICITA CANCELACIÓN DE FIANZAS MUCHOS DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS SIGUEN VIGENTES LO CUAL IMPIDE OBTENER LA CANCELACIÓN DE ESTAS FIANZAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
14	NUMERAL 4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE PUEDA PRESENTAR LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON SU LIBERACIÓN DE FIANZA, CARTA DE CUMPLIMIENTO, FACTURAS, NOTAS Y/O CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN, NOTAS DE REMISIÓN O REPORTES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES.
15	ANEXO 19	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL ANEXO 19 PUEDA SER PRESENTANDO DE FORMA EDITABLE EN WORD, YA QUE EN CASOS DONDE LA PROPUESTA TÉCNICA ES AMPLIA EXCEL NO PERMITE SE PUEDA PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE MANERA COMPLETA Y ASÍ SE EVITE TENER RENGLONES CON INFORMACIÓN CORTADA, ¿SE ACEPTA?	SE PROPORCIONARÁ EL ANEXO 19 EN DIGITAL

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

16	ANEXO 20	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PRESENTE DICHO FORMATO ÚNICAMENTE CON LA DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN PARA MEJOR SOLVENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.
----	----------	---	--

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

17	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 61 HISTEROSCOPIO DESCRIPCIÓN PUNTOS 1 AL 8 PÁGINA 120 DE LAS BASES.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL ENDOSCOPIO QUE REQUIEREN ES UN HISTEROSCOPIO COMPACTO CON IRRIGACIÓN CONTINUA, CON DIÁMETRO EXTERIOR MÍNIMO DE 3.8 MM, CON CANAL DE TRABAJO RECTO PARA INSTRUMENTOS DE HASTA 5 CHARR, DIRECCIÓN VISUAL DE 30°, LONGITUD TOTAL DE 352 MM, LONGITUD ÚTIL DE 217 MM, O ES UN ENDOSCOPIO QUE SEA COMPATIBLE CON CAMISAS DE HISTEROSCOPIA YA EXISTENTES EN EL HOSPITAL. FAVOR DE ACLARAR. EN CASO DE SER UN ENDOSCOPIO QUE DEBA SER COMPATIBLE CON CAMISAS EXISTENTES EN EL HOSPITAL, SE SOLICITA INDICAR LA MARCA	SE REQUIERE A LO DESCRITO EN LA FICHA, NO ES UN BIEN QUE DEBA SER COMPATIBLE CON UNA TORRE DE ENDOSCOPIA
----	---	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

18	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 61 HISTEROSCOPIO ACCESORIOS PUNTOS 1 AL 2 PÁGINA 120 DE LAS BASES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REQUIEREN OFERTAR LAS DOS OPCIONES: CESTA DE MALLA METÁLICA Y EL CONTENEDOR. LAS DOS OPCIONES CUMPLEN LA MISMA FUNCIÓN Y SE INCREMENTARÍA DE FORMA INNECESARIA EL COSTO DEL EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR.	SE REFIERE A INCLUIR EL CONTENEDOR Y LA CHAROLA PARA ESTERILIZAR EL HISTEROSCOPIO CON SUS ADITAMENTOS
19	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 61 HISTEROSCOPIO PÁGINA 120 DE LAS BASES	EN CASO DE QUE EL EQUIPO REQUERIDO SEA UN HISTEROSCOPIO COMPACTO, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE SEA OBLIGATORIO OFERTAR UNA PINZA DE AGARRE Y UNA TIJERA DE 5 CHARR, CON EL FIN DE QUE EL EQUIPO SEA FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION TECNICA NUMERO 4.
20	PARTIDA: TODAS PUNTO: S/P	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PODER CONSIDERAR TOLERANCIAS DE UN RANGO DE +/- 10 % EN LAS DIMENSIONES GENERALES DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LOS DESCRITO EN LAS FICHAS TECNICAS. O PREGUNTAR EN ESPECÍFICO
21	PARTIDA: 123, SET DE CIRUGÍA MENOR, PUNTO: 28	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, ESTRIADO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 MM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
22	PARTIDA: 125, SET DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES, PUNTO: 10	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 40°, LONGITUD DE 190 MM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
23	PARTIDA: 127, SET DE ORTOPEDIA FINA PEDIÁTRICA, PUNTO: 5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, ESTRIADO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 MM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
24	PARTIDA: 130, SET DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL, PUNTO: 56	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: CÁNULA FRAZIER CAL. 12 FR. ANGULADA. LONGITUD 19 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
25	PARTIDA: 134, SET DE CESÁREA, PUNTO: 3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE, 27 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
26	PARTIDA: 136, SET DE CIRCUNSIÓN, PUNTO: 14	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 MM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
27	PARTIDA: 136, SET DE CIRCUNSIÓN, PUNTO: 15	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
28	PARTIDA: 136, SET DE CIRCUNSIÓN, PUNTO: 16	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 MM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
29	PARTIDA: 139, SET DE CIRUGÍA GENERAL BÁSICO, PUNTO: 38	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: PINZA HALSTED MOSQUITO,	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CON DIENTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 125 MM. ¿SE ACEPTA?	
30	PARTIDA: 139, SET DE CIRUGÍA GENERAL BÁSICO, PUNTO: 39	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 125 MM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CON DIENTES
31	PARTIDA: 140, SET DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA, PUNTO: 23	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: CÁNULA FRAZIER, CAL. 10 FR. ANGULADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
32	PARTIDA: 140, SET DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA, PUNTO: 24	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: CÁNULA FRAZIER CAL. 12 FR. ANGULADA. LONGITUD 19 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
33	PARTIDA: 141, SET DE CIRUGÍA INTESTINAL, PUNTO: 36	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACLARE EL MODELO, DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA PINZA JARETERA, CON EL FIN DE PROPORCIONAR EL INSTRUMENTAL ADECUADO REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN.	SE ELIMINA EL PUNTO
34	PARTIDA: 144, SET DE CIRUGÍA PLÁSTICA, PUNTO: 22	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 3.5 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
35	PARTIDA: 144, SET DE CIRUGÍA PLÁSTICA, PUNTO: 24	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 7.5 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
36	PARTIDA: 144, SET DE CIRUGÍA PLÁSTICA, PUNTO: 60	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: CÁNULA FRAZIER, CAL. 10 FR. ANGULADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
37	PARTIDA: 144, SET DE CIRUGÍA PLÁSTICA, PUNTO: 61	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: CÁNULA FRAZIER CAL. 12 FR. ANGULADA. LONGITUD 19 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
38	PARTIDA: 144, SET DE CIRUGÍA PLÁSTICA, PUNTO: 62	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: CÁNULA FRAZIER, CAL. 10 FR. ANGULADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
39	PARTIDA: 160, SET DE SUTURA ADULTO, PUNTO: 7	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR: CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE, DIMENSIONES: 26 X 26 X 5 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

19. - COMERLAT, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXOS DE LAS BASES	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS ANEXOS EN FORMATO EDITABLE DADO QUE ALGUNOS SE ENCUENTRAN COMO IMAGEN. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

2	4.5. INCISO G.	PARA EL CASO DE LAS CONSTANCIAS DE ADEUDO RELATIVO AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y/O PREDIAL, LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS MISMAS DEBERÁ SER DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PARA LAS DEMÁS CONSTANCIAS, LA FECHA DE EXPEDICIÓN NO DEBE SER MAYOR A 60 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. AL RESPECTO, ATENTAMENTE LE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR COPIA SIMPLE DE DICHAS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO, SOBRE LA TENENCIA DE VEHÍCULOS, TODA VEZ QUE LOS ORIGINALES SE ENTREGARÁN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022, EMITIDA POR ESA DEPENDENCIA. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ PRESENTAR ACUSE DE TRÁMITE Y PARA EL CASO DE SER ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO ORIGINAL
3	ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 2 "ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO". 3. CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD:	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE AL COMPARTIMENTO PARA EL CARTUCHO ESTERILIZANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA
4	ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 2 "ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO". 5. CON ALL MENOS LOS SIGIENTES CICLOS DE ESTERILIZACIÓN: 5.1. PARA INSTRUMENTOS GENERALES, 5.2. PARA INSTRUMENTOS HUECOS Y NO HUECOS 5.3. PARA INSTRUMENTOS GENERALES CON LÚMENES RÍGIDOS Y FLEXIBLES 5.4. CON CAPACIDAD DE ESTERILIZAR ENDOSCOPIOS RÍGIDOS Y SEMIRRÍGIDOS Y FLEXIBLES CON LÚMENES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, NOS PERMITA OFRECER UNA ESTERILIZADORA CON TRES DIFERENTES PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN: GENERAL, RÁPIDA Y AVANZADO. EL PROGRAMA GENERAL ESTÁ DISEÑADO PARA ESTERILIZAR LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS GENERALES DE UN SOLO CANAL, DE LONGITUD MODERADA CON LÚMENES RÍGIDOS Y FLEXIBLES. EL PROGRAMA RÁPIDO PROPORCIONA UNA ESTERILIZACIÓN MÁS CORTA PARA CARGAS DE ESTERILIZACIÓN SUPERFICIAL Y EL AVANZADO ESTÁ DISEÑADO PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS CON LÚMENES LARGOS Y RÍGIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
5	ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 2 "ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER UNA IMPRESORA INTEGRADA O EXTERNA ALFANUMÉRICA, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA IMPRIMIR LO SOLICITADO EN LOS	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	HIDRÓGENO". 9. IMPRESORA INTEGRADA ALFANUMÉRICA TÉRMICA, CON POSIBILIDAD DE IMPRIMIR AL MENOS LOS SIGUIENTE:	PUNTOS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Y 9.5. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
6	ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 2 "ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO". 11. SISTEMA DE ANCLAJE SÍSMICO PARA EVITAR QUE EL EQUIPOS SE DESPLACE EN CASO DE SISMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA ESTERILIZADORA CON CUATRO RUEDAS, CON SEGURO PARA DOS, CUATRO O FRENO CENTRAL PARA SU FÁCIL MOVILIDAD Y SEGURIDAD PARA MANTENERLO FIJO AL SUELO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
7	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16 "SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS". 1.5. ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN USB	ENTENDEMOS QUE SE ESTÁ SOLICITANDO UNA TORRE DE ENDOSCOPIA CON ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN USB O EN UNA MEMORIA EXTERNA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, SE REQUIERE QUE EL VIDEOPROCESADOR PUEDA ALMACENAR IMÁGENES EN USB
8	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16 "SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS". 2.2. CONTROL DE LUZ AUTOMÁTICO	ENTENDEMOS QUE EL CONTROL DE LUZ TAMBIÉN PUEDE SER TOMADO COMO EL CONTROL DEL BRILLO DE LA PROPIA LÁMPARA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REQUIERE CONTROL AUTOMÁTICO DE LA INTENSIDAD DE LUZ, QUE NO ES LO MISMO QUE BRILLO.
9	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16 "SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS". 2.6. VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE 6 AÑOS O MAYOR EN ILUMINACIÓN POR LED Y UNA LÁMPARA EXTRA PARA TECNOLOGÍA DE XENÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO LÁMPARA XENÓN CON LÁMPARA DE EMERGENCIA HALÓGENA 12V Y 35W CON TIEMPO DE VIDA ÚTIL APROXIMADO DE 500 HORAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16 "SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS". 3.5. ENTRADAS DVI, DISPLAY PORT, COMPUESTO, S-VIDEO, HDMI	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PODAMOS OFRECER UN MONITOR CON ENTRADAS SDI, DVI, DE VIDEO COMPUESTO, Y/C Y HD15, CON EL FIN DE NO LIMITAR A MI REPRESENTADA CON SU PARTICIPACIÓN EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
11	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16 "SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS". 4.5. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTEGRADA AL CARRO PARA TODOS LOS COMPONENTES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE, LE PERMITA A MI REPRESENTADA OFERTAR UN SUPRESOR DE PICOS O NO BREAK DE MANERA EXTERNA QUE SE PUEDA INTEGRAR AL CARRO Y QUE TENGA LOS PUERTOS SUFICIENTES PARA LOS EQUIPOS DE LA TORRE DE ENDOSCOPIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16 "SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS". 7.1. FLUJO 0- COMO MÍNIMO 550ML/M	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA BOMBA DE IRRIGACIÓN CON FLUJO DE MÍNIMO 0ML/MIN (APAGADO) A 750ML/MIN. SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

13	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 17 "VIDEOGASTROSCOPIO". 1.1 DE ALTA DEFINICIÓN	ENTENDEMOS QUE LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL TUBO DE VIDEOGASTROSCOPIO SE DEBE VISUALIZAR EN ALTA DEFINICIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBE SER DE ALTA DEFINICIÓN LA IMAGEN QUE GENERE EL VIDEOGASTROSCOPIO
14	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 17 "VIDEOGASTROSCOPIO". 1.4. RANGO DE OBSERVACIÓN DE 2 O MENOR A 100 MM $\pm$ 10%	ENTENDEMOS POR RANGO DE OBSERVACIÓN QUE SE REFIERE A "PROFUNDIDAD DE CAMPO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA
15	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 18 "VIDEOCOLONOSCOPIO". 1.1 DE ALTA DEFINICIÓN	ENTENDEMOS QUE LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL TUBO DE VIDEOCOLONOSCOPIO SE DEBE VISUALIZAR EN ALTA DEFINICIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBE SER DE ALTA DEFINICIÓN LA IMAGEN QUE GENERE EL VIDEOCOLONOSCOPIO
16	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 18 "VIDEOCOLONOSCOPIO". 1.4. RANGO DE OBSERVACIÓN DE 2 O MENOR A 100 MM $\pm$ 10%	ENTENDEMOS POR RANGO DE OBSERVACIÓN QUE SE REFIERE A "PROFUNDIDAD DE CAMPO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
17	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 18 "VIDEOCOLONOSCOPIO". 1.7. DIÁMETRO EXTERNO DEL EXTREMO DISTAL NO MAYOR A 13 MM 1.8. DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN NO MAYOR A 13.2 MM	ENTENDEMOS QUE EL NUMERAL 1.7. Y EL 1.8. DE LA FICHA DE LA PARTIDA 18 SE ENCUENTRAN INVERTIDOS, YA QUE EL DIÁMETRO EXTERNO DEL EXTREMO DISTAL, AL SER LA CIRCUNFERENCIA MÁS EXTERNA, DEBE SER MAYOR AL DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE ATENDER PRESICIÓN TÉCNICA 10
18	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 18 "VIDEOCOLONOSCOPIO". 1.7. DIÁMETRO EXTERNO DEL EXTREMO DISTAL NO MAYOR A 13 MM	SE SOLICITA DE MANERA MUY ATENTA A LA AMABLE CONVOCANTE, SE PUEDA SOLICITAR UN DIÁMETRO EXTERNO DEL EXTREMO DISTAL NO MAYOR A 13.2 MM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	FAVOR DE ATENDER PRESICIÓN TÉCNICA 10
19	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 18 "VIDEOCOLONOSCOPIO". 1.8. DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN NO MAYOR A 13.2 MM	SE SOLICITA DE MANERA MUY ATENTA A LA AMABLE CONVOCANTE, SE PUEDA SOLICITAR UN DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN NO MAYOR A 13 MM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	FAVOR DE ATENDER PRESICIÓN TÉCNICA 10
20	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 19 "VIDEODUODENOSCOPIO". 1.3. RANGO DE OBSERVACIÓN DE 5 O MENOR A 60 MM $\pm$ 10%	ENTENDEMOS POR RANGO DE OBSERVACIÓN QUE SE REFIERE A "PROFUNDIDAD DE CAMPO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
21	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16, 17, 18 Y 19.	ENTENDEMOS QUE SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE LAS PARTIDAS 16, 17, 18 Y 19. YA QUE CADA LICITANTE OFERTARÁ LOS EQUIPOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
22	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 116 "SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN". 4. FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CON BASE ESMALTADA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y CON MENOS PUNTO DE UNIÓN, LO QUE AYUDA A REDUCIR LAS POSIBLES AMENAZAS DE PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS Y QUE EVITE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

38	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 14" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 16.3 TABLA DE TENDENCIAS DONDE SE INDIQUE EL TIEMPO PARA CADA MUESTRA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARÉ A QUÉ TIPO DE MUESTRA SE REFIERE. FAVOR DE ACLARAR.	MUESTRA SE REFIERE A LA MEDICIÓN O EVENTO CON REGISTRO DE HORA
39	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 8" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO..	ENTENDEMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTA CARACTERISTICA BASTARA CON SEÑALAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA QUE LA CENTRAL DE MONITOREO PERMITE COMUNICACIÓN VÍA PROTOCOLO HL7 ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PERO DEBE REFERENCIAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 18
40	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 10" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.	ENTENDEMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTA CARACTERISTICA BASTARA CON SEÑALAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA QUE LA CENTRAL DE MONITOREO PERMITE COMUNICACIÓN VÍA PROTOCOLO HL7 ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PERO DEBE REFERENCIAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 18
41	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 12" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.	ENTENDEMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTA CARACTERISTICA BASTARA CON SEÑALAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA QUE LA CENTRAL DE MONITOREO PERMITE COMUNICACIÓN VÍA PROTOCOLO HL7 ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PERO DEBE REFERENCIAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 18



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA"

42	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 14" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.	ENTENDEMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTA CARACTERÍSTICA BASTARÁ CON SEÑALAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA QUE LA CENTRAL DE MONITOREO PERMITE COMUNICACIÓN VÍA PROTOCOLO HL7 ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PERO DEBE REFERENCIAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 18
43	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 9. PUNTO 1.19.8. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AHSTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS FABRICANTES SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CAPAZ DE DEMOSTRAR 12 DERIVACIONES CON CABLE SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EL ACCESORIO NECESARIO PARA REALIZAR ESTA MEDICIÓN ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE MENCIONAR CON CUANTOS LATIGUILLOS SU PROPUESTA NOS DA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.19.8
44	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 11. PUNTO 1.20.8. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AHSTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS FABRICANTES SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CAPAZ DE DEMOSTRAR 12 DERIVACIONES CON CABLE SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EL ACCESORIO NECESARIO PARA REALIZAR ESTA MEDICIÓN ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE MENCIONAR CON CUANTOS LATIGUILLOS SU PROPUESTA NOS DA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.20.8
45	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 13. PUNTO 1.21.8. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AHSTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS FABRICANTES SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CAPAZ DE DEMOSTRAR 12 DERIVACIONES CON CABLE SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EL ACCESORIO NECESARIO PARA REALIZAR ESTA MEDICIÓN ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE MENCIONAR CON CUANTOS LATIGUILLOS SU PROPUESTA NOS DA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.21.8
46	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 15. PUNTO 1.21.8. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AHSTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS FABRICANTES SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CAPAZ DE DEMOSTRAR 12 DERIVACIONES CON CABLE SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EL ACCESORIO NECESARIO PARA REALIZAR ESTA MEDICIÓN ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE MENCIONAR CON CUANTOS LATIGUILLOS SU PROPUESTA NOS DA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.21.8
47	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 8, 10, 12 Y 14.	ENTENDEMOS QUE, PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE TODAS LAS CENTRALES DE MONITOREO, ESTAS 4 PARTIDAS SERÁN ADJUDICADAS A 1 SOLO PROVEEDOR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO LA PARTIDA 8 Y PARTIDA 9 DEBEN SER ADJUDICADAS AL MISMO PROVEEDOR Y ASÍ 10 Y 11; 12 Y 13 Y 14 Y 15.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

23	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 116 "SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN". 9. CONTROL DE TEMPERATURA DE RANGO DE 5° A 200°C	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SELLADORA DE BOLSAS CON CONTROL DE TEMPERATURA DE RANGO DE 100° A 200° C, YA QUE ÉSTE ES EL RANGO DE UTILIDAD PARA SELLAR CUALQUIER TIPO DE BOLSA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
24	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 116 "SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN". 10. PANTALLA TÁCTIL LCD	SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFRECER UNA SELLADORA DE BOLSAS CON PANTALLA LCD Y TÁCTIL O CON BOTONES PARA EL CONTROL DE LAS OPCIONES QUE PERMITE LA PANTALLA, YA QUE EL USO DE LOS BOTONES NO IMPIDE AL EQUIPO HACER USO DE SU FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES
25	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 116 "SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN". 10.1. DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE SELLADO DESEADA Y DE TRABAJO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA A MI DEPENDENCIA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "DESPLIEGUE DE TEMPERATURA PREDEFINIDA Y TEMPERATURA REAL". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
26	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 116 "SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN". 11. DIMENSIONES ALTO X LARGO X ANCHO (23 CM X 62 CM X 26 CM)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA SELLADORA DE BOLSAS CON DIMENSIONES DE ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA DE 580MM X 255MM X 133MM, EL CUAL TAMBIÉN ES UN TAMAÑO BASTANTE OPTIMIZADO PARA LOS ESPACIOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y PROVOCA LA DISMINUCIÓN DE SU PESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
27	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 8 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3 MB	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES, SUFICIENTE PARA APRECIAR TODOS LOS DATOS HEMODINAMICOS DEL PACIENTE CON EXACTITUD ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER PRECISION TÉCNICA 6
28	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 10 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3 MB	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES, SUFICIENTE PARA APRECIAR TODOS LOS DATOS HEMODINAMICOS DEL PACIENTE CON EXACTITUD ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER PRECISION TÉCNICA 6
29	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 12 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3 MB	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES, SUFICIENTE PARA APRECIAR TODOS LOS DATOS HEMODINAMICOS DEL PACIENTE CON EXACTITUD ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER PRECISION TÉCNICA 6
30	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 14 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3 MB	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES, SUFICIENTE PARA APRECIAR TODOS LOS DATOS HEMODINAMICOS DEL PACIENTE CON EXACTITUD ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER PRECISION TÉCNICA 6
31	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 8"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PROTOCOLO DE CONEXIÓN SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 7.1. CONEXIÓN MEDIANTE PROTOCOLO 10/100 INCLUYE TODAS LAS TARJETAS DE RED Y SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS MONITORES A LA CENTRA	FABRICANTE SIEMPRE QUE PERMITA REALIZAR TODAS LAS CONEXIONES, IMPORTACIÓN DE DATOS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	
32	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 10" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 7.1. CONEXIÓN MEDIANTE PROTOCOLO 10/100 INCLUYE TODAS LAS TARJETAS DE RED Y SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS MONITORES A LA CENTRA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PROTOCOLO DE CONEXIÓN SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE PERMITA REALIZAR TODAS LAS CONEXIONES, IMPORTACIÓN DE DATOS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
33	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 12" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 7.1. CONEXIÓN MEDIANTE PROTOCOLO 10/100 INCLUYE TODAS LAS TARJETAS DE RED Y SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS MONITORES A LA CENTRA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PROTOCOLO DE CONEXIÓN SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE PERMITA REALIZAR TODAS LAS CONEXIONES, IMPORTACIÓN DE DATOS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
34	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 14" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 7.1. CONEXIÓN MEDIANTE PROTOCOLO 10/100 INCLUYE TODAS LAS TARJETAS DE RED Y SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS MONITORES A LA CENTRA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PROTOCOLO DE CONEXIÓN SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE PERMITA REALIZAR TODAS LAS CONEXIONES, IMPORTACIÓN DE DATOS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
35	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 8" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 16.3 TABLA DE TENDENCIAS DONDE SE INDIQUE EL TIEMPO PARA CADA MUESTRA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARÉ A QUÉ TIPO DE MUESTRA SE REFIERE. FAVOR DE ACLARAR.	MUESTRA SE REFIERE A LA MEDICIÓN O EVENTO CON REGISTRO DE HORA
35	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 10" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 16.3 TABLA DE TENDENCIAS DONDE SE INDIQUE EL TIEMPO PARA CADA MUESTRA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARÉ A QUÉ TIPO DE MUESTRA SE REFIERE. FAVOR DE ACLARAR.	MUESTRA SE REFIERE A LA MEDICIÓN O EVENTO CON REGISTRO DE HORA
37	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 12" CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS" 16.3 TABLA DE TENDENCIAS DONDE SE INDIQUE EL TIEMPO PARA CADA MUESTRA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARÉ A QUÉ TIPO DE MUESTRA SE REFIERE. FAVOR DE ACLARAR.	MUESTRA SE REFIERE A LA MEDICIÓN O EVENTO CON REGISTRO DE HORA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

48	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 8, 10, 12 Y 14.	DEBIDO A MÚLTIPLES FACTORES MUNDIALES QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OTORQUE UN PERIODO DE 60 DÍAS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ESTABLECE UN TIEMPO DE 45 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA
49	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 8, 10, 12 Y 14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE UNA RED INSTALADA EN LAS ZONAS DONDE SE INSTALARAN LAS CENTRALES DE MONITOREO, FAVOR DE ACLARAR.	PARA ESO SE ACUDIÓ A LA VISITA AL H.G. CUAJIMALPA, YA ESTA LA RED MONTADA
50	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16, 17, 18 Y 19	ENTENDEMOS QUE CON EL FIN DE ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS ENDOSCOPIOS SOLICITADOS CON LA TORRE DE ENDOSCOPIA ESTAS 4 PARTIDAS SERÁN ADJUDICADAS A UN SOLO LICITANTE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO LAS PARTIDAS 16, 17, 18 Y 19 DEBERÁN SER ADJUDICADAS AL MISMO PROVEEDOR
51	ANEXO TECNICO. 4.7.1.5. GUÍAS MECANICAS 4.7.1.6. CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN	FAVOR DE ACLARAR QUE LAS GUÍAS MECÁNICAS Y EL CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DEBERÁN SER ENTREGADAS SOLAMENTE POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, TODOS LOS OFERENTES DEBERÁN ENTREGAR LAS GUÍAS MECÁNICAS Y EL CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN
52	ANEXO TECNICO 4.7.1.7. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS PERMITA ENTREGAR CURRÍCULUM EMPRESARIAL CON LISTA DE CLIENTES DONDE SE HAYA VENDIDO BIENES DE LA MISMA NATURALEZA (EQUIPO MÉDICO, DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL O MOBILIARIO SEGÚN APLIQUE) CON AL MENOS 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y BASTE CON ENTREGARSE UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO O EL CONTRATO CELEBRADO DE DICHA VENTA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITÓ AL MENOS UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
53	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 43 "CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y DIRIGIR SU FLUJO. SISTEMA DE INSTALACIÓN FIJA". 1. PANEL DE CONTROL DIGITAL CON DISPLAY LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR CON INDICADOR DE LA VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR, CONTADOR DE HORAS DE TRABAJO DE LÁMPARA UV Y DEL MOTOR. .	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO TIEMPO ACUMULATIVO DE LA LÁMPARA UV Y DEL VENTILADOR, SIENDO ESTA LA DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO EN EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 43 "CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y DIRIGIR SU FLUJO. SISTEMA DE INSTALACIÓN FIJA". 6. FILTRO PARA RETENCIÓN DE PARTÍCULAS DE EIFICENCIA	ENTENDEMOS QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA ES ULPA Y NO HULPA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA, HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICLE AIR) Y ULPA (ULTRA LOW PENETRATION AIR)



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	MÍNIMA DE 99.995% (HEPA O HULPA).		
55	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 43 "CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y DIRIGIR SU FLUJO. SISTEMA DE INSTALACIÓN FIJA". 7. RETENCIÓN DE PARTÍCULAS MAYOR O IGUAL A 0.3 MICRAS.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: BLOQUEO DE FLUJO DE AIRE PATENTADO EN EL BORDE SUPERIOR Y EN AMBOS BORDES DE LA VENTANA FRONTAL PARA ELIMINAR LA EXPOSICIÓN DE MICROORGANISMOS. YA QUE ASÍ LO DESCRIBE EL FABRICANTE Y ES LA MISMA FUNCIÓN DE LO REQUERIDO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
56	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 43 "CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y DIRIGIR SU FLUJO. SISTEMA DE INSTALACIÓN FIJA" 17.1 EXTERNAS: ALTURA 120 CM (CON BASE) X FRENTE 125 CM X FONDO DE 85 CM, +- 5CM.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y DIRIGIR SU FLUJO. SISTEMA DE INSTALACIÓN FIJA. CON MEDIDAS EXTERNAS DE 110*79*220 CM SIN DO CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS COMPETIDORES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
57	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 43 "CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y DIRIGIR SU FLUJO. SISTEMA DE INSTALACIÓN FIJA" 17.2 INTERNAS: ALTURA 190 CM (CON BASE) X FRENTE 80 CM X FONDO DE 60 CM, +- 5CM.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y DIRIGIR SU FLUJO. SISTEMA DE INSTALACIÓN FIJA. CON MEDIDAS EXTERNAS DE 68*90*61 CM SIN DO CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS COMPETIDORES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
58	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 52 "REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS". 1.1 CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REFRIGERADOR QUE AHORA SIDO PRECONFIGURADO PARA OPERAR A 2 8°C EN LA FÁBRICA Y YA NO ES NECESARIO AJUSTAR LA TEMPERATURA, SIENDO ESTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE
59	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 52 "REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS". 4.1 LISA EN PARTE INTERNA.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA IMAGEN, YA QUE AL NO TENER NADA LA PUERTA NO LO MENCIONA EL CATÁLOGO/FICHA/MANUAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA CON UNA IMAGEN CLARA Y NÍTIDA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES
60	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 52 "REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS". 4.2 SIN MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA IMAGEN, YA QUE, AL NO CONTAR CON MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES EN LA PUERTA, NO LO MENCIONA EL CATÁLOGO/FICHA/MANUAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA CON UNA IMAGEN CLARA Y NÍTIDA, QUE INCLUYA EL DETALLE SIN MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES
61	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 52 "REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS". 7.3 ALAMBRE DE ACERO.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NO LIMITAR NUESTRA PARTICIPACIÓN OFERTANDO ALAMBRES RECUBIERTOS DE POLIÉSTER SIENDO ESTA UNA CARACTERÍSTICA DEL FABRICANTE, PARA NO LIMITARNOS EN LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

62	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 52 "REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS". 7.4 CUBIERTAS CON PINTURA EPÓXICA O REVESTIMIENTO DE POLIETILENO.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NO LIMITE NUESTRA PARTICIPACIÓN OFERTANDO ALAMBRES RECUBIERTOS DE POLIESTER SIENDO ESTA UNA CARACTERÍSTICA DEL FABRICANTE, PARA NO LIMITARNOS EN LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
63	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 52 "REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS". 11. BATERÍA RECARGABLE PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR: BATERÍA RECARGABLE Y DURACIÓN DE LA BATERÍA PARA EL SISTEMA DE ALARMAS (48 HORAS) SIENDO LA FALLA EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA PARTE DEL SISTEMA DE ALARMAS. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR; SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
64	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 118 "CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS" 2. SELLADO HERMÉTICO CERRADURA Y LLAVE.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA Y NO ALTERE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PODRÍA REPLANTEAR SU PREGUNTA YA QUE NO MENCIONA QUE OFERTA PARA EL SELLADO HERMÉTICO CERRADURA Y LLAVE.
65	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 118 "CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS". 3 CONTRUIDO DE MATERIAL RESISTENTE A CLIMAS TROPICALES.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO SEGÚN LA TECNOLOGÍA Y CAA¿RACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA. ¿SE ACEPTA?	PODRÍA REPLANTEAR SU PREGUNTA YA QUE NO MENCIONA QUE OFERTA PARA REEMPLAZAR EL MATERIAL RESISTENTE A CLIMAS TROPICALES.
66	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 120 "GRADILLAS GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLÁSTICOESTERILIZABLE PARA 40 TUBOS DE HASTA 22MM DE DIÁMETRO". 2. RECUBIERTA DE CADMIO O PLÁSTICO ESTERILIZABLE.	SOLICITAMOS A LA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GRADILLA DE ALAMBRE NIQUELADO, SIENDO ESTE UN MATERIAL SIMILAR AL CADMIO YA QUE TAMBIÉN ES UN MATERIAL DE TRANSICIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA DE ALAMBRE DE NIQUEL SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA RECUBIERTA DE PLÁSTICO ESTERILIZABLE PARA 40 TUBOS DE HASTA 22MM, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
67	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 120 "GRADILLAS GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLÁSTICOESTERILIZABLE PARA 40 TUBOS DE HASTA 22MM DE DIÁMETRO". 4. PARA TUBOS DE ENSAYO DE HASTA 22MM DE DIAMETRO +-1MM.	SOLICITAMOS A LA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GRADILLA PARA 40 TUBOS DE ENSAYO DE HASTA 27MM SIENDO ESTA UNA MEDIDA QUE OTORGA MAYOR ESPACIO A LOS TUBOS E INCLUSO TUBOS MÁS GRANDES. SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE 22MM Y 27 ES MUY GRANDE PELIGRAN LOS TUBOS AL TENER TANTO MOVIMIENTO
68	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 121 "GRADILLAS GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLÁSTICOESTERILIZABLE PARA 90 TUBOS DE HASTA 13 MM DE DIÁMETRO". 2.	SOLICITAMOS A LA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GRADILLA DE ALAMBRE NIQUELADO, SIENDO ESTE UN MATERIAL SIMILAR AL CADMIO YA QUE TAMBIÉN ES UN MATERIAL DE TRANSICIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA DE ALAMBRE DE NIQUEL SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA RECUBIERTA DE PLÁSTICO ESTERILIZABLE PARA 90 TUBOS DE HASTA 13MM, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	RECUBIERTA DE CADMIO O PLÁSTICO ESTERILIZABLE.		
69	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 121 "GRADILLAS GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLÁSTICOESTERILIZABLE PARA 90 TUBOS DE HASTA 13 MM DE DIÁMETRO". 3: PARA TUBOS DE ENSAYO DE HASTA 22MM DE DIAMETRO +-1MM.	SOLICITAMOS A LA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GRADILLA PARA 40 TUBOS DE ENSAYO DE HASTA 27MM SIENDO ESTA UNA MEDIDA QUE OTORGA MAYOR ESPACIO A LOS TUBOS E INCLUSO TUBOS MÁS GRANDES. SIN SER UNA LÍMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
70	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16 "1.3. MODO DE OBSERVACIÓN DE LUZ ESPECIAL O FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES ESPECTRALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO SEGÚN NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
71	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 16 "1.3. MODO DE OBSERVACIÓN DE LUZ ESPECIAL O FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES ESPECTRALES	ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE DE OFERTAR UN EQUIPO CON MODO QUE AYUDE A VISUALIZAR LOS PATRONES VASCULARES Y DE LA MUCOSA MÁS PEQUEÑOS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, PROCESAMIENTO DE IMÁGENES ESPECTRALES ES LA VISUALIZACIÓN DE LA MISMA IMAGEN DESDE DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA, CON LO QUE SE APRECIAN TEXTURAS Y DEMÁS DETALLES QUE NO SE VEN FÁCILMENTE DESDE UN SOLO PUNTO DE VISUALIZACIÓN
72	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 61 "HISTEROSCOPIO". 3. DIÁMETRO DE MÁXIMO 4 MM.	ENTENDEMOS QUE EL TAMAÑO DEL TELESCOPIO DEBE SER MENOR A 4 MM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBE TENER UN DIÁMETRO MENOR A 4MM
73	ANEXO 1. "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES". PARTIDA 61 "HISTEROSCOPIO". 8. OCULAR DE PEEK	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL TÉRMINO "OCULAR DE PEEK" PUEDA SER REFERENCIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE CADA FABRICANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CADA LICITANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL OCULAR DE PEEK ES LA MIRILLA DEL HISTEROSCOPIO
74	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA UN PLAZO DE ENTREGA DE AL MENOS 60 DÍAS, ESTO DEBIDO A MÚLTIPLES FACTORES MUNDIALES QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y CON LA FINALIDAD DE NO FAVORECER ÚNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE TENGAN ESTOS EQUIPOS EN STOCK. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁ APEGARSE A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 29
75	ANEXO 1.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE COMPARTIR LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE ESTOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR: 1,3,4,6,7,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38 39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,51,51.1,51.2,53,53.1,55,56,57,58	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Favor" and various initials.

		60,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,88 89,89.1,90,92,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 109,110,112,117,119,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 175,177,178,179,180,181,182,183,185,188. FAVOR DE ACLARAR	
--	--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

20. - SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA 114, PUNTO 1.1 SPO2 DE 0 AL 100%	DADO QUE UN VALOR DE 0 % ES SUMAMENTE BAJO Y NO COMPATIBLE CON LA VIDA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS RESPETUOSA PERMITA OFERTAR RANGOS DE MEDICIÓN DE 70 A 99 % CON UNA RESOLUCIÓN DE 1%, DICHS VALORES SON HABITUALES EN LAS CONSTANTES VITALES DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
2	PARTIDA 114, PUNTO 1.2 FRECUENCIA CARDIACA DE 25 BPM O MENOR A 240 BPM O MAYOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN TENGA A BIEN PERMITIR LA OFERTA DE RANGO DE 30 BPM A 240 BPM CON UNA RESOLUCIÓN DE +/- 1%. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
3	PARTIDA 114, PUNTO 1.3 ÍNDICE DE PERFUSIÓN 0.02% O MENOR A 20%.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN ESTE PUNTO SE OPCIONAL, PODRÍA ENTENDERSE QUE ESTÁ SUGIRIENDO CIERTA MARCA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
4	PARTIDA 114, PUNTO 1.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA 4 RPM O MENOR A 70 RPM O MAYOR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN ESTE PUNTO SE OPCIONAL, PODRÍA ENTENDERSE QUE ESTÁ SUGIRIENDO CIERTA MARCA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
5	PARTIDA 114, ACCESORIOS, PUNTO 1. ESTUCHE PARA TRANSPORTE Y CORDÓN PARA TRANSPORTE.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN ESTE PUNTO SOLICITA ESTUCHE DE TRASPORTE Y/O CORDÓN PARA EL ADECUADO TRANSPORTE. FAVOR DE CONFIRMAR	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

21. - RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.3. INCISO E) Y F)	¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE, Y LA DEMAS DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER RUBRICADA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
			AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE.
2	NUMERAL 4.5. INCISO G)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SI EL IMPUESTO PREDIAL Y EL IMPUESTO DEL AGUA NO LE APLIQUEN A MI REPRESENTADA POR QUE EL INMUEBLE QUE TIENE NUESTRO DOMICILIO FISCAL NO ES DE NUESTRA PROPIEDAD TENDREMOS QUE ADJUNTAR A NUESTRA PROPUESTA SOLO EL INSTRUMENTO LEGAL VIGENTE ACREDITANDO DICHO SUPUESTO. ES CORRECTO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. TENDRÁ QUE ADJUNTAR A SU PROPUESTA SOLO EL INSTRUMENTO LEGAL VIGENTE ACREDITANDO DICHO SUPUESTO EN ORIGINAL Y COPIA

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

3	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.1.	SOLICITAN MUESTRAS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS 531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, 531.341.2537 UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX, 531.341.2479, UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, 531.254.0049, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES, 531.924.0031, ULTRASONOGRAFO (FIJO), PERO NO ESTÁN LAS CEDULAS TÉCNICAS DE DICHAS PARTIDAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CEDULAS RESPECTIVA.	ACLARADA MEDIANTE LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
4	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.1.4.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CASO DE SER TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES QUE OFERTEMOS, SERA SUFICIENTE CON ADJUNTAR EL MANIFIESTO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.7.1.4. DEL ANEXO TÉCNICO SUSCRITO POR MI REPRESENTADA, ADJUNTANDO COPIA DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN QUE NOS EXPIDE EL FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	EN CASO DE SER LOS TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO, LA CARTA DE APOYO DEBERÁ SER POR EL FABRICANTE.
5	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.1.7.	SOLICITAN PARA ESTE PUNTO Y PODER CORROBORAR QUE LOS BIENES SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA; • CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADOS	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.7 DE LAS BASES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, COPIA DE LAS ACTAS ENTREGA RECEPCION Y REMISIONES DE ENTREGA FIRMADAS Y SELLADAS POR LAS INSTITUCIONES DONDE SE INSTALARON EQUIPOS DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS PRESENTADOS. SE ACEPTA?	
6	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.1.20.	SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL OFERENTE COMO DISTRIBUIDOR PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS EXPEDIDO POR COFEPRIS, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARAN AVISOS DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL OFERENTE CON MODALIDAD B: ALMACÉN DE DEPOSITO Y/O DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O REMEDIOS HERBOLARIOS O MEDICAMENTOS CONTROLADOS O MATERIA PRIMA PARA MEDICAMENTOS NO CONTROLADOS. TODA VEZ QUE COFEPRIS NO EXPIDE AVISOS DE FUNCIONAMIENTO COMO DISTRIBUIDORES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y TODO SE HACE A TRAVÉS DE HOMOClaves PREDEFINIDAS CON SUS RESPECTIVAS DESCRIPCIONES O MODALIDADES. SE ACEPTA.	SE ACEPTA, CON MODALIDAD B Y/O E
7	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.1.23	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI MI REPRESENTADA NO OFERTA PARTIDAS DE INSTRUMENTAL MEDICO, NOS PERMITA PRESENTARA UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 4.7.1.23, DEL ANEXO TÉCNICO NO LE APLICA A MI REPRESENTADA. SE ACEPTA.	SI EN EL ANEXO 1.4 RESUMEN DE PARTIDAS OFERTADAS, NO SE ENLISTAN PARTIDAS DE INSTRUMENTAL, POR EL LICITANTE, ENTONCES EL PUNTO 4.7.1.23 NO LE APLICA, EN EL CASO EN QUE EN EL ANEXO 1.4 SE ENLISTEN PARTIDAS DE INSTRUMENTAL, EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.23
8	ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" Y FICHAS TÉCNICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES PROPORCIONARA LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS FALTANTES Y DARA UN PERIODO PARA PODER REALIZAR PREGUNTAS SOBRE DICHAS PARTIDAS. ES CORRECTO.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

9	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" PUNTO 1.1. DE ALTA FRECUENCIA DE 60 HZ Y 15 KW DE POTENCIA O MAYOR.	PARA OBTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE IMAGEN SIN IMPORTAR LAS VARIABLES DE ADQUISICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITE POTENCIA DE 20 KW. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" PUNTO 1.4. CON FLUOROSCOPIA PULSADA DE 40 MA O MAYOR.	PARA OBTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE IMAGEN SIN IMPORTAR LAS VARIABLES DE ADQUISICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 120 MA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" PUNTO 1.2. CON RADIOGRAFÍA DIGITAL DE 75 MA O MAYOR	PARA OBTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE IMAGEN SIN IMPORTAR LAS VARIABLES DE ADQUISICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA DE RADIOGRAFÍA DIGITAL DE 200 MA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 5 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" PUNTO 2.4. DISIPACIÓN DE ENFRIAMIENTO DEL ÁNODO: 70,000 HU O MAYOR.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA TASA DE ENFRIAMIENTO CONTINUO DEL ÁNODO DE 60,000 HU. SE ACEPTA.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPECTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA
13	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO (PORTÁTIL) PUNTO 7.6 DOPPLER CONTINUO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL MODO DE OPERACIÓN DOPPLER CONTINUO, SERA UTILIZADO YA QUE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE REQUIERE DE UNA LICENCIA DE CARDIO Y EL ULTRASONIDO SOLO LO ESTÁN PIDIENDO PARA APLICACIONES DE GINECO-OBSTETRICIA Y CUIDADOS INTENSIVOS. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ RESPETAR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA E INCLUIR LAS LICENCIAS QUE SE REQUIERAN.
14	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO (PORTÁTIL) PUNTO 9 CONVERTIDOR DE BARRIDO DE CANALES DE PROCESO DIGITAL DESDE LA FORMACIÓN DEL HAZ	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DEBA SOLICITAR AL MENOS 4,000,000 CANALES DE PROCESAMIENTO PARA ASEGURAR QUE SE OFERTARÁ UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE ENTREGAR IMÁGENES DE ALTA CALIDAD ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
15	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO (PORTÁTIL) PUNTO 14 INCLUIR LICENCIAS DE SOFTWARE, SIN FECHA DE CADUCIDAD EN CASO DE QUE SE REQUIERA PARA EL FUNCIONAMIENTO COMPLETO DEL EQUIPO OFERTADO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO A TRAVÉS DE UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLIRÁ CON DICHOS PUNTO, TODA VES QUE ES IMPOSIBLE REFERENCIARLO A TREVES DE CATÁLOGOS, FOLLETOS O MANUALES. SE ACEPTA.	SE ACEPTA, PARA TODOS AQUELLOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN ESTA PARTIDA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

16	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO (PORTÁTIL) ACCESORIOS PUNTO 3. TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ O MENOR A 9.0 MHZ O MAYOR	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA AUMENTAR EL RANGO DE ESCANEO SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, CON EL RANGO DE 3 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, ADEMÁS PARA UN MEJOR ESTUDIO Y MENOR INCOMODIDAD AL PACIENTE QUE LA APERTURA O CAMPO DE VISIÓN SEA DE AL MENOS 200 GRADOS O MAYOR ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
----	---	---	---

22. - DICIPA, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO G. ANEXO 9	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR QUE INFORMACIÓN SE DEBERÁ REQUISITAR EN LA COLUMNA "REQ." DEL ANEXO 9. FAVOR DE PRONUNCIARSE	PARA EL ANEXO 9 NO DEBERÁ INDICAR LA COLUMNA INDICADA COMO: "REQ".
2	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO G. ANEXO 9	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO 9 SE INDICARÁ LA "DESCRIPCIÓN SAICA"?	SE INDICARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, CONFORME A LA CLAVE SAICA
3	4.6.2. PROPUESTA ECONÓMICA. PUNTO 1	"1. PARTIDA, CLAVE SAICA, CÓDIGO CABMSDF..." SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE INDICARÁ EL CÓDIGO CABMSDF, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 20. FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTO.
4	4.6.2. PROPUESTA ECONÓMICA. PUNTO 1	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO CABMSDF. FAVOR DE ACLARAR	ATENDIDA CON LA RESPUESTA ANTERIOR

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

5	4.7.1.1 PROPUESTA TÉCNICA PÁRRAFO 4 Y 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SOLAMENTE POR MOTIVOS DE REFERENCIA, CONSIDERE LA ENTREGA ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO, CATÁLOGOS, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN EN DONDE SE ENCUENTRE LA REFERENCIA DE LAS ESPECIFICACIONES; Y EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDO EN EL PRESENTE EVENTO SE ENTREGARÁN	SE DEBERÁ PRESENTAR IMPRESO PORTADA, HOJAS REFERENCIADAS Y CONTRAPORTADA DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS, Y EN FORMA ELECTRÓNICA EN PDF, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLETOS, EN CASO DE QUE LOS
---	--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		LOS MANUALES COMPLETOS; ¿SE ACEPTA?	MANUALES NO ESTÉN COMPLETOS, SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
6	4.7.1.1 PROPUESTA TÉCNICA PÁRRAFO 4	EN CASO DE QUE LOS CATÁLOGOS, HOJAS DE MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN EN DONDE SE ENCUENTRE LA REFERENCIA DE LAS ESPECIFICACIONES; VENGAN EN OTRO IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL SOLO DE LAS CARACTERÍSTICAS REFERENCIADAS. FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTO
7	4.7.1.2. RESUMEN DE LAS PARTIDAS OFERTADAS ANEXO 1.4	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO 1.4 SE INDICARÁ LA "DESCRIPCIÓN DEL COMPENDIO"?	CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL COMPENDIO
8	CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO NUMERAL 1.1.1.5 Y 3.1.1.6 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA DE MANERA ATENTA A LA CONVOCANTE; QUE EN CASO DE QUE SE DIFIERA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRESENTE EVENTO, CONSIDERE QUE SE PUEDAN PRESENTAR LOS MANIFIESTOS, CARTAS DE REFERENCIA QUE SOLICITAN EN LAS PRESENTES BASES CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDA ORIGINALMENTE (26 DE JULIO DE 2022). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
9	4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA	CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA DETECTAR DE MANERA EFICIENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR SOLO EL CLAUSULADO DE LA COPIA DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES SOLICITADAS Y EL PUNTO DE REFERENCIA DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ESTO DEBIDO A QUE ALGUNOS CONTRATOS CONTIENEN MÁS DE 500 HOJAS EN SUS ANEXOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO PUBLICADO EN BASES.
10	4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS QUE SOLICITAN EN EL PRESENTE NUMERAL SOLAMENTE SE DEBERÁN DE MOSTRAR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO, CON LA LIBERTAD DE OMITIR LOS PRECIOS POR RENGLÓN O PARTIDA, DEBIDA QUE ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, PUEDE OMITIR LOS PRECIOS POR RENGLÓN O PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATO PEDIDO O FACTURA SEA DE LAS PARTIDAS QUE ESTA OFERTANDO.
11	4.2 VISITAS	DERIVADO DE QUE NO SE INCLUYÓ EN EL ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" Y ANEXO 1.1. LAS FICHAS	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		TÉCNICAS CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 30, 36, 37, 41, 59, 115 Y 163. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE REPROGRAMAR LA FECHA PARA LA VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA ¿SE ACEPTA?	PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
12	ANEXO 1 , DESCRIPCION DE LOS BIENES	ES CORRECTO ENTENDER QUE AL NO PRESENTARSE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS 3,4,6 Y 7 NO FORMARÁN PARTE DE ESTE PROCESO LICITATORIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
13	PARTIDA 5. PUNTO 1.1 GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 60HZ Y 15KW DE POTENCIA O MAYOR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO QUE CUENTA CON UNA POTENCIA DE 12 KW Y UNA SALIDA DE POTENCIA NOMINAL DE 15 KW, CON LO QUE ES POSIBLE REALIZAR DESDE PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS HASTA ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS, SIN LIMITAR NINGUNA APLICACIÓN CLÍNICA PARA LA QUE SE HA DESARROLLADO EL EQUIPO, ADEMÁS AL CONTAR CON ESTA POTENCIA NO DEMERITA LA CALIDAD DE IMAGEN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES.
14	PARTIDA 5. PUNTO 1.1 GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 60HZ Y 15KW DE POTENCIA O MAYOR	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UN RANGO DE POTENCIA DE 20 KW O MAYOR, PARÁMETRO QUE PERMITIRÍA ENGLOBAR DESDE PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS HASTA ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS, SIN LIMITAR NINGUNA APLICACIÓN CLÍNICA PARA LA QUE SE HA DESARROLLADO EL EQUIPO, ASÍ MISMO, ESTE RANGO DE POTENCIA ENTREGARÍA UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN EN SITUACIONES MÁS DEMANDANTES, GENERANDO MAYORES VENTAJAS, POR EJEMPLO EL DESEMPEÑO OPTIMO DURANTE UNA INTERVENCIÓN DE MAYOR DURACIÓN UNA CORRECTA VISUALIZACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
15	PARTIDA 5. , PUNTO 1.2 CON RADIOGRAFÍA DIGITAL DE 75MA O MAYOR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CORRIENTE DE 10 MA A 120 MA PARA IMAGEN INDIVIDUAL, SIENDO SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATÁLOGO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

16	PARTIDA 5. PUNTO 1.4 CON FLUOROSCOPIA PULSADA DE 40MA O MAYOR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: FLUOROSCOPIA 3MA A 119 MA, LO CUAL CUMPLE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATÁLOGO¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	PARTIDA 5 PUNTO. 2.1 TUBO DE RAYOS X CON ÁNODO ROTATORIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "TANQUE ÚNICO CON TUBO DE ÁNODO GIRATORIO", LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA QUE APARECE DE ESTA MANERA EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	PARTIDA 5 PUNTO.2.2 PUNTOS FOCALES NOMINALES: 0.3 Y 0.6 MM	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO VALOR NOMINAL DE PUNTO FOCAL 0.3 / 0.5, SIENDO SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA; TODA VEZ QUE ENTRE MENOR SEA EL VALOR NOMINAL DEL PUNTO FOCAL ES MEJOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA DEBE ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
19	PARTIDA 5 PUNTO 4.2 SID DE 99CM	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: "DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR 107 CM" SIENDO SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	PARTIDA 5 PUNTO 4.3 PROFUNDIDAD DEL ARCO DE AL MENOS 73CM O MAYOR	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN 73CM", LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA QUE APARECE DE ESTA MANERA EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE REFERENCIAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
21	PARTIDA 5 PUNTO 4.4 ROTACIÓN ORBITAL DE AL MENOS 115	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: MOVIMIENTO ORBITAL DE 148 GRADOS SIENDO SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS	PUEDE REFERENCIAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		CATÁLOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
22	PARTIDA 5 PUNTO 4.5 CON MOVIMIENTO VERTICAL MOTORIZADO MÍNIMO DE 38CM	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 45CM MOTORIZADO SIENDO SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDEN REFERENCIAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
23	BASES. PARTIDA 07 FICHA TÉCNICA	DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA 07, NO DESCRITA EN BASES. EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL NÚMERO DE CORTES INDICADO Y LAS MUESTRAS SOLICITADAS SERÁN LOS CRITERIOS TÉCNICOS A EVALUAR PARA ESTA PARTIDA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
24	ANEXO 29 PLAZO DE ENTREGA PARTIDA 07	DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA PARTIDA 07 TIENE UN TIEMPO DE ENTREGA DE 45 DÍAS HÁBILES DE ENTREGA A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
25	MUESTRAS	PARA LA PARTIDA 07. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE ES SUFICIENTE ENTREGAR UN SÓLO CD CON LAS IMÁGENES DICOM SOLICITADAS INCLUYENDO SÓLO UN ESTUDIO DE CADA REGIÓN ANATÓMICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
26	4.1 MUESTRAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES SE PUEDA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS IMÁGENES EN FORMATO DICOM SOLICITADAS EN ESTE PUNTO Y COMO OPCIONAL LLEVAR EL EQUIPO FÍSICAMENTE A LAS INSTALACIONES. ¿SE ACEPTA?	A QUE PARTIDA SE REFIERE ESPECIFICAMENTE
27	ANEXO 29 PLAZO DE ENTREGA PARTIDA 23 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR PARA PROPÓSITO GENERAL. (ADULTO, PEDIÁTRICO, GINECOLÓGICO)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES Y DEBIDO A LOS RETRASOS GLOBALES DE LA MATERIA PRIMA PARA FABRICAR LOS EQUIPOS MÉDICOS SE PUEDA PRESENTAR UN TIEMPO DE ENTREGA DE 50 DÍAS HÁBILES. ¿SE ACEPTA?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

28	ANEXO 29 PLAZO DE ENTREGA PARTIDA 111 ULTRASONIDO PORTÁTIL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES Y DEBIDO A LOS RETRASOS GLOBALES DE LA MATERIA PRIMA PARA FABRICAR LOS EQUIPOS MÉDICOS SE PUEDA PRESENTAR UN TIEMPO DE ENTREGA DE 50 DÍAS HÁBILES. ¿SE ACEPTA?	EL TIEMPO SERÁ DE 40 DÍAS NATURALES
29	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONIDO PORTÁTIL PUNTO 2. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 9 O SUPERIOR.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON NUESTRA TECNOLOGÍA SIMILAR COMERCIAL PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
30	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONIDO PORTÁTIL PUNTO 5. BATERÍA INTEGRADA DE AL MENOS 4 HRS DE RESPALDO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON NUESTRA TECNOLOGÍA SIMILAR COMERCIAL PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES CON 60 MINUTOS DE RESPALDO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
31	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONIDO PORTÁTIL PUNTO 7.13 PROGRAMA DE ECORREALZADORES O MEDIOS DE CONTRASTE CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP EN COLOR BLANCO Y NEGRO Y CINE ESPECTRAL.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES COLOCAR COMO OPCIONAL ESTE PUNTO PARA NO ENCARECER LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
32	ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 111 ULTRASONIDO PORTÁTIL PUNTO 1. TRANSDUCTOR CONVEXO DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 2.0 MHZ O MENOR A 6.0 MHZ O MAYOR, PARA APLICACIONES ABDOMINALES GENERALES, OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON NUESTRA TECNOLOGÍA SIMILAR COMERCIAL PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES CON UN TRANSDUCTOR CONVEXO CON UN RANGO DE FRECUENCIA DE 1.4 A 5.0 MHZ. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
33	4.1 MUESTRAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES SE PUEDA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS IMÁGENES EN FORMATO DICOM SOLICITADAS EN ESTE PUNTO Y COMO OPCIONAL LLEVAR EL EQUIPO FÍSICAMENTE A LAS INSTALACIONES. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

23. - GE SISTEMAS MEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL DE 21.5" A COLOR GRADO MÉDICO LCD CON EL CUAL SE PUEDEN APRECIAR LAS CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS DE MANERA ADECUADA, DE IGUAL MANERA, 0.5" NO DEMERITAN LAS CAPACIDADES CLÍNICAS NI INTERFIEREN CON EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DEL ÁREA MÉDICA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE 1920 X 1080 A 60 HZ, LA CUAL PERMITE VISUALIZAR DE MANERA ADECUADA CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS, DE IGUAL MANERA NO INTERFIERE CON EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA, ¿SE ACEPTA?	ATENDER PRESICIÓN TÉCNICA NO. 6 DE LA PRESENTE JUNTA
3	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 4. CON CAPACIDAD DE PRESENTAR EN TIEMPO REAL TODOS LOS VALORES NUMÉRICOS, LAS FORMAS DE ONDA, Y LAS ALARMAS, CON TRES NIVELES DE ALARMA COMO MÍNIMO, DE HASTA 32 PACIENTES POR CENTRAL.	PREGUNTA: AL TENER EN UNA SOLA PANTALLA EL DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE VARIOS PACIENTES, PUEDE LLEGAR A GENERAR CONFUSIÓN CON EL USUARIO Y NO RESPONDER DE MANERA ADECUADA A EVENTOS QUE PUEDA TENER EL PACIENTE, ES POR ESO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 16 PACIENTES EN LA ESTACIÓN CENTRAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
4	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 7.1 CONEXIÓN MEDIANTE PROTOCOLO 10/100 INCLUYE TODAS LAS TARJETAS DE RED Y SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS MONITORES A LA CENTRAL.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PROTOCOLO 10/100 ESTÁ CONSIDERADO COMO EL PUERTO ETHERNET QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESTACIONES CENTRALES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
5	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	ESTA ELABORADO EN PROTOCOLO HL7
6	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 19. CON POSIBILIDAD DE QUE PERMITA CARGAR AUTOMÁTICAMENTE DATOS NUMÉRICOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO RECOPIADOS POR EL MONITOR, CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA CENTRAL, LOS DATOS DEBERÁN CARGAR CUANDO EL MONITOR SE RECONECTE A LA CENTRAL DE MONITOREO.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS MONITORES TENDRÁN COMUNICACIÓN ALÁMBRICA LO CUAL PERMITIRÍA UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA CENTRAL DE MONITOREO Y LOS EVENTOS DE FALLA EN COMUNICACIÓN SERÍAN CASI NULOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
7	PARTIDA 8 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 20. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES DE CABECERA, QUE PERMITA REALIZAR VIGILANCIA CAMA A CAMA Y ENVÍO DE MENSAJES.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENVÍO DE MENSAJES SE REFIERE AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ALARMAS DE LAS CAMAS REMOTAS EN VIGILANCIA, YA QUE EL ENVÍO DE OTRO TIPO DE MENSAJES ENTORPECERÍA EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DE ÁREAS CRÍTICAS DONDE LA ATENCIÓN PRIMORDIAL ES EL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
8	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.17. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD	ESTA ELABORADO EN PROTOCOLO HL7



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.	DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	
9	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.18 QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS (EMIRADI) EN FORMATO DICOM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PACS (EMIRADI) CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	DEBE TENER LICENCIAS DICOM
10	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.19.8 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS	PREGUNTA: LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNO O POCOS LICITANTES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 6 LATIGUILLOS, CON LO QUE SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
11	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.23.2 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO, CÍCLICA CON NÚMERO DE MEDICIONES E INTERVALOS DE TIEMPO CONFIGURABLES POR EL USUARIO	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA SELECCIÓN DE MEDICIONES MANUALES, AUTOMÁTICAS Y CONTINUA PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, PERMITIENDO TENER AMPLIAS OPCIONES RESPECTO A LA MEDICIÓN DEL PARÁMETRO CLÍNICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.25.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS MONITORES POR TÉCNICA MAINSTREAM. ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO.	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA SIDESTREAM EVITA EL USO DE ACCESORIOS ADICIONALES EN LA PARTE PROXIMAL DEL PACIENTE, IGUAL EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SIDESTREAM EN TODOS LOS MONITORES, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DEAPEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
13	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.26.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AL MENOS: ÍNDICE BIESPECTRAL, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL, ACTIVIDAD ELECTROMIOGRÁFICA, FRECUENCIA DE BORDE ESPECTRAL, TASA DE SUPRESIÓN.	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL DESPLIEGUE DE ÍNDICE BIESPECTRAL, UN CANAL DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL DE ELECTROMIOGRAFÍA, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL Y TASA DE SUPRESIÓN, APORTANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA MONITORIZACIÓN DEL NIVEL DE INCONSCIENCIA EN EL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
14	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.27.6 MEDICIÓN DE LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR DERECHA (REFERENCIA)	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA OFERTADA PERMITE LA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO DESDE EL MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO, OBTENIENDO HASTA 6 MEDICIONES PAR PROMEDIO, GASTO CARDIACO E ÍNDICE CARDIACO, DATOS INDEXADOS Y NO INDEXADOS, REDUCIENDO LA MANIPULACIÓN DE ACCESORIOS Y CABLES EMPLEADOS DURANTE LA MONITORIZACIÓN, YA QUE NO ES NECESARIO UN MÓDULO ADICIONAL, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
15	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 6. PRESIÓN INVASIVA: UN CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y UN TRANSDUCTOR REUSABLE CON 20 DOMOS DESECHABLES Y 20 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLES, POR CANAL, POR CADA MONITOR DE SIGNOS VITALES SOLICITADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI REQUIERE CABLES TRONCALES PARA TRANSDUCTOR DESECHABLE O TRANSDUCTOR REUSABLE, ACLARAR POR FAVOR.	PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITA: UN CABLE TRONCAL UN TRANSDUCTOR REUSABLE, 20 DOMOS DESECHABLES, 20 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE
16	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 7. CAPNOGRAFÍA (MAINSTREAM Y SIDESTREAM) PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 6.	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA SIDESTREAM EVITA EL USO DE ACCESORIOS ADICIONALES EN LA PARTE PROXIMAL DEL PACIENTE, IGUAL EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SIDESTREAM EN TODOS LOS MONITORES, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
17	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 9. MONTAJE A CHAROLA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO Y SOPORTE DE EQUIPO PARA CADA UNO DE LOS MONITORES DE CABECERA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL SOPORTE A PARED ES SUFICIENTE PARA LA COLOCACIÓN DEL MONITOR CON EL CUAL SE PERMITE MOVIMIENTO LATERAL PARA SU MANIPULACIÓN, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
18	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 12. 4 PASTAS DE 250 GR. PARA ELECTRODO REUSABLE	PREGUNTA: LOS ELECTRODOS OFERTADOS CONTIENEN GEL ADHESIVO Y CONDUCTIVO, DE IGUAL NO FORMA EL REUSAR ELECTRODOS PUEDE GENERAR ALTAS PROBABILIDADES DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO
19	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 14. 4 PASTAS DE 250 GR. PARA ELECTRODO REUSABLE	PREGUNTA: LOS ELECTRODOS OFERTADOS CONTIENEN GEL ADHESIVO Y CONDUCTIVO, DE IGUAL NO FORMA EL REUSAR ELECTRODOS PUEDE GENERAR ALTAS PROBABILIDADES DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO
20	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL DE 21.5" A COLOR GRADO MÉDICO LCD CON EL CUAL SE PUEDEN APRECIAR LAS CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS DE MANERA ADECUADA, DE IGUAL MANERA, 0.5" NO DEMERITAN LAS CAPACIDADES CLÍNICAS NI INTERFIEREN CON EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DEL ÁREA MÉDICA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
21	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE 1920 X 1080 A 60 HZ, LA CUAL PERMITE VISUALIZAR DE MANERA ADECUADA CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS, DE IGUAL MANERA NO INTERFIERE CON EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE ATENDER LA PRESICION TÉCNICA NUMERO 6 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

172
L
4
A
P
1
S
A

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
22	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 4. CON CAPACIDAD DE PRESENTAR EN TIEMPO REAL TODOS LOS VALORES NUMÉRICOS, LAS FORMAS DE ONDA, Y LAS ALARMAS, CON TRES NIVELES DE ALARMA COMO MÍNIMO, DE HASTA 32 PACIENTES POR CENTRAL.	PREGUNTA: AL TENER EN UNA SOLA PANTALLA EL DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE VARIOS PACIENTES, PUEDE LLEGAR A GENERAR CONFUSIÓN CON EL USUARIO Y NO RESPONDER DE MANERA ADECUADA A EVENTOS QUE PUEDA TENER EL PACIENTE, ES POR ESO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 16 PACIENTES EN LA ESTACIÓN CENTRAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
23	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 7.1 CONEXIÓN MEDIANTE PROTOCOLO 10/100 INCLUYE TODAS LAS TARJETAS DE RED Y SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS MONITORES A LA CENTRAL.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PROTOCOLO 10/100 ESTÁ CONSIDERADO COMO EL PUERTO ETHERNET QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESTACIONES CENTRALES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
24	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
25	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 19. CON POSIBILIDAD DE QUE PERMITA CARGAR AUTOMÁTICAMENTE DATOS NUMÉRICOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS MONITORES TENDRÁN COMUNICACIÓN ALÁMBRICA LO CUAL PERMITIRÍA UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA CENTRAL DE MONITOREO Y LOS EVENTOS DE FALLA EN COMUNICACIÓN SERÍAN CASI NULOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A	YA SE CONTESTÓ

2



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	RECOPILADOS POR EL MONITOR, CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA CENTRAL, LOS DATOS DEBERÁN CARGAR CUANDO EL MONITOR SE RECONECTE A LA CENTRAL DE MONITOREO.	LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	
26	PARTIDA 10 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS DICE: 20. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES DE CABECERA, QUE PERMITA REALIZAR VIGILANCIA CAMA A CAMA Y ENVÍO DE MENSAJES.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENVÍO DE MENSAJES SE REFIERE AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ALARMAS DE LAS CAMAS REMOTAS EN VIGILANCIA, YA QUE EL ENVÍO DE OTRO TIPO DE MENSAJES ENTORPECERÍA EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DE ÁREAS CRÍTICAS DONDE LA ATENCIÓN PRIMORDIAL ES EL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?	YA SE CONTESTÓ
27	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.17. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
28	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.18 QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS (EMIRADI) EN FORMATO DICOM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PACS (EMIRADI) CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
29	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.19.8 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO	PREGUNTA: LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNO O POCOS LICITANTES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS	DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 6 LATIGUILLOS, CON LO QUE SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	
30	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.24.2 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO, CÍCLICA CON NÚMERO DE MEDICIONES E INTERVALOS DE TIEMPO CONFIGURABLES POR EL USUARIO	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA SELECCIÓN DE MEDICIONES MANUALES, AUTOMÁTICAS Y CONTINUA PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, PERMITIENDO TENER AMPLIAS OPCIONES RESPECTO A LA MEDICIÓN DEL PARÁMETRO CLÍNICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
31	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.26.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS MONITORES POR TÉCNICA MAINSTREAM.	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA SIDESTREAM EVITA EL USO DE ACCESORIOS ADICIONALES EN LA PARTE PROXIMAL DEL PACIENTE, IGUAL EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SIDESTREAM EN TODOS LOS MONITORES, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
32	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.27.6 MEDICIÓN DE LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR DERECHA (REFERENCIA)	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA OFERTADA PERMITE LA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO DESDE EL MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO, OBTENIENDO HASTA 6 MEDICIONES PAR PROMEDIO, GASTO CARDIACO E ÍNDICE CARDIACO, DATOS INDEXADOS Y NO INDEXADOS, REDUCIENDO LA MANIPULACIÓN DE ACCESORIOS Y CABLES EMPLEADOS DURANTE LA MONITORIZACIÓN, YA QUE NO ES NECESARIO UN MÓDULO ADICIONAL, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
33	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.32 PRESIÓN INVASIVA: UN CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y UN TRANSDUCTOR REUSABLE CON 20 DOMOS DESECHABLES Y 20 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLES, POR CANAL, POR CADA MONITOR DE	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI REQUIERE CABLES TRONCALES PARA TRANSDUCTOR DESECHABLE O TRANSDUCTOR REUSABLE, ACLARAR POR FAVOR.	PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITA: UN CABLE TRONCAL UN TRANSDUCTOR REUSABLE 20 DOMOS DESECHABLES 20 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	SIGNOS VITALES SOLICITADO.		
34	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.33. CAPNOGRAFÍA (MAINSTREAM Y SIDESTREAM)	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA SIDESTREAM EVITA EL USO DE ACCESORIOS ADICIONALES EN LA PARTE PROXIMAL DEL PACIENTE, IGUAL EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SIDESTREAM EN TODOS LOS MONITORES, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO
35	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.36. MONTAJE A CHAROLA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO Y SOPORTE DE EQUIPO PARA CADA UNO DE LOS MONITORES DE CABECERA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL SOPORTE A PARED ES SUFICIENTE PARA LA COLOCACIÓN DEL MONITOR CON EL CUAL SE PERMITE MOVIMIENTO LATERAL PARA SU MANIPULACIÓN, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
36	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.39. 4 PASTAS DE 250 GR. PARA ELECTRODO REUSABLE	PREGUNTA: LOS ELECTRODOS OFERTADOS CONTIENEN GEL ADHESIVO Y CONDUCTIVO, DE IGUAL NO FORMA EL REUSAR ELECTRODOS PUEDE GENERAR ALTAS PROBABILIDADES DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO
37	PARTIDA 11 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.41. 4 PASTAS DE 250 GR. PARA ELECTRODO REUSABLE	PREGUNTA: LOS ELECTRODOS OFERTADOS CONTIENEN GEL ADHESIVO Y CONDUCTIVO, DE IGUAL NO FORMA EL REUSAR ELECTRODOS PUEDE GENERAR ALTAS PROBABILIDADES DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO
38	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DICE: 3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL DE 21.5" A COLOR GRADO MÉDICO LCD CON EL CUAL SE PUEDEN APRECIAR LAS CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS DE MANERA ADECUADA, DE IGUAL MANERA, 0.5" NO DEMERITAN LAS	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.	CAPACIDADES CLÍNICAS NI INTERFIEREN CON EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DEL ÁREA MÉDICA, ¿SE ACEPTA?	
39	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DICE: 3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE 1920 X 1080 A 60 HZ, LA CUAL PERMITE VISUALIZAR DE MANERA ADECUADA CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS, DE IGUAL MANERA NO INTERFIERE CON EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE ATENDER LA PRECISION TÉCNICA NÚMERO 6 DE LA PRESENTE JUNTA
40	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DICE: 4. CON CAPACIDAD DE PRESENTAR EN TIEMPO REAL TODOS LOS VALORES NUMÉRICOS, LAS FORMAS DE ONDA, Y LAS ALARMAS, CON TRES NIVELES DE ALARMA COMO MÍNIMO, DE HASTA 32 PACIENTES POR CENTRAL.	PREGUNTA: AL TENER EN UNA SOLA PANTALLA EL DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE VARIOS PACIENTES, PUEDE LLEGAR A GENERAR CONFUSIÓN CON EL USUARIO Y NO RESPONDER DE MANERA ADECUADA A EVENTOS QUE PUEDA TENER EL PACIENTE, ES POR ESO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 16 PACIENTES EN LA ESTACIÓN CENTRAL, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTO
41	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DICE: 7.1 CONEXIÓN MEDIANTE PROTOCOLO 10/100 INCLUYE TODAS LAS TARJETAS DE RED Y SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS MONITORES A LA CENTRAL.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PROTOCOLO 10/100 ESTÁ CONSIDERADO COMO EL PUERTO ETHERNET QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESTACIONES CENTRALES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
42	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DICE: 18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.		
43	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DICE: 19. CON POSIBILIDAD DE QUE PERMITA CARGAR AUTOMÁTICAMENTE DATOS NUMÉRICOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO RECOPIADOS POR EL MONITOR, CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA CENTRAL, LOS DATOS DEBERÁN CARGAR CUANDO EL MONITOR SE RECONECTE A LA CENTRAL DE MONITOREO.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS MONITORES TENDRÁN COMUNICACIÓN ALÁMBRICA LO CUAL PERMITIRÍA UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA CENTRAL DE MONITOREO Y LOS EVENTOS DE FALLA EN COMUNICACIÓN SERÍAN CASI NULOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
44	PARTIDA 12 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DICE: 20. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES DE CABECERA, QUE PERMITA REALIZAR VIGILANCIA CAMA A CAMA Y ENVÍO DE MENSAJES.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENVÍO DE MENSAJES SE REFIERE AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ALARMAS DE LAS CAMAS REMOTAS EN VIGILANCIA, YA QUE EL ENVÍO DE OTRO TIPO DE MENSAJES ENTORPECERÍA EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DE ÁREAS CRÍTICAS DONDE LA ATENCIÓN PRIMORDIAL ES EL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
45	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.19. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
46	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.20 QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PACS (EMIRADI) CON EL FIN	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	HACIA EL SISTEMA PACS (EMIRADI) EN FORMATO DICOM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.	DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	
47	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.21.8 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS	PREGUNTA: LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNO O POCOS LICITANTES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 6 LATIGUILLOS, CON LO QUE SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
48	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.25.2 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO, CÍCLICA CON NÚMERO DE MEDICIONES E INTERVALOS DE TIEMPO CONFIGURABLES POR EL USUARIO	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA SELECCIÓN DE MEDICIONES MANUALES, AUTOMÁTICAS Y CONTINÚA PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, PERMITIENDO TENER AMPLIAS OPCIONES RESPECTO A LA MEDICIÓN DEL PARÁMETRO CLÍNICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
49	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.27.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA CINCO MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y TRES MONITORES POR TÉCNICA MAINSTREAM.	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA SIDESTREAM EVITA EL USO DE ACCESORIOS ADICIONALES EN LA PARTE PROXIMAL DEL PACIENTE, IGUAL EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SIDESTREAM EN TODOS LOS MONITORES, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
50	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.28.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AL MENOS: ÍNDICE BIESPECTRAL, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL, ACTIVIDAD ELECTROMIOGRÁFICA, FRECUENCIA DE BORDE ESPECTRAL, TASA DE SUPRESIÓN.	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL DESPLIEGUE DE ÍNDICE BIESPECTRAL, UN CANAL DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL DE ELECTROMIOGRAFÍA, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL Y TASA DE SUPRESIÓN, APORTANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA MONITORIZACIÓN DEL NIVEL DE INCONSCIENCIA EN EL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
51	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.29.6 MEDICIÓN DE LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR DERECHA (REFERENCIA)	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA OFERTADA PERMITE LA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO DESDE EL MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO, OBTENIENDO HASTA 6 MEDICIONES PAR PROMEDIO, GASTO CARDIACO E ÍNDICE CARDIACO, DATOS INDEXADOS Y NO INDEXADOS, REDUCIENDO LA MANIPULACIÓN DE ACCESORIOS Y CABLES EMPLEADOS DURANTE LA MONITORIZACIÓN, YA QUE NO ES NECESARIO UN MÓDULO ADICIONAL, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTO
52	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.36. PRESIÓN INVASIVA: UN CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y UN TRANSDUCTOR REUSABLE CON 20 DOMOS DESECHABLES Y 20 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLES, POR CANAL, POR CADA MONITOR DE SIGNOS VITALES SOLICITADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI REQUIERE CABLES TRONCALES PARA TRANSDUCTOR DESECHABLE O TRANSDUCTOR REUSABLE, ACLARAR POR FAVOR.	PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITA: UN CABLE TRONCAL UN TRANSDUCTOR REUSABLE 20 DOMOS DESECHABLES 20 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE
53	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.37. CAPNOGRAFÍA (MAINSTREAM Y SIDESTREAM)	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA SIDESTREAM EVITA EL USO DE ACCESORIOS ADICIONALES EN LA PARTE PROXIMAL DEL PACIENTE, IGUAL EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SIDESTREAM EN TODOS LOS MONITORES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE AL PUNTO 1.37 DE LA FICHA TECNICA
54	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.41 4 PASTAS DE 250 GR. PARA ELECTRODO REUSABLE	PREGUNTA: LOS ELECTRODOS OFERTADOS CONTIENEN GEL ADHESIVO Y CONDUCTIVO, DE IGUAL NO FORMA EL REUSAR ELECTRODOS PUEDE GENERAR ALTAS PROBABILIDADES DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO
55	PARTIDA 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES	PREGUNTA: LOS ELECTRODOS OFERTADOS CONTIENEN GEL ADHESIVO Y CONDUCTIVO, DE IGUAL NO FORMA EL REUSAR	NO SE ACEPTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

172

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	DICE: 1.43 4 PASTAS DE 250 GR. PARA ELECTRODO REUSABLE	ELECTRODOS PUEDE GENERAR ALTAS PROBABILIDADES DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	
56	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, SIETE CAMAS DICE: 3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL DE 21.5" A COLOR GRADO MÉDICO LCD CON EL CUAL SE PUEDEN APRECIAR LAS CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS DE MANERA ADECUADA, DE IGUAL MANERA, 0.5" NO DEMERITAN LAS CAPACIDADES CLÍNICAS NI INTERFIEREN CON EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DEL ÁREA MÉDICA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
57	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, SIETE CAMAS DICE: 3.1.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3MB	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE 1920 X 1080 A 60 HZ, LA CUAL PERMITE VISUALIZAR DE MANERA ADECUADA CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS, DE IGUAL MANERA NO INTERFIERE CON EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA, ¿SE ACEPTA?	DEBERA ATENDER LA PRESICION TECNICA NUMERO 6 DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
58	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, SIETE CAMAS DICE: 4. CON CAPACIDAD DE PRESENTAR EN TIEMPO REAL TODOS LOS VALORES NUMÉRICOS, LAS FORMAS DE ONDA, Y LAS ALARMAS, CON TRES NIVELES DE ALARMA COMO MÍNIMO, DE HASTA 32 PACIENTES POR CENTRAL.	PREGUNTA: AL TENER EN UNA SOLA PANTALLA EL DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE VARIOS PACIENTES, PUEDE LLEGAR A GENERAR CONFUSIÓN CON EL USUARIO Y NO RESPONDER DE MANERA ADECUADA A EVENTOS QUE PUEDA TENER EL PACIENTE, ES POR ESO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 16 PACIENTES EN LA ESTACIÓN CENTRAL, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
59	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, SIETE CAMAS DICE: 7.1 CONEXIÓN MEDIANTE PROTOCOLO 10/100 INCLUYE TODAS LAS TARJETAS DE RED Y SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS MONITORES A LA CENTRAL.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PROTOCOLO 10/100 ESTÁ CONSIDERADO COMO EL PUERTO ETHERNET QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESTACIONES CENTRALES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA APRECIACIÓN SU



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
60	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, SIETE CAMAS DICE: 16.2 CAPACIDAD DE EXPORTAR REGISTROS EN FORMATO EXCEL O PDF A UN DISPOSITIVO USB	PREGUNTA: PARA QUE LA INFORMACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES PUEDA SER EXTRAÍDA, ESTA DEBE DE MANTENER UN FLUJO DE ENVÍO SEGURO EN UNA RED, POR LO QUE EXTRAER DATOS MEDIANTE USB VULNERA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE, POR LO QUE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE EL ENVÍO DE INFORMACIÓN CLÍNICA AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO Y DE AHÍ PUEDA SER ANALIZADA Y EXTRAÍDA LA INFORMACIÓN DE REPORTES CLÍNICOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
61	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, SIETE CAMAS DICE: 17. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
62	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, SIETE CAMAS DICE: 18. CON POSIBILIDAD DE QUE PERMITA CARGAR AUTOMÁTICAMENTE DATOS NUMÉRICOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO RECOPIADOS POR EL MONITOR, CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA CENTRAL, LOS DATOS DEBERÁN CARGAR CUANDO EL MONITOR SE RECONECTE A LA CENTRAL DE MONITOREO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
63	PARTIDA 14 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, SIETE CAMAS DICE: 19. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES DE CABECERA, QUE PERMITA REALIZAR VIGILANCIA CAMA A CAMA Y ENVÍO DE MENSAJES.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENVÍO DE MENSAJES SE REFIERE AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ALARMAS DE LAS CAMAS REMOTAS EN VIGILANCIA, YA QUE EL ENVÍO DE OTRO TIPO DE MENSAJES ENTORPECERÍA EL FLUJO DE TRABAJO DENTRO DE ÁREAS CRÍTICAS DONDE LA ATENCIÓN PRIMORDIAL ES EL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
64	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN) DICE: 1.19. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO SAMIH CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
65	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN) DICE: 1.20 QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS (EMIRADI) EN FORMATO DICOM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PACS (EMIRADI) CON EL FIN DE CORROBORAR LA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
66	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN) DICE: 1.21.8 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS	PREGUNTA: LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNO O POCOS LICITANTES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 6 LATIGUILLOS, CON LO QUE SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
67	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN) DICE: 1.25.2 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO, CÍCLICA CON NÚMERO DE MEDICIONES E INTERVALOS DE TIEMPO CONFIGURABLES POR EL USUARIO.	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA SELECCIÓN DE MEDICIONES MANUALES, AUTOMÁTICAS Y CONTINÚA PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, PERMITIENDO TENER AMPLIAS OPCIONES RESPECTO A LA MEDICIÓN DEL PARÁMETRO CLÍNICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
68	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN) DICE: 1.28.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AL MENOS: ÍNDICE BIESPECTRAL, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL, ACTIVIDAD ELECTROMIOGRÁFICA, FRECUENCIA DE BORDE ESPECTRAL, TASA DE SUPRESIÓN.	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL DESPLIEGUE DE ÍNDICE BIESPECTRAL, UN CANAL DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL DE ELECTROMIOGRAFÍA, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL Y TASA DE SUPRESIÓN, APORTANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA MONITORIZACIÓN DEL NIVEL DE INCONSCIENCIA EN EL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
69	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN) DICE: 1.29.6 MEDICIÓN DE LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR DERECHA (REFERENCIA)	PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA OFERTADA PERMITE LA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO DESDE EL MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO, OBTENIENDO HASTA 6 MEDICIONES PAR PROMEDIO, GASTO CARDIACO E ÍNDICE CARDIACO, DATOS INDEXADOS Y NO INDEXADOS, REDUCIENDO LA MANIPULACIÓN DE ACCESORIOS Y CABLES EMPLEADOS DURANTE LA MONITORIZACIÓN, YA QUE NO ES NECESARIO UN MÓDULO ADICIONAL, ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
70	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 22.5. PRESIÓN INVASIVA: UN CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y UN TRANSDUCTOR REUSABLE CON 20 DOMOS DESECHABLES Y 20 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLES, POR CANAL, POR CADA MONITOR DE SIGNOS VITALES SOLICITADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI REQUIERE CABLES TRONCALES PARA TRANSDUCTOR DESECHABLE O TRANSDUCTOR REUSABLE, ACLARAR POR FAVOR.	PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITA: UN CABLE TRONCAL UN TRANSDUCTOR REUSABLE 20 DOMOS DESECHABLES 20 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
71	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 24. 4 PASTAS DE 250 GR. PARA ELECTRODO REUSABLE	PREGUNTA: LOS ELECTRODOS OFERTADOS CONTIENEN GEL ADHESIVO Y CONDUCTIVO, DE IGUAL NO FORMA EL REUSAR ELECTRODOS PUEDE GENERAR ALTAS PROBABILIDADES DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
72	PARTIDA 15 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 26. 4 PASTAS DE 250 GR. PARA ELECTRODO REUSABLE	PREGUNTA: LOS ELECTRODOS OFERTADOS CONTIENEN GEL ADHESIVO Y CONDUCTIVO, DE IGUAL NO FORMA EL REUSAR ELECTRODOS PUEDE GENERAR ALTAS PROBABILIDADES DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO
73	PARTIDA 24 ANESTESIA INTERMEDIA S/N	SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS ESPECIFICACIONES EN CÉDULA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 24 ANESTESIA INTERMEDIA.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
74	PARTIDA 33 MONITOR DE SIGNOS INTERMEDIO S/N	SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS ESPECIFICACIONES EN CÉDULA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 33 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
75	PARTIDA 42 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO	SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS ESPECIFICACIONES EN CÉDULA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 42 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
76	PARTIDA 48 MONITOR DE SIGNOS PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE	SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS ESPECIFICACIONES EN CÉDULA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 48 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
77	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA FICHA 531.254.0049-11 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 7 -UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 CORTES YA QUE NO APARECE EN EL ANEXO 1.1. DE LAS BASES.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NOMBRE E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
78	NUMERAL 4.5 NOTA PRIMERA HOJA 12	EN EL ENTENDIDO QUE LOS COMPROBANTES DE DOMICILIO, OPINIONES DE CUMPLIMIENTO, Y LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES SON ELECTRÓNICOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA IMPRIMIR DOS VECES LOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE SER CONSIDERADOS COMO ORIGINALES. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

79	NUMERAL 4.5.1 INCISO G	¿ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE QUE NO APLICAR A MI REPRESENTADA, CUMPLIREMOS CON COLOCAR LA LEYENDA NO APLICA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA ESTE, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.
----	------------------------	--	---

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

80	ANEXO TÉCNICO. PUNTO 4.1 MUESTRAS, PARTIDA 6.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUÉ SE CONSIDERA COMO UN PACIENTE OBESO. LO ANTERIOR DADO QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 2. UNA IMAGEN LATERAL DE PACIENTES OBESOS.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
81	ANEXO TÉCNICO. PUNTO 4.1 MUESTRAS, PARTIDA 4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUÉ SE CONSIDERA COMO UN PACIENTE OBESO. LO ANTERIOR DADO QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 2. UNA IMAGEN LATERAL DE PACIENTES OBESOS.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
82	PARTIDA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ENVIÉ LA CÉDULA TÉCNICA DE LA PARTIDA NO. 3 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
83	PARTIDA 4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ENVIÉ LA CÉDULA TÉCNICA DE LA PARTIDA NO. 4 UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TORAX	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
84	PARTIDA 6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ENVIÉ LA CÉDULA TÉCNICA DE LA PARTIDA 6. UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
85	PARTIDA 5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE COMPARTA LOS VALORES DE REFERENCIA SOLICITADOS/ CÉDULA PARA LA PARTIDA 5, RAYOS X CON	NO SE ENTIENDE SU PREGUNTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		FLUORSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	
86	PARTIDA 5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR EL ENVÍO DEL EQUIPO A SER OFERTADO POR LA LICITANTE COMO EQUIPO DEMO DURANTE UN PERIODO MÁXIMO DE DOS SEMANAS, PARA QUE LA CONVOCANTE PUEDA GENERAR LAS IMÁGENES NECESARIAS COMO REFERENCIA, SE ACEPTA ENTONCES EL EQUIPO DEMO COMO SUSTITUCIÓN DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS?	NO ES NECESARIO
87	PARTIDA 111, DESCRIPCIÓN, PUNTO 2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR WINDOWS 7, SIN QUE ELLO OFREZCA UN DEMERITO EN LA CALIDAD DE IMAGEN O EQUIPO RECIÉN FABRICADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
88	PARTIDA 111, DESCRIPCIÓN, PUNTO 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR 30 MINUTOS, PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
89	PARTIDA 111, DESCRIPCIÓN, PUNTO 7.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR RANGO DINÁMICO DE 200DB O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
90	PARTIDA 111, DESCRIPCIÓN, PUNTO 7.13	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL INCLUIR LOS ECOMREALZADORES, PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ADICIONALMENTE A QUE ESTA CARACTERÍSTICA, GENERALMENTE SE ENCUENTRA EN EQUIPOS DE GABINETE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
91	PARTIDA 111, DESCRIPCIÓN, PUNTO 9 Y 10	ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR LOS VALORES PROPIOS DE CADA CASA COMERCIAL ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
92	PARTIDA 111, ACCESORIOS, PUNTO 1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR +/- 1 MHZ DE LO MÍNIMO Y MÁXIMO, ASÍ COMO UN NUMERO DE CRISTALES DE 180 COMO MÍNIMO, PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
93	PARTIDA 111, ACCESORIOS, PUNTO 2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR +/- 1 MHZ DE LO MÍNIMO Y MÁXIMO, ASÍ COMO UN NUMERO DE CRISTALES DE 180 COMO MÍNIMO, PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
94	PARTIDA 111, ACCESORIOS, PUNTO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR +/- 2 MHZ DE LO MÍNIMO Y MÁXIMO, ASÍ COMO UN NUMERO DE CRISTALES DE 120 COMO MÍNIMO, PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

95	PARTIDA 111, ACCESORIOS, PUNTO 4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL EL UPS, LA RAZÓN QUE AL SOLICITAR EQUIPO PORTÁTIL DISMINUYE LA PORTABILIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
96	PARTIDA 111, DESCRIPCIÓN, PUNTO 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CARGADOR DE BATERÍA EXTERNO DE LA MISMA MARCA. LO QUE GARANTIZARÁ MÁS DE 60 MINUTOS EN TOTAL. ¿SE ACEPTA?	EN LA FICHA TÉCNICA, ACCESORIOS PUNTO 6, SE SOLICITA UN CARGADOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO.
97	PARTIDA 111, DESCRIPCIÓN, PUNTO 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CARRO DE TRANSPORTE CON BATERÍA INTERNA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
98	PARTIDA 111, DESCRIPCIÓN, PUNTO 5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR CON CARTA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REESTRUCTURAR SU PREGUNTA, YA QUE NO SE ENTIENDE A QUE SE REFIERE SI A LA DESCRIPCION DEL BIEN O A LOS ACCESORIOS
99	PARTIDA 111, ACCESORIOS, PUNTO 1	EN CONGRUENCIA CON EL USO DEL SISTEMA DE ULTRASONIDO EN APLICACIONES ABDOMINALES GENERALES, OBSTÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR FRECUENCIA DE 5MHZ COMO LA MÁXIMA FRECUENCIA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
100	PARTIDA 23.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PROPORCIONAR FICHA TÉCNICA.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
101	PARTIDA 28.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PROPORCIONAR FICHA TÉCNICA.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
102	PARTIDA 35.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PROPORCIONAR FICHA TÉCNICA.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
103	PARTIDA 46.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PROPORCIONAR FICHA TÉCNICA.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
104	PARTIDA 49.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PROPORCIONAR FICHA TÉCNICA.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
105	ANEXO 29	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A 120 DÍAS PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS, DEBIDO AL DESABASTO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS QUE SE PRESENTA A NIVEL MUNDIAL: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,23,24,28,32,33,35,42,46,48,49,111	REPLANTEAR PREGUNTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

106	PUNTO 4.7.1.10 SOPORTE TÉCNICO, INCISO F)	PREGUNTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL REQUISITO DEL EQUIPO EN PRÉSTAMO EN CASO DE QUE EN CASO DE QUE EL EQUIPO Y/O SUS ACCESORIOS QUEDEN FUERA DE SERVICIO POR MÁS DE CINCO DÍAS HÁBILES, SEA RETIRADO Y EN SU LUGAR PUEDA ESTABLECERSE UNA PENALIZACIÓN POR DÍA DE NO OPERACIÓN, MISMA QUE NO SUPERE A LA GARANTÍA DEL BIEN (10%).	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO DESCRITO EN EL NUMERAL 4.7.1.10 "SOPORTE TECNICO" INCISO F
107	PUNTO 4.7.1.10 SOPORTE TÉCNICO, INCISO L)	PEGUNTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE EL TIEMPO DE OPERACIÓN/FUNCIONALIDAD DEL 92% NO SEA LOGRADO, LA SECRETARÍA ESTABLEZCA UNA PENALIZACIÓN, MISMA QUE NO SUPERE A LA GARANTÍA DEL BIEN, SUSTITUYENDO LA PENALIZACIÓN EL REQUISITO DE CAMBIO POR UN EQUIPO NUEVO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO DESCRITO EN EL NUMERAL 4.7.1.10, INCISO L
108	PUNTO 4.7.1.10 SOPORTE TÉCNICO, INCISO E)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PUEDAN AMPLIARSE A: I. TIEMPO DE RESPUESTA DE 72 HORAS II. TIEMPO DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 120 HORAS	NO SE ACEPTA.
109	ANEXO 1.8	EL NÚMERO DE PARTIDA EN EL ANEXO 1.8 (EXCEL) DIFIERE CON LAS INDICADAS EN EL LISTADO COMPLETO DE ACTA DE ENTREGA ANEXO 26 PAGINA 358 A 372 DE BASES, FAVOR DE ACTUALIZAR EL ANEXO 1.8	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
110	4.6.1 TÉCNICA PROPUESTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ENTREGAR LOS CATÁLOGOS REFERENCIADOS EN USB POR EL TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS Y PARA FACILITAR LA REVISIÓN DE ESTOS	NO SE ACEPTA, DEBERÁ IMPRIMIR PORTADA DEL MANUAL Y LAS PAGINAS REFERENCIADAS PERO DEBERÁ ANEXAR EN FORMATO DIGITAL TODOS LOS DOCUMENTOS TECNICOS COMPLETOS, SI ALGUN DOCUMENTO TECNICO DIGITAL NO ESTUVIERA COMPLETO, SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
111	4.6.1 TÉCNICA PROPUESTA	EN CASO DE NO ACEPTAR LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE IMPRIMIR SOLO LAS PÁGINAS DONDE SE HACE REFERENCIADO Y NO EL DOCUMENTO COMPLETO, PARA EVITAR EL	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO VENGA CORRECTAMENTE REFERENCIADO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	DESPERDICIO DE HOJAS Y ENTREGAR LOS DOCUMENTOS COMPLETOS EN USB	
--	--	--

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

112	4.5.1 ESCRITOS MANIFIESTOS	Y	PARA LOS ANEXOS EN QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, PODEMOS COLOCAR LA LEYENDA DE "NO APLICA", SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN	DEBERÁ PRESENTAR LOS SUPUESTOS QUE LE APLICAN Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO
-----	-------------------------------	---	--	--

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

113	ANEXO FICHAS TÉCNICAS	1.1.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:			SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
			PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	
			3	531.341.0481- 11	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	
			4	531.341.0440- 11	UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	
			6	531.341.2479	UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL	
			7	531.254.0049- 11	TOMOGRFIA DE 16 CORTES NATIVOS	
			23	531.924.9931- 1	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSOPERATORIA	
			24	531.053.0358- 1	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	
			28	531.252.0033	CUNA DE CALOR RADIANTE CON LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	
			33	531.619.0403- 1	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	
			35	531.941.0204- 01	VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL-PEDIÁTRICO- ADULTO	
			42	531.619.0403- 6	MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO	
			46	531.329.0032	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		48	531.619.0411	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADO	
		49	531.562.046	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	
114	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	DEBIDO A QUE NO ENVIARON DESDE UN PRINCIPIO LAS FICHAS TÉCNICAS DE VARIAS PARTIDAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DÉ AL MENOS 2 DÍAS PARA REVISIÓN DE ESTAS Y PODER HACER PREGUNTAS.			

24. - DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.5 NOTA: PRIMERO	FAVOR DE CONSIDERAR COMO DOCUMENTO ORIGINAL LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, VIGENTE OBTENIDO DE MANERA ELECTRÓNICA, PRESENTANDO DICHA CONSTANCIA EN DOS TANTOS, UNO QUE FUNGIRÁ COMO ORIGINAL Y EL SEGUNDO COMO COPIA SIMPLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

2	ANEXO 29 – PLAZO DE ENTREGA	FAVOR DE CONFIRMAR EL TIEMPO DE ENTREGA POR PARTIDA, DEBIDO A QUE EN EL ANEXO 29 SÓLO SE INDICAN CLAVES Y DESCRIPCIONES SIN SER PRECISOS EN EL NÚMERO DE PARTIDA AL QUE HACEN REFERENCIA.	SE ATIENDE CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 2 DE LA CONVOCANTE
3	ANEXO 29 – PLAZO DE ENTREGA	FAVOR DE CONFIRMAR SI EL NÚMERO QUE APARECE EN LA COLUMNA "TIEMPO DE ENTREGA" HACE REFERENCIA AL NÚMERO DE SEMANAS EN LAS QUE SE DEBEN ENTREGAR LOS BIENES ADJUDICADOS.	SE REFIERE A DÍAS NATURALES
4	NUMERAL 4.1.2 DEL ANEXO TÉCNICO	DEBIDO AL VOLUMEN DE LAS CENTRALES DE MONITOREO SOLICITADAS COMO MUESTRA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EN LUGAR DE LA MUESTRA FÍSICA NOS PERMITA ENTREGAR CATÁLOGOS DONDE ESTÉN REFERENCIADOS LOS PUNTOS A EVALUAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

5	NUMERAL 4.5 – INCISO G) NUMERAL 4.5.1 – INCISO A) ANEXO 3	EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	DEBERÁ SEÑALAR LOS SUPUESTOS QUE LE APLICAN Y DE SER EL CASO LOS QUE NO LE APLIQUEN
---	---	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA REQUISITAR EL PRESENTE ANEXO DEBEMOS MARCAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA COLUMNA "NO APLICA". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
6	NUMERAL 4.5.1 – INCISO B) ANEXO 4	EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA REQUISITAR EL PRESENTE ANEXO PODEMOS COLOCAR LA FRASE "NO APLICA EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE NO LE APLICA
7	ANEXO 1.1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 48 Y 49; YA QUE NO SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
8	NUMERAL 2.3	DERIVADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL POR COVID 19, AL OFERTAR EQUIPO DE IMPORTACIÓN, LA LLEGADA DE ESTOS EQUIPOS A MÉXICO SE VE RETRASADA. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA QUE LOS BIENES DE INVERSIÓN ADJUDICADOS SEAN ENTREGAMOS A MÁS TARDAR 90 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE ESPECIFICAR PARTIDAS

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

9	PARTIDA 8 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (UCIA)	3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 21.5", MIENTRAS CONTINÚE DESPLEGANDO LA INFORMACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	PARTIDA 8 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (UCIA)	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3 MB PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE PERMITE OFERTAR RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280 X 1024 ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 6, DE ÉSTA JUNTA DE ACLARACIONES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

11	PARTIDA 8 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (UCIA)	18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
12	PARTIDA 8 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (UCIA)	19. CON POSIBILIDAD DE QUE PERMITA CARGAR AUTOMÁTICAMENTE DATOS NUMÉRICOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO RECOPIADOS POR EL MONITOR, CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA CENTRAL, LOS DATOS SE DEBEN CARGAR CUANDO EL MONITOR SE RECONECTA A LA CENTRAL DE MONITOREO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO TENER LA OPCIÓN NO AFECTA AL USO PRINCIPAL DEL EQUIPO QUE ES MONITOREAR AL PACIENTE EN EL ÁREA DESTINADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
13	PARTIDA 9 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIA)	1.12 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE AL MENOS DE 72 HRS, ASÍ COMO ALMACENAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE EVENTOS. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA Y PUESTO QUE EN LA UNIDAD CENTRAL SE PUEDE AGREGAR EL ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN A 72 HORAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON AL MENOS 24 HRS DE TENDENCIAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA OTROS OFERTANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
14	PARTIDA 9 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIA)	1.17. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	
15	PARTIDA 9 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIA)	1.18. QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS EN FORMATO DICOM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
16	PARTIDA 9 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIA)	1.25.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS MONITORES POR TÉCNICA MAINSTREAM ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA TODOS LOS MONITORES TÉCNICA MICROSTREAM, LA CUAL NOS FACULTA A TENER MEDICIÓN PARA PACIENTES INTUBADOS Y NO INTUBADOS, LO QUE OFRECE MÁS FLEXIBILIDAD A LA OFERTA. SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
17	PARTIDA 10 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA)	3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 21.5", MIENTRAS CONTINÚE DESPLEGANDO LA INFORMACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	PARTIDA 10 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA)	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3 MB PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE PERMITE OFERTAR RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280 X 1024 ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NO. 6 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
19	PARTIDA 10 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA)	18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	
20	PARTIDA 10 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA)	19. CON POSIBILIDAD DE QUE PERMITA CARGAR AUTOMÁTICAMENTE DATOS NUMÉRICOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO RECOPIADOS POR EL MONITOR, CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA CENTRAL, LOS DATOS SE DEBEN CARGAR CUANDO EL MONITOR SE RECONECTA A LA CENTRAL DE MONITOREO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO TENER LA OPCIÓN NO AFECTA AL USO PRINCIPAL DEL EQUIPO QUE ES MONITOREAR AL PACIENTE EN EL ÁREA DESTINADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
21	PARTIDA 11 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA)	1.12 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE AL MENOS DE 72 HRS, ASÍ COMO ALMACENAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE EVENTOS. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA Y PUESTO QUE EN LA UNIDAD CENTRAL SE PUEDE AGREGAR EL ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN A 72 HORAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON AL MENOS 24 HRS DE TENDENCIAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA OTROS OFERTANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
22	PARTIDA 11 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA)	1.17. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

23	PARTIDA 11 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA)	1.18. QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS EN FORMATO DICOM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
24	PARTIDA 11 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA)	1.25.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS MONITORES POR TÉCNICA MAINSTREAM ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA TODOS LOS MONITORES TÉCNICA MICROSTREAM, LA CUAL NOS FACULTA A TENER MEDICIÓN PARA PACIENTES INTUBADOS Y NO INTUBADOS, LO QUE OFRECE MÁS FLEXIBILIDAD A LA OFERTA. SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
25	PARTIDA 12 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (OBSERVACIÓN ADULTOS)	3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 21.5", MIENTRAS CONTINÚE DESPLEGANDO LA INFORMACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
26	PARTIDA 12 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (OBSERVACIÓN ADULTOS)	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3 MB PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE PERMITE OFERTAR RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280 X 1024 ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NO. 6 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
27	PARTIDA 12 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (OBSERVACIÓN ADULTOS)	18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	
28	PARTIDA 12 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (OBSERVACIÓN ADULTOS)	19. CON POSIBILIDAD DE QUE PERMITA CARGAR AUTOMÁTICAMENTE DATOS NUMÉRICOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO RECOPIADOS POR EL MONITOR, CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA CENTRAL, LOS DATOS SE DEBEN CARGAR CUANDO EL MONITOR SE RECONECTA A LA CENTRAL DE MONITOREO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO TENER LA OPCIÓN NO AFECTA AL USO PRINCIPAL DEL EQUIPO QUE ES MONITOREAR AL PACIENTE EN EL ÁREA DESTINADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
29	PARTIDA 13 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (OBSERVACIÓN ADULTOS)	1.12 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE AL MENOS DE 72 HRS, ASÍ COMO ALMACENAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE EVENTOS. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA Y PUESTO QUE EN LA UNIDAD CENTRAL SE PUEDE AGREGAR EL ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN A 72 HORAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON AL MENOS 24 HRS DE TENDENCIAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA OTROS OFERTANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
30	PARTIDA 13 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (OBSERVACIÓN ADULTOS)	1.17. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
31	PARTIDA 13 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (OBSERVACIÓN ADULTOS)	1.18. QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS EN FORMATO DICOM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	
32	PARTIDA 13 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (OBSERVACIÓN ADULTOS)	1.25.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS MONITORES POR TÉCNICA MAINSTREAM ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA TODOS LOS MONITORES TÉCNICA MICROSTREAM, LA CUAL NOS FACULTA A TENER MEDICIÓN PARA PACIENTES INTUBADOS Y NO INTUBADOS, LO QUE OFRECE MÁS FLEXIBILIDAD A LA OFERTA. SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
33	PARTIDA 14 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (UCIN)	3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 21.5", MIENTRAS CONTINÚE DESPLEGANDO LA INFORMACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
34	PARTIDA 14 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (UCIN)	3.1 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA COMO MÍNIMO 3 MB PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE PERMITE OFERTAR RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280 X 1024 ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NO. 6 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
35	PARTIDA 14 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (UCIN)	18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
36	PARTIDA 14 - CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (UCIN)	19. CON POSIBILIDAD DE QUE PERMITA CARGAR AUTOMÁTICAMENTE DATOS NUMÉRICOS EN LA CENTRAL DE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		MONITOREO RECOPIADOS POR EL MONITOR, CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA CENTRAL, LOS DATOS SE DEBEN CARGAR CUANDO EL MONITOR SE RECONECTA A LA CENTRAL DE MONITOREO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO TENER LA OPCIÓN NO AFECTA AL USO PRINCIPAL DEL EQUIPO QUE ES MONITOREAR AL PACIENTE EN EL ÁREA DESTINADA. ¿SE ACEPTA?	
37	PARTIDA 15 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN)	1.12 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE AL MENOS DE 72 HRS, ASÍ COMO ALMACENAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE EVENTOS. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA Y PUESTO QUE EN LA UNIDAD CENTRAL SE PUEDE AGREGAR EL ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN A 72 HORAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON AL MENOS 24 HRS DE TENDENCIAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA OTROS OFERTANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
38	PARTIDA 15 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN)	1.17. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
39	PARTIDA 15 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN)	1.18. QUE PERMITA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA PACS EN FORMATO DICOM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA A FUTURO, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE LA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		CAPACIDAD DE REALIZARLO EN MANUALES Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	
40	PARTIDA 15 - MONITOR DE SIGNOS VITALES (UCIN)	1.25.2 MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA: TRES MONITORES POR TÉCNICA SIDESTREAM Y DOS MONITORES POR TÉCNICA MAINSTREAM ALARMAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA TODOS LOS MONITORES TÉCNICA MICROSTREAM, LA CUAL NOS FACULTA A TENER MEDICIÓN PARA PACIENTES INTUBADOS Y NO INTUBADOS, LO QUE OFRECE MÁS FLEXIBILIDAD A LA OFERTA. SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
41	PARTIDA 32 - SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA PACIENTES NEONATALES.	13.- UN COLCHÓN CON CUBIERTA DE POLIURETANO, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y DIMENSIONES ACORDE AL MODELO, LIBRE DE PVC, NO IRRITANTE, RETARDANTE AL FUEGO, RESISTENTE AL LAVADO QUÍMICO Y A LA ABRASIÓN, IMPERMEABLE, ANTIBACTERIAL Y LIBRE DE OLORES. PREGUNTA: CON EL FIN DE CONTAR CON UNA FUENTE ADICIONAL DE CALOR Y ASÍ BUSCAR APOYAR A LA CORRECTA TERMORREGULACIÓN DEL PACIENTE A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONTACTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN COLCHÓN CALEFACTOR O DE CALENTAMIENTO RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
42	PARTIDA 32 - SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA PACIENTES NEONATALES.	4.3.- POTENCIA DEL CALENTADOR DE 0 AL 100% EN INCREMENTOS DE MÁXIMO 5%, MOSTRADO EN FORMA GRÁFICA Y NUMÉRICA. PREGUNTA: DADO QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD DONDE LIMITA EL SUMINISTRO DE CALOR A LOS 15 MINUTOS SI LA POTENCIA DEL CALENTADOR ES AJUSTADA POR ENCIMA DEL 30%, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR, COMO OPCIÓN A ESTE PUNTO, EQUIPOS CON POTENCIA DEL CALENTADOR DE 0 A 100% EN INCREMENTOS DE 10%, MOSTRADO EN FORMA GRÁFICA Y NUMÉRICA, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI LA SEGURIDAD HACIA EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO DESCRITO EN LA FICHA TÉCNICA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

25.- CORPORATIVO PROMED, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO AL ANEXO 29 , SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA, YA QUE EN EL CASO DE ACERO LOS TIEMPO DE 20 DÍAS ES MUY CORTO PARA LA FABRICACIÓN.	DEBERA ATENDER LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CADA BIEN CONFORME AL ANEXO 29 O INDICAR A QUE PARTIDA EN ESPECÍFICO SE REQUIERE
2	PARTIDA 69 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BAYONETAS DE ACERO ACABADO CROMADO Y PERILLAS DE PLÁSTICO COLOR NEGRO. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL MUEBLE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO
3	PARTIDA 68 MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	NUMERAL 1- MESA DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X0.70X0.90M CON CUATRO CAJONES CENTRALES Y ENTREPAÑOS LATERALES. PREGUNTAS: SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR IMAGEN DE LA MESA SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR LA MEDIDA DE LOS CAJONES SE SOLICITA INDICAR CUANTOS ENTREPAÑOS SE REQUIEREN DE CADA LADO SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR LAS MEDIDAS QUE REQUIEREN PARA LOS ENTREPAÑOS SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR SI EL ACABADO DE LOS ENTREPAÑOS ES EN PINTURA	USTEDES DEBERAN PROPORCIONAR EL BOSQUEJO DE LA MESA PROPUESTA. DOS CAJONES DE ALTURA DE 30CM EN EL EXTREMO DERECHO, EN EL EXTREMO IZQUIERDO DOS ENTREPAÑOS DE ALTURA DE 30 CM X 42 CM DE ANCHO, EN LA PARTE DE EN MEDIO UN CAJON DE ALTURA DE 10 CM X ANCHO DE 42CM EL ACABADO DE LOS ENTREPAÑOS Y CAJONES DEERAN DE SER DE ACERO EN PINTURA DEL POLVO POLIESTER EPOXICA HORNEADA COLOR BEIGE
		NUMERAL 2- MESA DE ACERO INOXIDABLE 2.20 X0.90X0.90M CON CUATRO CAJONES CENTRALES Y ENTREPAÑOS LATERALES PREGUNTAS: SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR IMAGEN DE LA MESA SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR LA MEDIDA DE LOS CAJONES SE SOLICITA INDICAR CUANTOS ENTREPAÑOS SE REQUIEREN DE CADA LADO SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR LAS MEDIDAS QUE REQUIEREN PARA LOS ENTREPAÑOS	USTEDES DEBERAN PROPORCIONAR EL BOSQUEJO DE LA MESA PROPUESTA. DOS CAJONES DE ALTURA DE 30CM EN EL EXTREMO DERECHO, EN EL EXTREMO IZQUIERDO DOS ENTREPAÑOS DE ALTURA DE 30 CM X 42 CM DE ANCHO, EN LA PARTE DE EN MEDIO UN CAJON DE ALTURA DE 10 CM X ANCHO DE 42CM




ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

			EL ACABADO DE LOS ENTREPAÑOS Y CAJONES DEERAN DE SER DE ACERO EN PINTURA DEL POLVO POLIESTER EPOXICA HORNEADA COLOR BEIGE
		NUMERAL 3- MESA DE ACERO INOXIDABLE 60 X70X0.90 CM. PREGUNTAS: SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR IMAGEN DE LA MESA SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR MEDIDA DEL CAJON	LA MEDIDA DEL CAJÓN DEBE SER DE 10 CM DE ALTO , ANCHO 42 CM EN EL EXTREMO DERECHO
		NUMERAL 7- MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.40 X0.70X0.90M CON CUATRO CAJONES CENTRALES Y ENTREPAÑOS LATERALES. PREGUNTAS: SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR IMAGEN DE LA MESA SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR LA MEDIDA DE LOS CAJONES SE SOLICITA INDICAR CUANTOS ENTREPAÑOS SE REQUIEREN DE CADA LADO SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR LAS MEDIDAS QUE REQUIEREN PARA LOS ENTREPAÑOS SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR SI EL ACABADO DE LOS ENTREPAÑOS ES EN PINTURA	LA MEDIDA DEL CAJÓN DEBE SER DE 10 CM DE ALTO , ANCHO 42 CM EN EL EXTREMO DERECHO EN EL EXTREMO IZQUIERDO DOS ENTREPAÑOS DE ALTURA DE 30 CM X 42 CM DE ANCHO, EL ACABADO DE LOS ENTREPAÑOS Y CAJONES DEERAN DE SER DE ACERO EN PINTURA DEL POLVO POLIESTER EPOXICA HORNEADA COLOR BEIGE
		NUMERAL 10- MESA DE TRABAJO PARA FARMACOTECNIA PREGUNTAS: SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR IMAGEN DE LA MESA	NO SE CUENTA CON IMAGEN
		PUNTO 10.9.3 SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR LA MEDIDA DE LOS GABINETES FAVOR DE INDICAR SI LOS GABINETES SON UNIDOS (SOLDADOS) A LA ESTRUCTURA DE LA MESA	LOS GABINETES DEBERAN SER MOVILES
		PUNTO 10.9.6 SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR SI EL CAJON QUE SOLICITA ES PARTE DEL GABINETE QUE PIDEN EN EL PUNTO 10.9.3 O ES INDEPENDIENTE AL GABINETE	ES INDEPENDIENTE DEL GABINETE. DEBE COLOCARSE EN LA PARTE INFERIOR DE LA MESA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		EN CASO DE QUE EL CAJON SEA INDEPENDIENTE AL GABINETE DEL PUNTO 10.9.3 FAVOR DE INDICAR EN QUE PARTE DE LA MESA SE DEBE COLOCAR	
		PUNTO 10.9.7 SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR SI EL ESTANTE QUE SOLICITA ES PARTE DEL GABINETE QUE PIDEN EN EL PUNTO 10.9.3 O ES INDEPENDIENTE AL GABINETE EN CASO DE QUE EL ESTANTE SEA INDEPENDIENTE AL GABINETE DEL PUNTO 10.9.3 FAVOR DE INDICAR EN QUE PARTE DE LA MESA SE DEBE COLOCAR	ES INDEPENDIENTE AL GABINETE. SE DEBE COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA MESA 
		NUMERAL 12- MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE. PREGUNTAS: SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR IMAGEN DE LA MESA SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR LA MEDIDA DE LOS CAJONES SE SOLICITA FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON ENTREPAÑOS TIPO GAVETA SE SOLICITA INDICAR CUANTOS ENTREPAÑOS SE REQUIEREN DE CADA LADO SE SOLICITA FAVOR DE PROPORCIONAR LAS MEDIDAS QUE REQUIEREN PARA LOS ENTREPAÑOS SE SOLICITA FAVOR DE INDICAR SI EL ACABADO DE LOS ENTREPAÑOS ES EN PINTURA	LOS CAJONES DEBEN SER DE 10 CM DE ALTO X 4CM DE ANCHO Y PROPORCIONALES AL LARGO DE LA MESA. SOLO SE REQUIERE DOS ENTREPAÑO EN LA PARTE INFERIOR DE LA MESA DE ALTURA DE 30CM Y 42 CM DE ANCHO
4	PARTIDA 87 PORTALEBRILLO DOBLE	SE SOLICITA PODER OFERTAR RODAJA DE HULE COLOR GRIS DE 50.8 MM (2") CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL MUEBLE.	NO SE ACEPTA
5	PARTIDA 93 SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE	¿ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO CON LAS DESCRIPCIONES PROPORCIONADAS EL PRODUCTO QUE SOLICITAN ES UNA SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? PUNTO 8. SE SOLICITA PODER OFERTAR CUADRO DE LAMINA DE 40X40 CM, INCLUIR	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		DOS CAJONES DE LÁMINA DENTRO DEL INTERIOR, DE FÁCIL DESLIZAMIENTO, CON JALADERAS EMBUTIDAS, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO.	
--	--	---	--

26. - LABORATORIOS SAAV, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES"	SE CONSULTA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PARTIDAS QUE ESTABLECE EL CITADO ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE BIENES SON LAS SUSCEPTIBLES DE SER OFERTADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN, EN RAZÓN DE QUE SON LAS QUE CUENTAN CON FICHA TÉCNICA, ASÍ COMO MANIFESTAR QUE DICHO ANEXO NO ES COINCIDENTE CON EL NÚMERO DE PARTIDAS QUE ESTABLECE EL "ANEXO 1.8 PREESCRIPCIONES DE BIENES", ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PREESCRIPCIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
2	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1 MUESTRAS	SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITAN MUESTRAS FÍSICAS DE PARTIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL CITADO "ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE BIENES" Y QUE TAMPOCO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA VERIFICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS, LO QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE RUBRO, POR EJEMPLO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO DE REANIMACIÓN, VENTILADOR VOLUMÉTRICO, MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL, ENTRE OTRAS. FAVOR DE ACLARAR, O EN SU DEFECTO, COMPARTIR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PREESCRIPCIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
3	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1 MUESTRAS	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y DE LOS PLAZOS RECORTADOS, LA VIABILIDAD DE PRESENTAR LAS MUESTRAS DE LOS EQUIPOS DE FORMA VIDEOGRÁFICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
4	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.2 VISITAS	SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE VARIAS DE LAS PARTIDAS SEÑALADAS EN ESTE NUMERAL QUE REQUIEREN VISITA, NO TIENEN COINCIDENCIA CON EL "ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE BIENES", ASÍ COMO TAMPOCO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PREESCRIPCIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CORRESPONDIENTE, COMO ES EL CASO DE LAS PARTIDAS: 1,2,3,4,7,21,25,30, 36, 37, 41 Y 163. FAVOR DE ACLARAR, O EN SU DEFECTO, PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	
5	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.1.5 GUIAS MECÁNICAS	SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE VARIAS DE LAS PARTIDAS SEÑALADAS EN ESTE NUMERAL QUE REQUIEREN GUÍA MECÁNICA, NO TIENEN COINCIDENCIA CON EL "ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE BIENES", ASÍ COMO TAMPOCO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, COMO ES EL CASO DE LAS PARTIDAS: 1,2,3,4,7,21,25,30, 36, 37, 41 Y 163. FAVOR DE ACLARAR, O EN SU DEFECTO, PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
6	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.1.6 CRONOGRAMA DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN	SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE VARIAS DE LAS PARTIDAS SEÑALADAS EN ESTE NUMERAL QUE REQUIEREN CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN, NO TIENEN COINCIDENCIA CON EL "ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE BIENES", ASÍ COMO TAMPOCO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, COMO ES EL CASO DE LAS PARTIDAS: 1,2,3,4,7,21,25,30, 36, 37, 41 Y 163. FAVOR DE ACLARAR, O EN SU DEFECTO, PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE.
7	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE NO HAY CONGRUENCIA EN LOS PLAZOS DE ENTREGA SEÑALADOS EN DICHO ANEXO YA QUE ESTABLECE DISTINTOS PLAZOS DE ENTREGA PARA MISMAS PARTIDAS CON IGUAL CLAVE SAICA, POR TANTO, SE CONSULTA ATENTAMENTE LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS BIENES, EJEMPLO DE INCONSISTENCIA: CENTRAL DE MONITOREO SEÑALA UN PLAZO DE ENTREGA DE 15 DÍAS Y EN EL CITADO ANEXO 29 LA MISMA PARTIDA Y CLAVE SAICA LÍNEAS ABAJO ESTABLECE UN PLAZO DE ENTREGA DE 105 DÍAS. FAVOR DE ACLARAR, O EN SU DEFECTO, PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	SE DA RESPUESTA A SU PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 2, DE LA CONVOCANTE.
8	PARTIDA 118, CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS, FICHA TÉCNICA	SE CONSULTA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CUAL ES LA CAPACIDAD REQUERIDA DEL CONGELADOR, YA QUE NO SE ADVIERTE EN SU FICHA TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NO. 3 DE LA PRESENTE JUNTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

27. - CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	10. PENAS CONVENCIONALES. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 42 PRIMER PÁRRAFO Y 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LOS ARTÍCULOS 57 Y 58 DE SU REGLAMENTO Y EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO 5.13 DE LA CIRCULAR UNO 2019, "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS", VIGENTE POR CADA DÍA NATURAL QUE TRANSCURRA DE INCUMPLIMIENTO, "LA CONVOCANTE" APLICARÁ AL PROVEEDOR, PENAS CONVENCIONALES CALCULADAS SOBRE EL IMPORTE TOTAL POR LOS BIENES NO ENTREGADOS Y/O SERVICIOS NO REALIZADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO. EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARÁ DEL IMPORTE FACTURADO QUE CORRESPONDA A LA OPERACIÓN ESPECÍFICA DE QUE SE TRATE Y ÚNICAMENTE SE LIQUIDARÁ AL PROVEEDOR LA DIFERENCIA QUE RESULTE. EN NINGÚN CASO EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE ACEPTARÁ EN ESPECIE. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS MENCIONADAS, EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE ORDEN CIVIL, ECONÓMICO, PENAL Y ADMINISTRATIVO, QUE EN SU CASO PROCEDAN.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR, EN EL PUNTO 10. PENAS CONVENCIONALES, LOS PORCENTAJES AHÍ SEÑALADOS, REFERENTES AL VALOR DE LOS EQUIPOS NO ENTREGADOS, SON SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	ES CORRECTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.13.1 DE LA CIRCULAR UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, LAS PENAS CONVENCIONALES NO INCLUYEN EL I.V.A.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

28. - IBIO MEDICAL, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, QUE EN CASO DE NO OFERTAR BIENES DE ORIGEN NACIONAL SE PRESENTE UNA CARTA CON UNA LEYENDA DONDE MENCIONE QUE NO NOS APLICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, SEA CUAL SEA ESTÉ, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.
2	3.2 DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 3.3 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	SE ENTIENDE QUE SON DOS FIANZAS EN EL PUNTO 3.2 ES PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA Y EN EL PUNTO 3.3 ES UNA VEZ ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.
3	4.4PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS	DICE: PARA UN MEJOR CONTROL Y AGILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO, EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA). LO SEÑALADO EN ESTE PÁRRAFO, ES CON OBJETO DE UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y NO TENDRÁ FINES DE DESCALIFICACIÓN. SE ENTIENDE QUE LA FALTA LE FOLIO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA). LO SEÑALADO EN ESTE PÁRRAFO, ES CON OBJETO DE UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y NO TENDRÁ FINES DE DESCALIFICACIÓN.
4	4.7.1.3 NORMASY CERTIFICACIONES	DICE: EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO 1.5 EN LA QUE MANIFIESTE QUE EL BIEN OFERTADO SE APEGUE A LAS GUENTES NORMAS (CUANDO APLIQUE): ... ¿ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERA EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN NACIONAL Y EN CASO DE QUE NO NOS APLIQUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN MANIFIESTO	EN EL PUNTO 4.7.1.3 ESTA EL APARTADO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR UN BIEN NACIONAL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		EN DONDE SE INDIQUE QUE NO NOS APLICA, ¿SE ACEPTA?	
5	4.7.1.3 NORMASY CERTIFICACIONES	DICE: 1.2 CERTIFICADOS 1.2.2 PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO 1.2.2.1 CERTIFICADO FDA O CE O JIS O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN 1.2.2.2 CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN ¿ENTENDEMOS QUE BASTARA CON LA PRESENTACION DEL ISO 13485 ¿Y SE OMITIRA EL ISO 9001, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
6	4.7.1.3 NORMASY CERTIFICACIONES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PUNTO 4.7.1.3 ¿SON SOLO COPIAS SIMPLE Y NO DOCUMENTOS ORIGINALES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
7	4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DICE: PARA TODAS LAS PARTIDAS EL OFERENTE, DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL, CARTA DE APOYO SOLIDARIO PARA EQUIPO MÉDICO (DE ACUERDO CON ANEXO 1) "SE MANIFIESTA QUE EL BIEN QUE SE ENTREGARÁ EN EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA; SERÁ NUEVO Y CORRESPONDEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1.1, FICHAS TÉCNICAS, DE LA (S) PARTIDA(S) (INDICAR PARTIDA(S) OFERTADA(S) DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN (NÚMERO DE PROCEDIMIENTO) Y A LO ESTIPULADO EN LA (S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES RESPECTIVA(S). DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL OFERENTE) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL BIEN EN LAS FECHAS PACTADAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Y GARANTÍA DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR (NÚMERO DE AÑOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1.8) AÑO(S); A LA SUSTITUCIÓN DE BIENES QUE PRESENTEN VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O FALLAS RECURRENTE QUE EVIDENCIEN PROBLEMAS DE CALIDAD EN EL EQUIPO; A LA ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN; ASI COMO A GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ACCESORIOS, REFACCIONES Y CONSUMIBLES NUEVOS Y ORIGINALES, POR UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUESTA EN MARCHA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ COLOCAR EL TEXTO SEGÚN EL TIPO PUDIENDO SER EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		DEL BIEN INSTALADO A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE". ENTENDEMOS QUE ES UNA CARTA EN FORMATO LIBRE DEBIENDO CONTENER CADA UNO DE LOS PUNTOS CITADOS EN EL PUNTO 4.7.1.4. SEGÚN NOS APLIQUE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
8	4.7.1.12 LICENCIAMIENTO (APLICA PARA LAS PARTIDAS 3,4,5,6,7,23 Y 111	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE NO OFERTAR BIENES QUE REQUIERAN LICENCIAMIENTO NOS PERMITA PRESENTAR UN MANIFIESTO DONDE INDIQUE QUE NO NOS APLICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
9	4.7.1.13 CUMPLIMIENTO DE LA NOM 229-SSA1 2002 (APLICA PARA LAS PARTIDAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO QUE UTILIZAN RAYOS X)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE NO OFERTAR BIENES QUE REQUIERAN LICENCIAMIENTO NOS PERMITA PRESENTAR UN MANIFIESTO DONDE INDIQUE QUE NO NOS APLICA. ¿SE ACEPTA?	ESTÁ MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
10	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTAN LIGADOS AL ANEXO 29, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, LOS BIENES DEACUERDO A LA PARTIDA QUE OFERTE DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO ANEXO
11	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	DICE: INCISO G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: - IMPUESTO PREDIAL, - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, - IMPUESTO SOBRE NÓMINA, - IMPUESTO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, - IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, - IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE,	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		- DERECHOS SOBRE SUMINISTRO DE AGUA, (EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN A MI RESPRESENTADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACIÓN?	
12	4.7.1.9 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	• CURRÍCULUM VITAE (MÁXIMO 1 CUARTILLA) DEL PERSONAL QUE SE ENLISTA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS DE EQUIPO MÉDICO DE LA PARTIDA OFERTADA. ¿ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PODREMOS PRESENTAR CURRÍCULUM DE PERSONAL DEL LICITANTE Y TAMBIEN PERSONAL DEL FABRICANTE CON EXPERIENCIA DE 3 AÑOS DE EQUIPO MEDICO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS ES ESTO CORRECTO?	LA INFORMACIÓN DEBERÁ DE SER DEL INGENIERO QUE DARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INCISOS H, I, J, K L	ENTENDEMOS QUE TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A ESTOS INCISOS QUE SE GENERAN A TRAVÉS DE UN PORTAL EN LÍNEA SE DEREBERÁN IMPRIMIR Y ESTOS SERÁN TOMADOS COMO ORIGINALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
14	ANEXO 25	DICE: PRESENTAR ÚNICAMENTE SI SE PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION LA OMISION DE ESTE ANEXO O EN SU CASO NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO DONDE INDIQUEMOS QUE NO NOS APLICA. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
15	2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN.	SÓLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS BIENES OFERTADOS DE ORIGEN EXTRANJERO SE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE ESCRITO CON LA LEYENDA 0% DE INTEGRACIÓN NACIONAL, YA QUE LOS BIENES SON IMPORTADOS. ¿SE ACEPTA?	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÁ IINDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN SEA CUAL SEA ESTE, ASÍ COMO EL PAÍS DE ORIGEN.
16	3.2 DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.	DICE: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, "LOS LICITANTES" DEBERÁN GARANTIZAR LA FORMALIDAD DE SUS PROPUESTAS, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ANTES DE I.V.A. ENTENDEMOS QUE EL RESPECTIVO SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA FORMARA PARTE DE LA PROPUESTA	ES CORRECTO EL SOSTENIMIENTO DE SU PROPUESTA DEBE DE FORMAR PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		TÉCNICA – ECONÓMICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
17	BASES DE LA LICITACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUIEN VAN DIRIGIDOS LOS ANEXOS Y MANIFIESTOS.	MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUAREZ, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
18	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	DICE: LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PRESENTE NUMERAL (INCISOS "A" AL "L"), DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DEL SOBRE ÚNICO (CAJA, PAQUETE, ETC.), DE FORMA IMPRESA Y ESCANEADA DE MANERA LEGIBLE Y COMPLETA (EN FORMATO PDF) EN CD O DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (USB) Y ADEMÁS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE, LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PRESENTADA SERÁ DEVUELTA AL TÉRMINO DE SU REVISIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS ARCHIVOS ORIGINALES EN FORMATO PDF SIN NECESIDAD DE SER ESCANEADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ENTREGAR LO SOLICITADO EN DICHO NUMERAL.
	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	PARTIDA 47 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE, DE LA FICHA TÉCNICA, NUMERAL 3. PORTA CHASIS A TODO LO LARGO CON SISTEMA DE SUJECCIÓN. ¿ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE HACE REFERENCIA A UN SISTEMA CON SOPORTES PARA CHASIS QUE PERMITAN LA COLOCACIÓN DE ESTE EN DIFERENTES POSICIONES? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
	ANEXO TÉCNICO, EN PARTIDAS GENERAL.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA CARACTERÍSTICA QUE NO SE PUEDA REFERENCIAR DE MANERA TEXTUAL EN LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES DE LOS EQUIPOS, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	PARTIDA 47 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE, DE LA FICHA TÉCNICA, NUMERAL 8 CANASTILLA PARA EFECTOS PERSONALES. DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERÍSTICA HACE REFERENCIA A UN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DESTINADO A LOS OBJETOS DEL PACIENTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	PARTIDA 47 CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE, DE LA FICHA TÉCNICA, NUMERAL 9.2. CONDUCTIVAS ANTIESTÁTICAS. DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERÍSTICA HACE REFERENCIA A UN SISTEMA QUE BUSCA PROTEGER AL PACIENTE DE DESCARGAS ELECTRICAS ESTATICAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	PARTIDA 47 CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE, DE LA FICHA TÉCNICA, NUMERAL 10.3, PESO DEL PACIENTE MAYOR OIGUAL A 180 KG. ENTENDEMOS A QUE, EN MÉXICO, EL 70% DE LOS MEXICANOS PADECE SOBREPESO Y CASI UNA TERCERA PARTE SUFRE DE OBESIDAD, LA CARGA MÍNIMA DE TRABAJO DE LA CAMILLA DEBE SER SUPERIOR A 320 KG ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA
	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	PARTIDA 47 CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE, DE LA FICHA TÉCNICA, NUMERAL 11.4 ALTURA VARIABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 66 A 90 CM ± 10CM. DEBEMOS ENTENDER QUE LA CAMILLA TENGA UN DESCENSO AÚN MÁS ABAJO QUE EL SOLICITADO, ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR, POR LO QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUE DE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARALOS DEMAS PARTICIPANTES

29. MARIA SUSANA GONZÁLEZ CARPIO PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 26	LO REFERENTE A LA CAPACITACIÓN AL INSTRUMENTAL MÉDICO, ¿COMO SE DEBE REALIZAR?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO (DESCONTAMINACIÓN, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN) Y CUIDADO, DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN EL ANEXO 1.8
2	9	AL SER ADJUDICADA UNA Ó MÁS PARTIDAS, ¿ES OBLIGATORIO REQUERIR EL ANTICIPO DEL 50%?, ¿CUÁL SERÍA EL PROCEDIMNETO DE PAGO SI SE ENTREGA LA PARTIDA CON ENTREGA INMEDIATA EN SU TOTALIDA 100% DE LA MISMA?, SI SE ADJUDICARAN 2 O MÁS PARTIDAS SE REALIZA 1 SOLA FACTURA O SE TIENE QUE FACTURAR POR CADA UNA DE LAS PARTIDA.	NO SERÁ OBLIGATORIO REQUERIR EL ANTICIPO, SI SU ENTREGA LA TIENE PROGRAMADA PARA COMO INMEDIATA. PARA EL CASO DEL PAGO UNA VEZ ENTREGADO LOS BIENES, SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SEA INGRESADA AL SISTEMA LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE LA CLC, CONFORME AL ARTÍCULO 54B DE LA LEY DE AUSTERIDAD



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

			TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
3	4.7.1.23	CON RESPECTO CON LAS PRUEBAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUE ESTÁN SOLICITANDO LA CERTIFICACIÓN POR LA EMA "ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN", EMA CUENTA CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE ILAC "COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS" PARA LABORATORIOS DE ENSAYO, LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y UNIDADES DE VERIFICACIÓN. ¿LAS PRUEBAS SON ACEPTADAS DE IGUAL FORMA CON LA ACREDITACIÓN ILAC SIENDO QUE CUENTAN CON EL ACUERDO MUTUO?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LOS RESULTADOS SEAN REFERENCIADOS CON LA FARMACOPEA
4	PÁG.12, 4.5 INCISO E)	CUANDO ES UNA PERSONA FÍSICA ¿QUE DOCUMENTO DEBE PRESENTAR YA QUE HABLAN DE UN PODER NOTARIAL?	DEBERÁ PRESENTAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO E)
5	4.5.1.INCISO B)	CON QUE DOCUMENTO SE PRESENTA PARA AL NO ESAR SUJETO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS POR VIVIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO	EN EL ANEXO 4 DEBERÁ PRESENTAR E INDICAR LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO.
6	PÁG. 16 Y 4.6.1 (PROPUESTA TÉCNICA)	EN DONDE ESTAN EL ANEXO 1 Y 1 ANEXO1.1 (FICHAS TÉCNICAS) MENTIONADOS	EL ANEXO 1 SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA 50 Y EL ANEXO 1.1 EN LA PÁGINA 59

30. - KEZELMEDICAL, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.5 PROPUESTA LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CON RELACIÓN AL INCISO G) ANEXO 3, SE ENTIENDE QUE CUANDO NO APLIQUEN PARA MI REPRESENTADA LOS INMPUESTOS EN DICHO INCISO G), Y TOMANDO EN CUANTA QUE SE LLENARÁ EL ANEXO 3 EN LA COLUMNA "NO APLICA" Y QUE NO SE ADJUNTARA LA CONSTANCIA DE ADEUDOS, ¿SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO PRESENTAR DICHA "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EN LA PROPUESTA LEGAL Y ADMINISTRATIVA?	EL ANEXO 4 SE DEBERÁ PRESENTAR INDICANDO LOS SUPUESTOS QUE LE APLICA Y LOS QUE NO LE APLICAN EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ES APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SER EL CASO
2	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA.ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS	CON RELACIÓN A LAS FICHAS TÉCNICAS, EN EL ANÁLISIS DE DICHO APARTADO SE DETECTÓ EL FALTANTE DE LAS FICHAS TÉCNICAS RELATIVAS A LAS	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESIDIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		SIGUIENTES PARTIDAS 24, 26, 27, 33, 35, 42, 46, 48, 78 Y 194 ¿SE VAN ANEXAR LAS FICHAS TÉCNICAS FALTANTES?	
3	GENERAL	CON RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, ¿EL FOLIO SE VAN A CONSIDERAR CONSECUTIVO, POR SECCIONES, ES DECIR: UN FOLIO PARA PROPUESTA LEGAL ADMINISTRATIVA, OTRO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y OTRO FOLIO PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA "FAVOR DE ACLARAR"	LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA). LO SEÑALADO EN ESTE PÁRRAFO, ES CON OBJETO DE UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y NO TENDRÁ FINES DE DESCALIFICACIÓN.

31. - LAB- TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	
1	PUNTO 4.5 INCISO G) CONSTANCIA DE ADEUDOS	EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL INCISO G) CONSTANCIA DE ADEUDOS, NO APLICA PARA MI REPRESENTADA, YA QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE GUADALAJARA, JALISCO. BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO DE NO APLICA?	DEBERÁ REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 CON LOS QUE LE APLIQUEN O NO
2	PUNTO 4.7.1.4 CARTAS DE APOYO	POR TRATARSE DE EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTRANJERO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR IMPRESAS A COLOR LAS CARTAS DE APOYO DE LOS FABRICANTES QUE NOS ENVÍEN POR CORREO ELECTRÓNICO Y CUENTEN COMO ORIGINAL.	LAS CARTAS DE APOYO DE FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PUEDE PRESENTARSE IMPRESAS, SIN EMBARGO DEBERÁN ADJUNTAR EL CORREO ELECTRÓNICO DEL ENVÍO POR PARTE DE FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN CASO DE NO ADJUNTAR EL CORREO ELECTRÓNICO SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
3	PUNTO 4.7.1.9 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO.	¿PARA LOS CERTIFICADOS, CÉDULAS, CV Y CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DE INGENIEROS, BASTARÁ CON PRESENTAR IMPRESIONES A COLOR Y CONTARÁ COMO ORIGINAL?	PARA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EL PUNTO 4.7.1.9 VIÑETA 3, SOLO DEBERÁN ADJUNTAR COPIA SIMPLE.
4	PUNTO 4.7.1.18 TECNOVIGILANCIA	¿PARA EL PUNTO 4.7.1.18 DONDE SOLICITAN DOCUMENTO CERTIFICADO ORIGINAL Y COPIA DE	SI PARTICIPA CON PARTIDAS QUE REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PARA ESTAS PARTIDAS ES NECESARIO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	
		RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA, SI NO APLICA PARA LAS PARTIDAS COTIZADAS, BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO DE NO APLICA?	PRESENTAR EL ALTA DE TECNOVIGILANCIA. SI PARTICIPA EN PARTIDAS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, ENTONCES PODRÁ AGREGAR UN MANIFIESTO FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL DONDE INDIQUE QUE NO LE APLICA
5	PUNTO 4.2 VISITA A INSTALACIONES	EN BASES SE ESTABLECE QUE LA VISITA A INSTALACIONES, ES OBLIGATORIA PARA LAS PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 30, 36, 37, 41, 59, 115 Y 163. ¿EN CASO DE NO COTIZAR NINGUNA DE LAS ANTERIORES, BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO DE NO APLICA?	SI EN EL ANEXO 1.4, SU REPRESENTADA HACE MENCIÓN A CUALQUIERA DE LAS PARTIDAS CON FICHAS TÉCNICAS PUBLICADAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO MENCIONADAS EN EL PUNTO 4.2, DEBERÁ AGREGAR EL ANEXO 1.6, EN CASO CONTRARIO PODRÁ PRESENTAR UN MANIFIESTO FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE QUE NO LE APLICA
6	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO (USB)	SOLICITAN UNA COPIA ELECTRÓNICA EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CD O USB, ¿SE ACEPTA GUARDAR EN UN SOLO DISPOSITIVO LAS 3 CARPETAS REFERENCIADAS? < DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA < PROPUESTA TÉCNICA < PROPUESTA ECONÓMICA.	NO, DEBERA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN UNA USB Y POR SEPARADO, LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PODRÁ ESTAR EN OTRA USB.
7	TIEMPO DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UN TIEMPO DE ENTREGA DE 90 DÍAS PARA LAS PARTIDAS: 43, 50, 51, 51.1, 51.2, 52, 53, 53.1, 60, 63, 64, 68, 72, 81, 119, 168, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CADA BIEN CONFORME AL ANEXO 29 O ESPECIFICAR LAS PARTIDAS CONFORME A LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

32. - NUDOMI, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS INCISO A)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME DE QUÉ MANERA SE DEBEN DIRIGIR LOS ANEXOS, ESCRITOS Y DOCUMENTOS, TODA VEZ QUE EN ESTE NUMERAL INDICA DE LA SIGUIENTE MANERA: MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ DIRECTORA GENERAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LOS ANEXOS, DICE: MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA ANTERIOR DE LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS NOS CONFIRME QUE TODOS LOS ANEXOS, FORMATOS, ESCRITOS LIBRES, CARTAS, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y CARTAS DE APOYO, DEBERÁN DIRIGIRSE EN SU TOTALIDAD COMO LO INDICA LA CONVOCANTE, O DEBERÁN RESPETARSE LOS FORMATOS QUE SI VAYA DIRIGIDOS Y LOS QUE NO VENGAN DIRIGIDOS SE QUEDARÁN ASÍ. AGRADECEMOS SU AMABLE RESPUESTA.	TODOS DEBERÁN SER DIRIGIDAS A LA MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
3	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS INCISO E)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI SE DEBERÁN RUBRICAR TODAS LAS HOJAS QUE NO CONTENGAN EL NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL (COMO LO SON ANEXOS, ESCRITOS, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA) ES DECIR, CATÁLOGOS, MANUALES, REGISTROS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE.
4	4.4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS	EL FOLIO QUE INDICA, ¿DEBERÁ SER CONSECUTIVO? O ¿PODEMOS FOLIAR INDIVIDUAL, ES DECIR, LA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PUEDE FOLIAR CADA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	TERCER PÁRRAFO	PROPUESTA LEGAL ADMINISTRATIVA CON UNA SERIE DE FOLIOS, ¿LA PROPUESTA TÉCNICA CON UNA NUEVA SERIE DE FOLIOS Y LA PROPUESTA ECONÓMICA CON OTRA SERIE NUEVA DE FOLIOS?	PROPUESTA POR SEPARADO, LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA
5	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRIMER PÁRRAFO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA COTEJO EN UNA CARPETA QUE LOS CONTENGA RESPETANDO EL ORDEN EN QUE SE SOLICITA EN LOS NUMERALES, EN VIRTUD DE QUE NO SE TRASPAPLEN LOS DOCUMENTOS Y PODER TENER UN MEJOR CONTROL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA EN EL ENTENDIDO QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN VENIR DENTRO DEL SOBRE ÚNICO, CAJA, PAQUETE, ETC.
6	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO B)	EL RECIBO DE COMPRA DE BASES, DEBERÁ INTEGRARSE EN ORIGINAL Y COPIA DENTRO DEL SOBRE O CAJA. ¿ES CORRECTO? SIN QUE SE TENGA QUE PRESENTAR UNA COPIA DE DICHO RECIBO FUERA DEL SOBRE O CAJA DE PROPUESTA. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA EN EL ENTENDIDO QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN VENIR DENTRO DEL SOBRE ÚNICO, CAJA, PAQUETE, ETC
7	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO L)	EL ENTERO DE DESCUENTOS QUE SOLICITAN, DEBERÁ SER DEL ÚNICAMENTE DEL ÚLTIMO BIMESTRE CON SU PAGO BANCARIO CORRESPONDIENTE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO DENTRO DE SU PROPUESTA DEBE INTEGRAR EL RECIBO DE COMPRA DE BASES, NINGUN DOCUMENTO DEBERA ESTAR FUERA DEL SOBRE ÚNICO, CAJA, PAQUETE, ETC.
8	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO R)	EN CASO DE NO PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA CONJUNTA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO NOS APLICA. ¿SE ACEPTA? ADICIONALMENTE QUE NO SE DEBERÁ PRESENTAR ANEXO 25 DE MIPYME NI CON LA LEYENDA DE NO APLICA. ¿ES CORRECTO?	DEBERA PRESENTAR DE LOS DOS ÚLTIMOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
9	6.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS PÁGINA 18 TERCER PÁRRAFO	EN CASO DE QUE NO PRESENTE LA PROPUESTA EL REPRESENTANTE LEGAL, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR CARTA PODER PARA FACULTAR A LA PERSONA QUE LA PRESENTE Y BASTARÁ CON PRESENTAR ÚNICAMENTE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
10	13. VISITA DE INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR	¿SE DEBERÁ COORDINAR CON LA CONVOCANTE PARA QUE REALICE LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE MI REPRESENTADA?	LAS CONVOCANTE PODRÁ A SU CONSIDERACIÓN REALIZAR LAS VISITAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE
11	ANEXO 23 PÁGINA 352	EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO TODA VEZ QUE LOS BANCOS YA NO EMITEN LA CARTA SOLICITADA CON SELLO. FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERÁ ENTREGAR LA CARTA O EL FORMATO QUE EMITE LA PÁGINA, SELLADA Y FIRMADA POR EL BANCO.
12	ANEXO 26 PÁGINA 357	ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO. ¿ES CORRECTO? POR LO QUE NO SE DEBERÁ INTEGRARLO EN LA PROPUESTA.	LA FINALIDAD DE ESTE ANEXO ES PARA QUE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS CONOZCAN EL PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.
13	ANEXO 27 PÁGINA 373	ESTE ANEXO SE PRESENTARÁ SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
14	SIN NUMERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO DEBERÁN IR SELLADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA. FAVOR DE CONFIRMAR.	LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE.
15	4.7.1.5. GUÍAS MECÁNICAS. PÁG. 44.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE LAS GUÍAS MECANICAS CONFORME A LOS PLANOS ARQUITECTONICOS QUE SE ENTREGARON EN LA VENTA DE BASES ASI COMO LAS GUIAS DE CONEXIÓN EN CASO DE APLICAR EN FORMATO ELECTRONICO PDF, AUTOCAD (EN USB O CD) E IMPRESAS, DE ACUERDO CON LAS AREAS ASIGNADAS DENTRO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LAS PARTIDAS 8,9,10,11,12,13,14,15, DE ACUERDO A LO ENCONTRADO EN SU VISITA AL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
16	4.7.1.6. CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN. PÁG. 44.	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL EL CRONOGRAMA QUE SE PRESENTARA PARA LA CAPACITACION SERA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 4.7.1.8. DEBIDO A QUE LA CALENDARIZACION DE LA MISMA DEPENDE DE LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MEDICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
17	4.7.1.9. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO. PÁG. 45.	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL CURRICULUM VITAE (MÁXIMO 1 CUARTILLA) DEL PERSONAL QUE SE ENLISTA , CON EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS EN EQUIPO MEDICO SIMILAR Y/O DE IGUALES CARACTERISTICAS A LA PARTIDA OFERTADA, JUNTO CON LA DEMAS INFORMACION SOLICITADA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.7.1.9 CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS, DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A LA PARTIDA OFERTADA
18	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA 8. CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLAS CAMAS. OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PÁG. 68.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE EL (LOS) DOCUMENTO (S) ORIGINAL (LES) DE LAS GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DERIVADA DE NUESTRA VISITA Y SEGÚN APLIQUE POR MEDIO ELECTRONICO , TOMANDO EN CUENTA LOS REQUISITOS A CONSIDERAR DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADOS POR LA SEDESA PARA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
19	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS. PARTIDA 9. MONITOR DE SIGNOS VITALES. OTRAS PRESCRIPCIONES APPLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PÁG. 72.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE EL (LOS) DOCUMENTO (S) ORIGINAL (LES) DE LAS GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DERIVADA DE NUESTRA VISITA Y SEGÚN APLIQUE POR MEDIO ELECTRONICO , TOMANDO EN CUENTA LOS REQUISITOS A CONSIDERAR DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADOS POR LA SEDESA PARA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES
20	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS. PARTIDA 10. CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLAS CAMAS. OTRAS PRESCRIPCIONES APPLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PÁG. 76.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE EL (LOS) DOCUMENTO (S) ORIGINAL (LES) DE LAS GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DERIVADA DE NUESTRA VISITA Y SEGÚN APLIQUE POR MEDIO ELECTRONICO , TOMANDO EN CUENTA LOS REQUISITOS A CONSIDERAR DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADOS POR LA SEDESA PARA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES
21	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS. PARTIDA 11. MONITOR DE SIGNOS VITALES. OTRAS PRESCRIPCIONES APPLICABLES AL BIEN,	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE EL (LOS) DOCUMENTO (S) ORIGINAL (LES) DE LAS GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS,	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PÁG. 80.	HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DERIVADA DE NUESTRA VISITA Y SEGÚN APLIQUE POR MEDIO ELECTRONICO , TOMANDO EN CUENTA LOS REQUISITOS A CONSIDERAR DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADOS POR LA SEDESA PARA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
22	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA 12. CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLAS CAMAS. OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PÁG. 83.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE EL (LOS) DOCUMENTO (S) ORIGINAL (LES) DE LAS GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DERIVADA DE NUESTRA VISITA Y SEGÚN APLIQUE POR MEDIO ELECTRONICO , TOMANDO EN CUENTA LOS REQUISITOS A CONSIDERAR DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADOS POR LA SEDESA PARA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES
23	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA 13. MONITOR DE SIGNOS VITALES. OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PÁG. 88.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE EL (LOS) DOCUMENTO (S) ORIGINAL (LES) DE LAS GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DERIVADA DE NUESTRA VISITA Y SEGÚN APLIQUE POR MEDIO ELECTRONICO , TOMANDO EN	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CUENTA LOS REQUISITOS A CONSIDERAR DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADOS POR LA SEDESA PARA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
24	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA 14. CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLAS CAMAS. OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PÁG. 91.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE EL (LOS) DOCUMENTO (S) ORIGINAL (LES) DE LAS GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DERIVADA DE NUESTRA VISITA Y SEGÚN APLIQUE POR MEDIO ELECTRONICO, TOMANDO EN CUENTA LOS REQUISITOS A CONSIDERAR DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADOS POR LA SEDESA PARA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES
25	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA 15. MONITOR DE SIGNOS VITALES. OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PÁG. 95.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE EL (LOS) DOCUMENTO (S) ORIGINAL (LES) DE LAS GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DERIVADA DE NUESTRA VISITA Y SEGÚN APLIQUE POR MEDIO ELECTRONICO, TOMANDO EN CUENTA LOS REQUISITOS A CONSIDERAR DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADOS POR LA SEDESA PARA EL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL DÍA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SIGUIENTE HABIL DEL FALLO EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA DE A CUERDO AL NUMERAL 4.2. VISITAS DE LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
25	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA.	ENTENDEMOS QUE EL CONTENIDO DE LA COLUMNA DENOMINADA "TIEMPO DE ENTREGA" CORRESPONDE A LOS DIAS HABILES QUE LA CONVOCANTE DA COMO PLAZO MAXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN BASES
27	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 531.632.0554. DESCRIPCIÓN: CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 45 A 60 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE FABRICACION Y EXPORTACION AL OFERTAR EQUIPO INTERNACIONAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	DEBERA ATENDER LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CADA BIEN CONFORME AL ANEXO 29
28	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 531.447.0120 DESCRIPCIÓN: VIDEOGASTROSCOPIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 45 A 60 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE FABRICACION Y EXPORTACION AL OFERTAR EQUIPO INTERNACIONAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA DE 45 DÍAS NATURALES
29	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 531.217.0235 DESCRIPCIÓN: VIDEOCOLOSNOSCOPIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 60 A 70 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE FABRICACION Y EXPORTACION AL OFERTAR EQUIPO INTERNACIONAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACPETA, DEBERÁ ENTREGAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS NATURALES
30	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 45 A 60 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE	SE ACEPTA, PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 531.316.0086 DESCRIPCIÓN: VIDEOUDODENOSCOPIO	FABRICACION Y EXPORTACION AL OFERTAR EQUIPO INTERNACIONAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
31	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 531.924.0031 DESCRIPCIÓN: ULTRASONOGRAFO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 45 A 60 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE FABRICACION Y EXPORTACION AL OFERTAR EQUIPO INTERNACIONAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 40 DÍAS NATURALES
32	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 533.786.0026 DESCRIPCIÓN: REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 35 A 60 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN UN MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES
33	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 513.621.1652 DESCRIPCIÓN: MESA PUENTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 45 A 60 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE FABRICACION ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN UN MÁXIMO DE 45 DÍAS NATURALES
34	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 513.143.0059 DESCRIPCIÓN: BURO CON CAJON HOSPITALARIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 45 A 60 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE FABRICACION, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN UN MÁXIMO DE 35 DÍAS NATURALES
35	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, PARA LA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE ESTE EQUIPO EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO O EN SU DEFECTO DIAS NATURALES, ESTO	SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN UN MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA. CLAVE SAICA: 513.621.1876 DESCRIPCIÓN: MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	DEBIDO A LOS TIEMPOS DE FABRICACION¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
36	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA 68. MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PROPUESTA TECNICA TENDRÁ QUE PRESENTARSE DE FORMA SEPARADA POR CADA CANTIDAD DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE COMO ESTA DESCRITO EN EL ANEXO 1, O DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPUESTA POR TODA LA PARTIDA CONFORME A LA FICHA TÉCNICA	DEBERÁ PRESENTARSE POR TODA LA PARTIDA CONFORME A LA FICHA TECNICA.
37	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA 68. MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ACERO A NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL ACERO INOXIDABLE CON UNA CARTA DE EMISIÓN POR PARTE DE ÉSTE DÓNDE SE INDIQUE QUE ESE ACERO SE LE VENDE AL FABRICANTE DEL MOBILIARIO, YA QUE COMO TAL ESE CERTIFICADO SOLO SALE A NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL ACERO INOXIDABLE, ¿SE ACEPTA?	EN EL CERTIFICADO DEL ACERO A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL ACERO, DEBERÁ MENCIONAR COMO CLIENTE EL NOMBRE DEL FABRICANTE DE MOBILIARIO
38	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA 68. MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA PEDIMOS SE RECONSIDERE LA RESPUESTA Y SE PUEDE ENTREGAR EN CONJUNTO CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL LICITANTE Y(O FABRICANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	YA FUE CONTESTADA
39	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PART. 52 REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS	PUNTO 12. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, YA QUE ES EL MATERIAL RECOMENDADO PARA ÁREAS LIMPIAS COMO LO ES LABORATORIO. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
40	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PART. 52 REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS	PUNTO 14. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMPRESOR DE 1/4 HP HERMÉTICAMENTE SELLADO, SILENCIOSO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA
41	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PART. 52 REFRIGERADOR VERTICAL PARA	PUNTO 11. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE PERMITE REFERENCIAR EL PUNTO COMO ALARMAS AUDIBLE Y	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS	VISUALES DE RESPALDO RECARGABLE PARA 48 HORAS PARA INDICADOR DE FALLA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y TEMPERATURA MAYOR A 8°C Y MENOR A 2°C (CONFIGURABLE) ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?	
42	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PART. 52 REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, INDICAR A QUE SE REFIERE CON BATERIA RECARGABLE PARA LAS FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA, DADO QUE YA SE ESTA SOLICITANDO REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS PARA EL EQUIPO Y QUE NO EXISTEN REFRIGERADORES EN EL MERCADO QUE TENGAN BATERÍA INTERNA DE RESPALDO EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA ANTERIOR.
43	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS. PARTIDA. 118 CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONGELADOR HORIZONTAL DE 10 PIES CUBICOS, DADO QUE EN LA FICHA TECNICA NO SE ESPECIFICA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?	DEBERÁ ATENDER PRECISION TECNICA NUMERO 3 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
44	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 66.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CUATRO RODAJAS PLANA DE 3", DADO QUE EN EL MERCADO NO EXISTEN RODAJAS DE BOLA DE LA MEDIDA SOLICITADA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
45	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 66.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CUATRO RODAJAS DE BOLA DE 2", DADO QUE EN EL MERCADO NO EXISTEN ROJADAS DE BOLA DE MEDIDA SOLICITADA, ¿SE ACEPTA?	NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA
46	ANEXO 1 "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES"	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 1, INDICA QUE NO HAY AGRUPACIÓN DE PARTIDAS Y QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA SE TENDRÁ QUE HACER POR PARTIDA Y POR LO TANTO LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR PARTIDA. SIN SER OBLIGATORIO TENER QUE OFERTAR TODAS LAS PARTIDAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDAS INDEPENDIENTES, SIN EMBARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA																							
PRECISIONES																										
PRECISIÓN TÉCNICA 14. PARA LAS PARTIDAS 8,9,10, 11, 12, 13, 14 Y 15, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA OPERACIÓN E INTERCONEXIÓN, DEBERÁN CONFORMAR UN BINOMIO (DE ACUERDO AL CUADRO SIGUIENTE), SIENDO COMPATIBLES Y DE LA MISMA MARCA, POR LO QUE EL PROVEEDOR LICITANTE DEBERÁ OFERTAR LAS PARTIDAS 8,9,10, 11, 12, 13, 14 Y 15 POR BINOMIO, PARA CUMPLIR TÉCNICAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA EN BASES:																										
<table><tr><th>NO. DE PARTIDA</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BINOMIO</th></tr><tr><td>8</td><td>CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td>9</td><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td></tr><tr><td>10</td><td>CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS</td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td>11</td><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td></tr><tr><td>12</td><td>CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS</td><td rowspan="2">3</td></tr><tr><td>13</td><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td></tr><tr><td>14</td><td>CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS</td><td rowspan="2">4</td></tr><tr><td>15</td><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td></tr></table>				NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	BINOMIO	8	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	1	9	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	2	11	MONITOR DE SIGNOS VITALES	12	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	3	13	MONITOR DE SIGNOS VITALES	14	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	4	15	MONITOR DE SIGNOS VITALES
NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	BINOMIO																								
8	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	1																								
9	MONITOR DE SIGNOS VITALES																									
10	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	2																								
11	MONITOR DE SIGNOS VITALES																									
12	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	3																								
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES																									
14	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	4																								
15	MONITOR DE SIGNOS VITALES																									
PRECISIÓN TÉCNICA 15. PARA LAS PARTIDAS 16,17,18 Y 19, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA OPERACIÓN E INTERCONEXIÓN, DEBERÁN CONFORMAR UN CUATRIMONIO (DE ACUERDO AL CUADRO SIGUIENTE), SIENDO COMPATIBLES Y DE LA MISMA MARCA, POR LO QUE EL PROVEEDOR LICITANTE DEBERÁ OFERTAR LAS PARTIDAS 16,17,18 Y 19 POR CUATRIMONIO, PARA CUMPLIR TÉCNICAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA EN BASES:																										
<table><tr><th>NO. DE PARTIDA</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CUATRIMONIO</th></tr><tr><td>16</td><td>SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS</td><td rowspan="4">1</td></tr><tr><td>17</td><td>VIDEOGASTROSCOPIOS</td></tr><tr><td>18</td><td>VIDEOCOLONOSCOPIO</td></tr><tr><td>19</td><td>VIDEODUODENOSCOPIO</td></tr></table>				NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUATRIMONIO	16	SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS	1	17	VIDEOGASTROSCOPIOS	18	VIDEOCOLONOSCOPIO	19	VIDEODUODENOSCOPIO											
NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUATRIMONIO																								
16	SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS	1																								
17	VIDEOGASTROSCOPIOS																									
18	VIDEOCOLONOSCOPIO																									
19	VIDEODUODENOSCOPIO																									
PRECISIÓN DE LA CONVOCANTE. EN CONSIDERACIÓN A LA PRECISIÓN EFECTUADA POR EL ÁREA TÉCNICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y 43 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA CONVOCANTE, PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN UNA COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ, TOMARA EN CUENTA EL PRECIO MÁS ECONÓMICO QUE RESULTE DE LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR BINOMIO Y CUATRINOMIO OFERTADO POR EL LICITANTE																										
47	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8 PUNTO 21. PUNTO 22. PARTIDA 9 PUNTO 1.28 PARTIDA 10 PUNTO 21	ES CORRECTO ENTENDER QUE DERIVADO DE LO SOLICITADO EN LAS PARTIDAS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 Y EN LOS PUNTOS MENCIONADOS, TODAS ESTAS PARTIDAS SE AGRUPARAN Y SE ADJUDICARAN A UN SOLO PROVEEDOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DA RESPUESTA CON LA PRECISIÓN TÉCNICA 14 Y 15																							



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	PUNTO 22 PARTIDA 11 PUNTO 1.28 PARTIDA 12 PUNTO 21 PUNTO 22 PARTIDA 13 1.30 PARTIDA 14 PUNTO 20 PUNTO 21 PARTIDA 15		
48	ANEXO 29 PLAZO DE ENTREGA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER HOMOLOGAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA PARA TODAS LA PARTIDAS Y PERMITIR 70 DÍAS DE ENTREGA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL TIEMPO DE ENTREGA SERÁ POR PARTIDA
49	ANEXO 1.1.1. "GUIAS MECANICAS"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE PARA LAS PARTIDAS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 NO SE REQUIEREN GUÍAS MECÁNICAS, ESTO DEBIDO A QUE EN EL ANEXO 1.1.1. NO VIENEN LAS GUÍAS CORRESPONDIENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBE PRESENTAR GUIA DE COMUNICACIÓN DE MONITORES Y A LA CENTRAL
50	ANEXO 1.1.1. "GUIAS MECANICAS"	EN CASO DE QUE SI SE REQUIERAN LAS GUÍAS MECÁNICAS, NOS LA PODRÍAN COMPARTIR EL PLANO ARQUITECTÓNICO ASÍ COMO EL DE NODOS DE LAS ÁREAS EN LAS QUE SERÁN INSTALADAS LAS CENTRALES EN FORMADO PDF Y AUTOCAD. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER PRECISIÓN TECNICA 2
51	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 16	2.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA FUENTE DE LUZ LED DE 750 LÚMENES (LM) DE INTENSIDAD CON TECNOLOGÍA DE 3 LEDS INDEPENDIENTES QUE PERMITEN MODULAR LA LONGITUD DE ONDA DE LA LÁMPARA MEJORANDO EL CONTRASTE Y LA NITIDEZ, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
52	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 16	2.3 ENTENDEMOS QUE LA FUNCIÓN DE TRANSILUMINACIÓN UTILIZA LA INTENSIDAD MÁXIMA DE LA LÁMPARA PARA LOCALIZAR LA PUNTA DEL ENDOSCOPIO DENTRO DEL PACIENTE, POR LO CUAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA FUNCIÓN CON EL AJUSTE DE BRILLO MÁXIMO DE LA LÁMPARA DE MANERA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		MANUAL O AUTOMÁTICA, ¿SE ACEPTA?	
53	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 16	3.5 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENTRADAS DE VIDEO HDMI, DISPLAY PORT, DVI Y SDI, YA QUE ESTAS SON LAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE VIDEO OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
54	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 16	4.5 ENTENDEMOS QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PUEDE INTEGRARSE AL CARRO POR MEDIO DE UPS O REGULADOR PARA PROVEER DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA A LOS COMPONENTES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EL UPS O REGULADOR EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
55	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 17	1.5 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VIDEOGASTROSCOPIO CON ZOOM ELECTRÓNICO DE 1X HASTA 2X, GARANTIZANDO LA CALIDAD DIAGNOSTICA DE LA IMAGEN ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
56	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 18	1.5 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VIDEOCOLONOSCOPIO CON ZOOM ELECTRÓNICO DE 1X HASTA 2X, GARANTIZANDO LA CALIDAD DIAGNOSTICA DE LA IMAGEN ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
57	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 111	5. BATERÍA DE AL MENOS 4 HORAS DE RESPALDO, -> 1 HORA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA DE UNA HORA CON POSIBILIDAD DE ASISTENCIA POR UPS PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EN EL ENTENDIDO DE QUE AL SOLICITAR UNA BASE RODABLE, EL EQUIPO ESTARÁ DENTRO DE LA INSTALACIÓN DEL HOSPITAL/CLÍNICA, POR LO QUE SE PUEDE CONECTAR EN CUALQUIER MOMENTO A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES..
58	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 111	7.13. PROGRAMA DE ECTORREALIZADORES O MEDIOS DE CONTRASTE -> NO DISPONIBLE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN PARA MEJORA DE LA CALIDAD DE IMAGEN, REDUCCIÓN DE RUIDO Y ARTEFACTOS, COMO MEJORA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
59	ANEXO 29	PREGUNTA ADMINISTRATIVA: SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE, SE REFIERE A SEMANAS DE ENTREGA, ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LOS PLAZOS ESTÁN ESTABLECIDOS EN DÍAS NATURALES
60	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 1. DADO QUE EL HECHO DE PODER USAR UNA CENTRAL DE MONITOREO HÍBRIDA IMPLICA UNA INVERSIÓN ADICIONAL, Y LAS CENTRALES SE USARÁN SOLAMENTE CON MONITORES DE CABECERA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL PARA NO ENCARECER LA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
61	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 3.1. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO RESOLUCIÓN DE POR LO MENOS 1920 X 1080 PÍXELES. YA ES ESTA ES LA MEDIDA ESTÁNDAR PARA LA RESOLUCIÓN DE PANTALLAS. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA ACLARACIÓN 6
62	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 8. DADO QUE EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE NUESTRA TECNOLOGÍA SE DESPLIEGA Y ANALIZA EL SEGMENTO ST EN LAS 12 DERIVACIONES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
63	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 10. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIA ESTE PUNTO COMO "CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE ALARMA O MODIFICAR FORMAS DE ONDA. DADO QUE CADA TECNOLOGÍA HACE REFERENCIA A ESTA FUNCIONALIDAD DE DIFERENTE MANERA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
64	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 11. DERIVADO A QUE LA CENTRAL DE MONITOREO ESTARÁ CONECTADA A UN EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO (SAMIH) SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL INGRESO DE NOTAS CLÍNICAS COMO OPCIONAL, DERIVADO A QUE DE ESTA MANERA NO SE REDUNDA EN INFORMACIÓN QUE SE INGRESA FORMALMENTE EN EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
65	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 17.2. NUESTRA MARCA TIENE PROFUNDO INTERÉS POR MANTENER LA PRIVACIDAD DE DATOS DE LOS PACIENTES DE TAL FORMA QUE	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	
66	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 18. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER SI LO QUE REQUIEREN ES QUE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO TENGA LA CAPACIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES MONITORIZADOS, ESTO BAJO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, HACIA SU EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, PARA QUE SU PROVEEDOR DE EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SE ENCARGUE DE RECIBIR Y TRATAR DICHA INFORMACIÓN. AGREGANDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA EL SOFTWARE, Y HARDWARE QUE DE NUESTRA PARTE CORRESPONDA PARA ESTE FIN. ¿ES CORRECTO?	SE REFIERE A LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DOS SISTEMAS, SI PARA ELLO DEBE AGREGAR SOFTWARE Y HARDWARE, SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU MONTO FINAL
67	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 19. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR SOLUCIÓN QUE, EN CASO DE DESCONEXIÓN, ASIGNE DE MANERA AUTOMÁTICA EL MONITOR QUE SE DESCONECTE DE LA CENTRAL, AL MISMO SECTOR DE PACIENTE EN EL QUE SE ESTABA MONITORIZANDO ANTES DE LA DESCONEXIÓN, YA QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES CONTIENE EL HISTÓRICO DE TENDENCIAS ADQUIRIDAS DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
68	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 8	PUNTO 21. DERIVADO A QUE LOS DATOS DE LOS PACIENTES ESTARÁN CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. TODA VEZ QUE, EL UNIVERSO DE INFORMACIÓN PODRÁ SER CONSULTADA DESDE EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SIN IMPORTAR DE LA CENTRAL QUE SE HAYAN RECABADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
69	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 9	PUNTO 1.17. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER SI LO QUE REQUIEREN ES QUE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO TENGA LA CAPACIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES MONITORIZADOS, ESTO BAJO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, HACIA SU	SE REFIERE A LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DOS SISTEMAS, SI PARA ELLO DEBE AGREGAR SOFTWARE Y HARDWARE, SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU MONTO FINAL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, PARA QUE SU PROVEEDOR DE EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SE ENCARGUE DE RECIBIR Y TRATAR DICHA INFORMACIÓN. AGREGANDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA EL SOFTWARE, Y HARDWARE QUE DE NUESTRA PARTE CORRESPONDA PARA ESTE FIN. ¿ES CORRECTO?	
70	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 9	PUNTO 1.18. PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VIALES JUNTO CON UNA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LA CABECERA DEL PACIENTE PARA ACCESO AL SISTEMA PACS DESDE DICHA ESTACIÓN DE TRABAJO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
71	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 9	PUNTO 1.19.8. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES CON CABLE 10 LATIGUILLOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA SOLUCIÓN PRINCIPAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
72	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 9	PUNTO 1.25.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON MONITORIZACIÓN DE CO2 MICROSTREAM YA QUE ESTA TECNOLOGÍA PERMITE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE INTUBADOS Y NO INTUBADOS, QUE ES UNA TECNOLOGÍA CONSIDERADA EQUIVALENTE A SIDESTREAM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
73	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 1. DADO QUE EL HECHO DE PODER USAR UNA CENTRAL DE MONITOREO HÍBRIDA IMPLICA UNA INVERSIÓN ADICIONAL, Y LAS CENTRALES SE USARÁN SOLAMENTE CON MONITORES DE CABECERA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL PARA NO ENCARECER LA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
74	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 3.1. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO RESOLUCIÓN DE POR LO MENOS 1920 X 1080 PÍXELES. YA ES ESTA LA MEDIDA ESTÁNDAR PARA LA RESOLUCIÓN DE PANTALLAS. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA ACLARACIÓN 6
75	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 8. DADO QUE EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE NUESTRA TECNOLOGÍA SE DESPLIEGA Y	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

R 19/2

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		ANALIZA EL SEGMENTO ST EN LAS 12 DERIVACIONES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	
76	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 10. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIA ESTE PUNTO COMO "CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE ALARMA O MODIFICAR FORMAS DE ONDA. DADO QUE CADA TECNOLOGÍA HACE REFERENCIA A ESTA FUNCIONALIDAD DE DIFERENTE MANERA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
77	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 11. DERIVADO A QUE LA CENTRAL DE MONITOREO ESTARÁ CONECTADA A UN EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO (SAMIH) SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL INGRESO DE NOTAS CLÍNICAS COMO OPCIONAL, DERIVADO A QUE DE ESTA MANERA NO SE REDUNDA EN INFORMACIÓN QUE SE INGRESA FORMALMENTE EN EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
78	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 17.2. NUESTRA MARCA TIENE PROFUNDO INTERÉS POR MANTENER LA PRIVACIDAD DE DATOS DE LOS PACIENTES DE TAL FORMA QUE SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
79	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 18. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER SI LO QUE REQUIEREN ES QUE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO TENGA LA CAPACIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES MONITORIZADOS, ESTO BAJO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, HACIA SU EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, PARA QUE SU PROVEEDOR DE EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SE ENCARGUE DE RECIBIR Y TRATAR DICHA INFORMACIÓN. AGREGANDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA EL SOFTWARE, Y HARDWARE QUE DE NUESTRA PARTE CORRESPONDA PARA ESTE FIN. ¿ES CORRECTO?	SE REFIERE A LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DOS SISTEMAS, SI PARA ELLO DEBE AGREGAR SOFTWARE Y HARDWARE, SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU MONTO FINAL
80	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 19. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR SOLUCIÓN QUE, EN CASO DE DESCONEXIÓN, ASIGNE DE MANERA AUTOMÁTICA EL MONITOR QUE SE DESCONECTE DE	YA SE CONTESTÓ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		LA CENTRAL, AL MISMO SECTOR DE PACIENTE EN EL QUE SE ESTABA MONITORIZANDO ANTES DE LA DESCONEXIÓN, YA QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES CONTIENE EL HISTÓRICO DE TENDENCIAS ADQUIRIDAS DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
81	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 10	PUNTO 21. DERIVADO A QUE LOS DATOS DE LOS PACIENTES ESTARÁN CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. TODA VEZ QUE, EL UNIVERSO DE INFORMACIÓN PODRÁ SER CONSULTADA DESDE EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SIN IMPORTAR DE LA CENTRAL QUE SE HAYAN RECADADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
82	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 11	PUNTO 1.17. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER SI LO QUE REQUIEREN ES QUE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO TENGA LA CAPACIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES MONITORIZADOS, ESTO BAJO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, HACIA SU EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, PARA QUE SU PROVEEDOR DE EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SE ENCARGUE DE RECIBIR Y TRATAR DICHA INFORMACIÓN. AGREGANDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA EL SOFTWARE, Y HARDWARE QUE DE NUESTRA PARTE CORRESPONDA PARA ESTE FIN. ¿ES CORRECTO?	SE REFIERE A LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DOS SISTEMAS, SI PARA ELLO DEBE AGREGAR SOFTWARE Y HARDWARE, SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU MONTO FINAL
83	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 11	PUNTO 1.18. PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VIALES JUNTO CON UNA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LA CABECERA DEL PACIENTE PARA ACCESO AL SISTEMA PACS DESDE DICHA ESTACIÓN DE TRABAJO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
84	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 11	PUNTO 1.20.8. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES CON CABLE 10 LATIGUILLOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA SOLUCIÓN PRINCIPAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
85	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS	PUNTO 1.26.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a large 'L' and 'S' at the top, and various initials and marks along the side of the table.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	PARTIDA 11	PERMITAN OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON MONITORIZACIÓN DE CO2 MICROSTREAM YA QUE ESTA TECNOLOGÍA PERMITE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE INTUBADOS Y NO INTUBADOS, QUE ES UNA TECNOLOGÍA CONSIDERADA EQUIVALENTE A SIDESTREAM ¿SE ACEPTA?	
86	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 1. DADO QUE EL HECHO DE PODER USAR UNA CENTRAL DE MONITOREO HÍBRIDA IMPLICA UNA INVERSIÓN ADICIONAL, Y LAS CENTRALES SE USARÁN SOLAMENTE CON MONITORES DE CABECERA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL PARA NO ENCARECER LA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
87	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 3.1. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO RESOLUCIÓN DE POR LO MENOS 1920 X 1080 PÍXELES. YA ES ESTA ES LA MEDIDA ESTÁNDAR PARA LA RESOLUCIÓN DE PANTALLAS. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA ACLARACIÓN 6
88	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 8. DADO QUE EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE NUESTRA TECNOLOGÍA SE DESPLIEGA Y ANALIZA EL SEGMENTO ST EN LAS 12 DERIVACIONES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
89	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 10. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIA ESTE PUNTO COMO "CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE ALARMA O MODIFICAR FORMAS DE ONDA. DADO QUE CADA TECNOLOGÍA HACE REFERENCIA A ESTA FUNCIONALIDAD DE DIFERENTE MANERA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
90	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 11. DERIVADO A QUE LA CENTRAL DE MONITOREO ESTARÁ CONECTADA A UN EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO (SAMIH) SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL INGRESO DE NOTAS CLÍNICAS COMO OPCIONAL, DERIVADO A QUE DE ESTA MANERA NO SE REDUNDA EN INFORMACIÓN QUE SE INGRESA FORMALMENTE EN EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
91	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 17.2. NUESTRA MARCA TIENE PROFUNDO INTERÉS POR MANTENER LA PRIVACIDAD DE DATOS DE LOS PACIENTES DE TAL FORMA QUE SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
92	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 18. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER SI LO QUE REQUIEREN ES QUE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO TENGA LA CAPACIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES MONITORIZADOS, ESTO BAJO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, HACIA SU EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, PARA QUE SU PROVEEDOR DE EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SE ENCARGUE DE RECIBIR Y TRATAR DICHA INFORMACIÓN. AGREGANDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA EL SOFTWARE, Y HARDWARE QUE DE NUESTRA PARTE CORRESPONDA PARA ESTE FIN. ¿ES CORRECTO?	SE REFIERE A LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DOS SISTEMAS, SI PARA ELLO DEBE AGREGAR SOFTWARE Y HARDWARE, SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU MONTO FINAL
93	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 19. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR SOLUCIÓN QUE, EN CASO DE DESCONEXIÓN, ASIGNE DE MANERA AUTOMÁTICA EL MONITOR QUE SE DESCONECTE DE LA CENTRAL, AL MISMO SECTOR DE PACIENTE EN EL QUE SE ESTABA MONITORIZANDO ANTES DE LA DESCONEXIÓN, YA QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES CONTIENE EL HISTÓRICO DE TENDENCIAS ADQUIRIDAS DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
94	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 12	PUNTO 21. DERIVADO A QUE LOS DATOS DE LOS PACIENTES ESTARÁN CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. TODA VEZ QUE, EL UNIVERSO DE INFORMACIÓN PODRÁ SER CONSULTADA DESDE EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SIN IMPORTAR DE LA CENTRAL QUE SE HAYAN RECADADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
95	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 13	PUNTO 1.19. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER SI LO QUE REQUIEREN ES QUE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO TENGA LA CAPACIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS NUMÉRICOS DE LOS	SE REFIERE A LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DOS SISTEMAS, SI PARA ELLO DEBE AGREGAR SOFTWARE Y HARDWARE, SE DEBERÁ



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES MONITORIZADOS, ESTO BAJO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, HACIA SU EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, PARA QUE SU PROVEEDOR DE EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SE ENCARGUE DE RECIBIR Y TRATAR DICHA INFORMACIÓN. AGREGANDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA EL SOFTWARE, Y HARDWARE QUE DE NUESTRA PARTE CORRESPONDA PARA ESTE FIN. ¿ES CORRECTO?	CONTEMPLAR EN SU MONTO FINAL
96	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 13	PUNTO 1.20. PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VIALES JUNTO CON UNA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LA CABECERA DEL PACIENTE PARA ACCESO AL SISTEMA PACS DESDE DICHA ESTACIÓN DE TRABAJO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
97	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 13	PUNTO 1.21.8. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES CON CABLE 10 LATIGUILLOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA SOLUCIÓN PRINCIPAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
98	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 13	PUNTO 1.27.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON MONITORIZACIÓN DE CO2 MICROSTREAM YA QUE ESTA TECNOLOGÍA PERMITE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE INTUBADOS Y NO INTUBADOS, QUE ES UNA TECNOLOGÍA CONSIDERADA EQUIVALENTE A SIDESTREAM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
99	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 1. DADO QUE EL HECHO DE PODER USAR UNA CENTRAL DE MONITOREO HÍBRIDA IMPLICA UNA INVERSIÓN ADICIONAL, Y LAS CENTRALES SE USARÁN SOLAMENTE CON MONITORES DE CABECERA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL PARA NO ENCARECER LA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
100	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 3.1. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO RESOLUCIÓN DE POR LO MENOS 1920 X 1080 PÍXELES. YA ES ESTA ES LA MEDIDA ESTÁNDAR PARA	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NO. 6 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		LA RESOLUCIÓN DE PANTALLAS. ¿SE ACEPTA?	
101	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 8. DADO QUE EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE NUESTRA TECNOLOGÍA SE DESPLIEGA Y ANALIZA EL SEGMENTO ST EN LAS 12 DERIVACIONES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
102	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 9. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIA ESTE PUNTO COMO "CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES DE ALARMA O MODIFICAR FORMAS DE ONDA. DADO QUE CADA TECNOLOGÍA HACE REFERENCIA A ESTA FUNCIONALIDAD DE DIFERENTE MANERA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
103	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 10. DERIVADO A QUE LA CENTRAL DE MONITOREO ESTARÁ CONECTADA A UN EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO (SAMIH) SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL INGRESO DE NOTAS CLÍNICAS COMO OPCIONAL, DERIVADO A QUE DE ESTA MANERA NO SE REDUNDA EN INFORMACIÓN QUE SE INGRESA FORMALMENTE EN EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
104	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 16.2. NUESTRA MARCA TIENE PROFUNDO INTERÉS POR MANTENER LA PRIVACIDAD DE DATOS DE LOS PACIENTES DE TAL FORMA QUE SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
105	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 17. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER SI LO QUE REQUIEREN ES QUE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO TENGA LA CAPACIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES MONITORIZADOS, ESTO BAJO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, HACIA SU EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, PARA QUE SU PROVEEDOR DE EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SE ENCARGUE DE RECIBIR Y TRATAR DICHA INFORMACIÓN. AGREGANDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA EL SOFTWARE, Y HARDWARE QUE DE NUESTRA PARTE CORRESPONDA PARA ESTE FIN. ¿ES CORRECTO?	SE REFIERE A LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DOS SISTEMAS, SI PARA ELLO DEBE AGREGAR SOFTWARE Y HARDWARE, SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU MONTO FINAL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the table, including initials and checkmarks.]

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
106	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 18. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR SOLUCIÓN QUE, EN CASO DE DESCONEXIÓN, ASIGNE DE MANERA AUTOMÁTICA EL MONITOR QUE SE DESCONECTE DE LA CENTRAL, AL MISMO SECTOR DE PACIENTE EN EL QUE SE ESTABA MONITORIZANDO ANTES DE LA DESCONEXIÓN, YA QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES CONTIENE EL HISTÓRICO DE TENDENCIAS ADQUIRIDAS DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTÓ
107	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 14	PUNTO 20. DERIVADO A QUE LOS DATOS DE LOS PACIENTES ESTARÁN CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. TODA VEZ QUE, EL UNIVERSO DE INFORMACIÓN PODRÁ SER CONSULTADA DESDE EL EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SIN IMPORTAR DE LA CENTRAL QUE SE HAYAN RECABADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
108	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 15	PUNTO 1.19. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTENDER SI LO QUE REQUIEREN ES QUE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO TENGA LA CAPACIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES MONITORIZADOS, ESTO BAJO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, HACIA SU EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO, PARA QUE SU PROVEEDOR DE EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO SE ENCARGUE DE RECIBIR Y TRATAR DICHA INFORMACIÓN. AGREGANDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA EL SOFTWARE, Y HARDWARE QUE DE NUESTRA PARTE CORRESPONDA PARA ESTE FIN. ¿ES CORRECTO?	SE REFIERE A LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DOS SISTEMAS, SI PARA ELLO DEBE AGREGAR SOFTWARE Y HARDWARE, SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU MONTO FINAL
109	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS	PUNTO 1.20. PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES JUNTO CON UNA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LA CABECERA DEL PACIENTE PARA ACCESO AL SISTEMA PACS DESDE DICHA ESTACIÓN DE TRABAJO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
110	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS	PUNTO 1.21.8. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CON CABLE 10 LATIGUILLOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA SOLUCIÓN PRINCIPAL. ¿SE ACEPTA?	
111	ANEXO 1.1. FICHAS TÉCNICAS	PUNTO 1.27.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON MONITORIZACIÓN DE CO2 MICROSTREAM YA QUE ESTA TECNOLOGÍA PERMITE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE INTUBADOS Y NO INTUBADOS, QUE ES UNA TECNOLOGÍA CONSIDERADA EQUIVALENTE A SIDESTREAM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

33. - IMBIOMEDIX, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 3.5 OPCIONES PARA PRESENTAR GARANTÍAS SOSTENIMIENTO CUMPLIMIENTO.	DICE: LAS GARANTÍAS DE (SOSTENIMIENTO) FORMALIDAD DE LAS PROPUESTAS Y DE CUMPLIMIENTO DEL (LOS) CONTRATO (S), DEBERÁN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEBERÁN SER PRESENTADAS SIN PERFORACIONES, MUTILACIONES, ENMENDADURAS O TACHADURAS Y PODRÁN PRESENTARSE MEDIANTE: • FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. • CHEQUE DE CAJA. • CHEQUE CRUZADO • CHEQUE CERTIFICADO. • BILLETE DE DEPÓSITO. • CARTA DE CRÉDITO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE MI REPRESENTADA PUEDE OPTAR POR PRESENTAR EN NUESTRA PROPUESTA CUALQUIER GARANTÍA DE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CON LO MENCIONADO EN EL NUMERAL 3.5 OPCIONES PARA PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE OSTENIMIENTO Y CUMPLIMIENTO.
2	PÁGINA 12 DE LAS BASES	DICE: PRIMERO: LA CONVOCANTE CONSIDERARÁ COMO DOCUMENTOS ORIGINALES (COMPROBANTE DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		DOMICILIO, DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO SAT, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES), LOS CUALES SON OBTENIDOS DE MANERA ELECTRÓNICA, SIN EMBARGO, LOS LICITANTES A LA ENTREGA DE SU PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR DOS TANTOS, UNO QUE FUNGIRÁ COMO ORIGINAL Y EL SEGUNDO COMO COPIA SIMPLE, LA CUAL QUEDARÁ PARA RESGUARDO DE LA CONVOCANTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS ANEXOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN NO SE PRESENTARÁN EN DOS TANTOS, TODA VEZ, QUE NO SE SOLICITA ASÍ DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL TEXTO ANTES DESCRITO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
3	NUMERAL 4.6.2 PROPUESTA ECONÓMICA	DICE: LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SER PRESENTADA POR "LOS LICITANTES" DE MANERA IMPRESA Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO EXCEL (USB O CD IDENTIFICADO), (ANEXO 20), ... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ANEXO 20 PROPUESTA ECONÓMICA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO FORMATO EXCEL, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA SI ESTE NO CONTIENE LOS LOGOTIPOS DE MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.1.1 PROPUESTA TÉCNICA	DICE: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA CONFORME AL MODELO DEL ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA", EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE	EN EL 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		EN QUE NUMERAL SE DEBERÁ INCLUIR EL ANEXO 19 , TODA VEZ, QUE TAMBIÉN ES SOLICITADO PRESENTARLO EN EL NUMERAL 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA . FAVOR DE ACLARARNOS.	
5	NUMERAL 4.1 PÁG. 10 DE LAS BASES	DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, CONFORME A LO SOLICITADO EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL 4.1 "MUESTRAS" PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE EL TIEMPO EN EL QUE PERMANECERÁN LAS MUESTRAS FÍSICAS EN EVALUACIÓN.	PERMANECERÁN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA EVALUACIÓN, MISMAS QUE SERÁN EVALUADAS EN PRESENCIA DEL ESPECIALISTA DE PRODUCTO DEL OFERTANTE, REGRESÁNDOSE DESPUÉS DE CONCLUIR LA EVALUACIÓN, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS A EVALUAR.
6	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA	PREGUNTA: A EFECTO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, ¿ES POSIBLE QUE SE AMPLIEN LOS PLAZOS MÍNIMOS A 30 DÍAS HÁBILES? A FIN DE QUE SEA FACTIBLE PRESENTAR MEJORES CONDICIONES DE PRECIO PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	FAVOR DE ESPECIFICAR PARTIDAS
7	NUMERAL 4.1.PAG. 32 DE LAS BASES	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS MUESTRAS FÍSICAS NOS PERMITA PRESENTAR UNA SOLA EN EL CASO DE QUE VARIAS PARTIDAS CORRESPONDAN AL MISMO EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SIEMPRE Y CUANDO EL MODELO OFERTADO DE LAS PARTIDAS SEA EL MISMO EN CASO CONTRARIO DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA POR MODELO DIFERENTE
8	ANEXO 29. PLAZOS DE ENTREGA	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL PLAZO DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES, TODA VEZ, QUE EN DICHO ANEXO NO SE RELACIONAN ESTAS PARTIDAS.	EL PLAZO SERÁ DE 45 DÍAS NATURALES
9	NUMERAL 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DE FABRICANTE	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR COPIA DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, TODA VEZ, QUE NUESTROS PRODUCTOS SON DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ADJUNTE EL CORREO ELECTRÓNICO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ENVIA LA CARTA DE APOYO, EN CASO DE NO ADJUNTAR COPIA DEL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

			CORREO SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
10	PARA LAS PARTIDAS 8,10,12 Y 14	DICE: PUNTO 3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA UNA TOLERANCIA DE +- 5% EN LA PANTALLA DE LA CENTRAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
11	PARA LAS PARTIDAS 8,10,12 Y 14	DICE: PUNTO 3. INCLUIR AL MENOS UN MONITOR PARA LA CENTRAL CON PANTALLA DE 22" COMO MÍNIMO A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE SEA IMPRESCINDIBLE UNA PANTALLA SENSIBLE AL TACTO PARA LA CENTRAL DE MONITOREO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES..
12	PARA LAS PARTIDAS 8,10,12 Y 14	DICE: PUNTO 9. CAPTURA Y DESPLIEGUE DE CURVAS DE PANTALLA COMPLETA O VISUALIZACIÓN COMPLETA O "FULL DISCLOSURE" DE AL MENOS 3 DÍAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PARA NO ENCARECER EL VALOR DEL EQUIPO, SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
13	PARA LAS PARTIDAS 8,10 Y 12	DICE: PUNTO 18. QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA D E INFORMACIÓN SAMIN EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y AL MODELO OFERTADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PARA NO ENCARECER	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		EL VALOR DEL EQUIPO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	
14	PARA LAS PARTIDAS 8,10 Y 12	DICE: PUNTO 21. CON POSIBILIDAD DE COMUNICARSE CON TODAS LAS CENTRALES DE MONITOREO DEL H.G. CUAJIMALPA (PARTIDAS 10,12 Y 14) PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, SE CONSIDERADO COMO CAPACIDAD A FUTURO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
15	PARA LAS PARTIDAS 9,11, 13 Y 15	DICE: PUNTO 1. MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS MODULARES CON PANTALLA DE 15" COMO MÍNIMO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMBLE CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 12.1 PULGADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
16	PARA LAS PARTIDAS 9,11, 13 Y 15	DICE: PUNTO 1. MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS MODULARES CON PANTALLA DE 15" COMO MÍNIMO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE QUE LA PANTALLA DEL MONITOR SEA OBLIGATORIO QUE CUENTE CON PANTALLA TÁCTIL Y SOLO CUENTE CON BOTÓN DE ENCENDIDO PARA ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
17	PARA LAS PARTIDAS 9 Y 11	DICE: PUNTO 1.15 CON BATERÍA DE RESPALDO INTEGRADA AL EQUIPO DE FABRICA DE AL MENOS 45 MINUTOS O MAYOR. PREGUNTA: DEBIDO AL TAMAÑO VOLUMINOSO DEL MONITOR Y CONSIDERANDO QUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LAS ÁREAS EN DONDE SE UBICARAN LOS MONITORES SON DE CUIDADOS CRÍTICOS NO SERÁ IMPRESCINDIBLE SU TRASLADO. POR LO CUAL, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA? EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR, SEA NEGATIVA SOLICITAMOS A LA AMABLE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DE NINGUNA DE LAS DOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the first table]

		CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA UPS CON DURACIÓN DE 45MIN. ¿SE ACEPTA?	
18	PARA LAS PARTIDAS 9 Y 11	DICE: PUNTO 1.17 QUE PERMITA EL ENVÍO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPRESIÓN, CONSULTA DE INFORMACIÓN HACIA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAMIH EN FORMATO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, SE REQUIERE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE FABRICA. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE Y PARA NO ENCARECER EL PRECIO DEL EQUIPO. ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
19	PARA LAS PARTIDAS 9	DICE: PUNTO 1.19.8 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA QUE ESTA MEDICIÓN SEA REALIZADA MEDIANTE UN CABLE DE ECG DE 10 LATIGUILLOS PARA MEJORAR LA PRECISIÓN DEL TRAZO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the second table]

34. – FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G) CONSTANCIA DE ADEUDOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS CONSTANCIAS DE ADEUDOS CON FECHA DEL 20 DE MAYO DE 2022 , A COMPAÑADOS DE UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE ENTREGAREMOS COPIA DE ESTAS CONSTANCIAS CON FECHA MAS RECIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR ACUSE DE RECEPCIÓN Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PRESENTAR CONSTANCIA ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO.
2.	4.5.1 ESCRITOS MANIFIESTOS ORIGINAL INCISO DE CONSTANCIA ADEUDOS Y EN A) DE	SOLICITAMOS NUEVAMENTE LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS CONSTANCIAS DE ADEUDOS CON SELLO AL 20 DE MAYO DE 2022 , A COMPAÑADOS DE UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS Y PREVIO A LA FIRMA DEL	NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR ACUSE DE RECEPCIÓN Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PRESENTAR CONSTANCIA ORIGINAL A

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the third table]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		CONTRATO CORRESPONDIENTE ENTREGAREMOS COPIA DE ESTAS CONSTANCIAS CON FECHA ACTUALIZADA ¿SE ACEPTA?	LA FIRMA DEL CONTRATO.
3.	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO R) PROPUESTA CONJUNTA Y ANEXO 25	EN CASO DE QUE MI RPERESENTADA NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO SERA SUFICIENTE EL PRESENTAR UN ESCRITO MANIFESTANDO QUE NO NOS APLICA POR NO PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA Y ASI MISMO EL PRESENTAR EL ANEXO 25 CON LA LEYENDA EN MARCA DE AGUA " NO APLICA " ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
4.	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA ANEXO TÉCNICO - GARANTIAS NUMERAL 3.1 DE LOS BIENES ANEXO 1.8 "PRESCRIPCIONES DE BIENES" APARTADO	SOLICITAMOS LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PUEDA PROPORCIONAR DENTRO DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES EL ANEXO 1.8 "PRESCRIPCIONES DE BIENES" , YA QUE DENTRO DE LAS PRESENTES BASES NO PODEMOS UBICAR DICHO ANEXO ¿FAVOR DE MANIFESTARSE?	EL ANEXO 1.8 SERÁ ENVIADO A SU CORREO PROPORCIONADO
5.	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.2 VISITAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE CON LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 30, 36, 37, 41, 59, 115 Y 163 , NO SERA NECESARIO ADJUNTAR A NUESTRA PROPUESTA TECNICA EL ANEXO 1.6 "CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA" ASI COMO LOS PLANOS ARQUITECTONICOS, GUIAS MECÁNICAS Y ELECTRICAS, POR LO QUE NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA SU NO PRESENTACIÓN ¿ES ESTO CORRECTO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE PRECISAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
6.	4.7.1.1 PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIADOS	DEBIDO A QUE EN ALGUNAS OCASIONES UN SOLO CATÁLOGO, FOLLETO O MANUAL HACE REFERENCIA A MAS DE UNA PARTIDA SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR ESTOS POR FAMILIA DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON LA PARTIDA QUE CORRESPONDE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
7.	4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES, REGISTROS SANITARIOS	DEBIDO A QUE, EN LA MAYORIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN Y DE LABORATORIO SE INCLUYEN DENTRO DE ESTOS DIFERENTES PARTIDAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA REFERENCIANDO LA PARTIDA QUE CORRESPONDE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
8.	4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES, REGISTROS SANITARIOS	NUEVAMENTE Y CON EL FIN DE HACER UN EVENTO MAS AGIL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		LOS CERTIFICADOS POR FAMILIA, YA QUE EN ALGUNAS OCASIONES ESTOS REFIEREN A UN GRUPO DE MATERIALES O INSUMOS QUE EL PROPIO FABRICANTE ELABORA, LOS CUALES PRESENTAREMOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS ¿SE ACEPTA?	
9.	4.7.1.5 GUÍAS MECÁNICAS	EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE CON LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 30, 36, 37, 41, 59, 115 Y 163, NO SERA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR LAS GUÍAS MECÁNICAS O DEBEMOS PRESENTAR UN ESCRITO EN EL CUAL INDIQUEMOS BREVEMENTE EL MOTIVO POR EL CUAL NO NOS APLICA ¿FAVOR DE PRECISAR?	ES CORRECTO
10.	4.7.1.6 CRONOGRAMA DE Y INSTALACIÓN CAPACITACIÓN	NUEVAMENTE Y EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE CON LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 30, 36, 37, 41, 59, 115 Y 163, NO SERA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN ¿FAVOR DE PRECISAR?	ES CORRECTO
11.	4.7.1.9 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO Y NUMERAL 4.7.1.10 SOPORTE TÉCNICO	DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1.8 Y EN CASO DE QUE LO INSUMOS OFERTADOS POR MI REPRESENTADA NO REQUIERAN MANTENIMIENTO PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO SERA SUFICIENTE EL PRESENTAR UN ESCRITO EN EL CUAL DECLAREMOS QUE LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 4.7.1.9 Y 4.7.1.10, NO NOS APLICA, YA QUE LOS BIENES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA NO REQUIEREN MANTENIMIENTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SOLO EN EL CASO DE QUE LAS PARTIDAS QUE OFERTE, NO LO REQUIERAN
12.	4.7.1.12 LICENCIAMIENTO	EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE CON LAS PARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7, 23 Y 111, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO SERA SUFICIENTE EL PRESENTAR UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFESTEMOS BREVEMENTE EL MOTIVO POR EL CUAL NO NOS APLICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
13.	4.7.1.18 TECNOSIGILANCIA	CON RELACIÓN A LA ALTA DE UNIDAD Y RESPONSABLE DE TECNOSIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS, ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHO CERTIFICADO DEBERA DE VENIR A NOMBRE DEL LICITANTE PARTICIPANTE CON EL CUAL SE ACREDITARA QUE ESTE DA CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2012, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
14.	ANEXO TECNICO PARTIDA 47 - CAMA CAMILLA RADIOTRANSAPARENTE	¿PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR SOLO UNA RUEDA CONDUCTIVA (ANTIESTÁTICA), YA QUE CON	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	NUMERAL 9 SUBNUMERAL 9.2. CONDUCTIVAS (ANTIESTÁTICAS)	UNA RUEDA ES SUFICIENTE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS, SE ACEPTA?	
15.	ANEXO TECNICO PARTIDA 47 - CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE NUMERAL 11 SUBNUMERAL 11.1 TRENDELNBURG DE 12° O MAYOR	¿PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ALGUNOS PARÁMETROS DE LA CAMA CON UNA TOLERANCIA DE +-20%, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES
16.	ANEXO TECNICO PARTIDA 47 - CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE NUMERAL 11 SUBNUMERAL 11.2 TRENDELNBURG INVERTIDO DE 12° O MAYOR	¿PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ALGUNOS PARÁMETROS DE LA CAMA CON UNA TOLERANCIA DE +-20%, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BASES

35. – SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA BIOMEDICA, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1.	CARRO DE EMERGENCIA CLAVE SAICA 531.191.0391-11	FICHA TÉCNICA NO VIENE DENTRO DE LAS BASES INTEGRACIÓN DE ACCESORIOS	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
2.	CARRO DE MEDICAMENTOS CLAVE SAICA 513.461.0054-03	NO HAY FICHA TÉCNICA INTEGRACIÓN O DISTRIBUCIÓN	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
3.	EQUIPAMIENTO PARA FARMACIA DOSIS UNITARIA CLAVE SAICA 513.461.0054-01	NO HAY FICHA TÉCNICA NO TIENE DESCRIPCIÓN DE INTEGRACIÓN	SE CONTESTA SU PREGUNTA CON LA PRESICIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

36. – MOTIONCORP, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS; TERCER PÁRRAFO.	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR LAS PROPUESTAS FOLIADAS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PUEDE FOLIAR CADA PROPUESTA POR SEPARADO, LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, PARA FINES DE AGILIDAD Y NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN
2	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA; INCISO G.	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHA CONSTANCIA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN, DEBIDO A LOS PLAZOS RECORTADOS DEL PRESENTE EVENTO, YA QUE PARA DICHO TRÁMITE ES POR MEDIO DE CITAS.	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE SU PROPUESTA INCLUYA LOS ACUSES DE RECIBIDOS POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE Y EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR DICHAS CONSTANCIAS EN ORIGINAL.
3	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA; INCISO H.	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL PADRÓN DE PROVEEDORES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN O BASTARÁ CON EL TRÁMITE DEL PADRÓN, DEBIDO A QUE LA PLATAFORMA ESTÁ EN MANTENIMIENTO.	SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR CORREO EL QUE INDIQUE EL TRÁMITE, ASÍ COMO CONSTANCIA ANTERIOR, SIN EMBARGO EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO.
4	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL; INCISO A	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTOS NUMERALES NO CORRESPONDEN A DICHO ANEXO, ASÍ MISMO NOS INDIQUE A QUE NUMERALES PERTENECE.	DICHOS NUMERALES SE REFIEREN A LA FUNDAMENTACIÓN DESCRITA EN ESTE NUMERAL.
5	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL; INCISO N, R.	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE QUE DICHOS ESCRITOS NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, NO DEBEREMOS ENTREGARLOS.	PARA EL INCISO N), DEBERA DE PRESENTAR YA QUE HACE REFERENCIA A SU DOMICILIO FISCAL. PARA EL INCISO R) DEBERA PRESENTALO SOLAMENTE SI PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA.
5 BIS	ANEXO TÉCNICO, 4.2 VISITAS; NUMERAL 4.7.1.5, 4.7.1.6, 4.7.1.12, 4.7.1.13, 4.7.1.18, 4.7.1.19, 4.7.1.23.	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE QUE DICHOS ESCRITOS NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, NO DEBEREMOS ENTREGARLOS.	SI LA PARTIDA QUE VA A OFERTAR ESTA MENCIONADA EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS NUMERALES MENCIONADOS SI LE APLICAN, CASO CONTRARIO NO LE APLICAN. SI EL EQUIPO A OFERTAR REQUIERE REGISTRO SANITARIO LE APLICA EL PUNTO DE TECNOSIGILANCIA Y LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS, SI EL BIEN NO REQUIERE EL REGISTRO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

			SANITARIO NO LE APLICA LA TECNOVIGILANCIA NI EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS
7	ANEXO TÉCNICO, 4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE DEBERÁN ELIMINAR LAS NORMAS QUE NO APLIQUEN A LA PARTIDA OFERTADA.	DEBERÁ ESPECIFICAR A QUÉ PARTIDA SE REFIERE, Y APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.3 DE BASES
8	ANEXO TÉCNICO, 4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES; CUARTO PÁRRAFO.	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LAS PARTIDAS QUE NO APLIQUE LA ENTREGA DE REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS, ETC., DE EQUIPO MÉDICO BASTARÁ CON PRESENTAR LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL QUE LA EXIME DE LOS MISMOS.	CUANDO EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR, CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O PRESENTAR COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2014, DONDE SE PUBLICÓ EL ACUERDO.Y DEBERÁ ESTAR REFERENCIADO EN EL LISTADO, EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER JUSTA EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO
9	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS ELECTRÓNICAS DEBIDO A LOS PLAZOS RECORTADOS DEL PRESENTE EVENTO, YA QUE NUESTROS SOCIOS COMERCIALES SE ENCUENTRAN EN ASIA Y EUROPA.	PUEDEN AGREGAR CARTA IMPRESA, PERO ADJUNTANDO EL CORREO ELECTRONICO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ENVÍA LA CARTA, SIN ESTO , SE CONSIDERARA PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARA LA PROPUESTA
10	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.18 TECNOVIGILANCIA.	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE DICHO NUMERAL NO APLICA PARA LAS PARTIDAS 43,173 Y 184.	SOLO SE PUBLICÓ LA PARTIDA 43
11	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.20 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN MI CASO NO PARTICIPARÉ EN PARTIDAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, PERO MI REPRESENTADA CUENTA CON AVISO DE FUNCIONAMIENTO REFERENTE A LAS PARTIDAS QUE OFERTARÉ, POR LO QUE PRESENTARÉ DICHO DOCUMENTO APLICABLES PARA LAS MISMAS.	NO SE ENTIENDE SU PREGUNTA
12	ANEXO 1, PARTIDA 173	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN ES LA QUE SOLICITA LA CONVOCANTE: CARROS DE MEDICACIÓN POR SERVICIO 1. CARROS TRANSFER 1.1. COMPATIBLE CON EL CARRO A PIE DE CAMA	SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		1.2. CARRO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA A PISO 1.3. DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 1.4. CAPACIDAD DE CARGA DE POR LO MENOS 40 CAJETINES CADA UNO 1.5. RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.6. ACCESO A LOS CONTENEDORES 1.7. PESO CARRO VACÍO DESDE 54 KILOS O MENOR 1.8. ARRASTRE MANUAL 1.9. ESTRUCTURA DE ALUMINIO 1.10. CON AL MENOS 2 FRENOS EN LAS 4 RUEDAS 1.11. RUEDAS DE PROTECCIÓN ANTE HILOS 2. CARRO A PIE DE CAMA (6 EQUIPOS) 2.1. COMPATIBLE CON EL CARRO TRANSFER 2.2. CARRO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS A PIE DE CAMA 2.3. DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 2.4. CANTOS Y BORDES REDONDEADOS 2.5. CAJETINES EXTRAÍBLES E INTERCAMBIABLES 2.6. CON AL MENOS 2 FRENOS EN LAS 4 RUEDAS 2.7. CON BOTE PARA DESECHOS 2.8. CON BANDEJA LATERAL EXTENDIBLE 2.9. CONFIGURACIÓN DE LOS CARROS CON CAJETINES 2.9.1. UN CARRITO PARA AL MENOS 14 CAJETINES 2.9.1.1. SE DEBE INCLUIR UN JUEGO EXTRA DE CAJETINES POR CADA CARRO 2.9.2. DOS CARRITOS PARA AL MENOS 12 CAJETINES 2.9.2.1. SE DEBE INCLUIR UN JUEGO EXTRA DE CAJETINES POR CADA CARRO 2.9.3. UN CARRITO PARA AL MENOS 10 CAJETINES 2.9.3.1. SE DEBE INCLUIR UN JUEGO EXTRA DE CAJETINES POR CADA CARRO 2.9.4. DOS CARRITOS PARA AL MENOS 6 CAJETINES	
--	--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		SE DEBE INCLUIR UN JUEGO EXTRA DE CAJETINES POR CADA CARRO DESCRIPCIÓN GENÉRICA. CARRO DE MEDICACIÓN POR SERVICIO. CARROTRANSFER MODULAR CERRADO. CARRO PARA EL TRANSPORTE DE INSUMOS TERAPÉUTICOS DE FARMACIA-ALMACÉN, A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITALARIA PARA EL SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LOS CARROS A PIE DE CAMA Y OTRAS ÁREAS HOSPITALARIAS. 1 PUERTA TIPO CORTINA CON CERRADURA MECÁNICA. ES LIGERO, ESTABLE, ROBUSTO, DE FÁCIL MANIOBRABILIDAD, CÓMODA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CUERPO DEL CARRO MONOBLOC FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO PLEGADA Y RECUBRIMIENTO EPOXY. INTERIOR CUERPO DOTADO C/PANELES GUÍA LATERALES PARA USO DE MÓDULOS 600 400 MM (ISO 3394 LAS 4 ESQUINAS DEL CARRO DOTADAS C/ 1 ASA ERGONÓMICA PARA UNA CÓMODA MANIOBRABILIDAD PERIMETRAL DE LA BASE CARRO DOTADO CON PARACHOQUES (PARA AMORTIGUACIÓN DE IMPACTOS BASE DOTADO C/ 4 RUEDAS GIRATORIAS BANDA ÚNICA (BANDA DOBLE OPCIONAL) DE DIÁM 125 MM, 2 C/FRENO Y 1 CONDUCTIVA DIMENSIONES: ANCHO 610 MM X PROFUNDIDAD 770 MM X ALTURA 1655 MM PESO VACÍO: 47 KG. CAPACIDAD PARA 3 CASSETTES.	
--	--	--	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

[Handwritten signature]

13	ANEXO 1, PARTIDA 184	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN ES LA QUE SOLICITA LA CONVOCANTE: DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO PARA FARMACIA UNIDOSIS DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: EQUIPO DE ENVASADO UNITARIO PARA SÓLIDOS ORALES 1. PARA ENVASADO DE EMPAQUE PRIMARIO Y ETIQUETADO DE MEDICAMENTO POR DOSIS UNITARIA. 2. SEMIAUTOMÁTICA 3. VELOCIDAD DE 60 UNIDADES POR MINUTO COMO MÍNIMO 4. PARA EMPACADO TIPO BLISTER 5. SISTEMA DE IMPRESIÓN TÉRMICA 6. CON SISTEMA DE SEGURIDAD 7. ENVASADO DE MEDICAMENTO DE MÁXIMO VOLUMEN COMO EMBLISTADO 8. SELLADO HERMÉTICO 9. MÍNIMO DOS DISCOS ESTÁNDAR PARA ENVASADO DE CÁPSULAS Y COMPRIMIDOS 10. SISTEMA DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 10.1. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, COMPATIBLE CON EL SOFTWARE DE OPERACIÓN 10.2. TECLADO, MOUSE, MONITOR 10.3. LICENCIA SIN TIEMPO DE CADUCIDAD 10.4. REGULADOR DE PC CON CAPACIDAD DE ACUERDO A CONDICIONES ELÉCTRICAS 11. SOFTWARE DE DISEÑO DE ETIQUETAS 11.1. IDIOMA ESPAÑOL 11.2. ACCESO POR CONTRASEÑA 11.3. CREACIÓN DE DIFERENTES PERFILES DE USUARIO 11.4. IMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CÓDIGO DE BARRAS, QR COMO MÍNIMO 11.5. LIBRERÍA DE PRODUCTOS 11.6. CAPACIDAD DE DISEÑO DE ETIQUETAS COMO LO INDICA EL SUPLEMENTO DE LA FARMACIA DE LA SEXTA EDICIÓN DE LA FEUM, COMO MÍNIMO 11.6.1. DENOMINACIÓN GENÉRICA 11.6.2. DOSIS 11.6.3. FORMA FARMACÉUTICA 11.6.4. LOTE DE FABRICANTE	SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
----	----------------------	---	---

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		11.6.5. VÍA DE ADMINISTRACIÓN 11.6.6. NOMBRE DEL FABRICANTE 11.6.7. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO 11.6.8. FECHA Y PREPARACIÓN DE LAS DU 11.6.9. VIGENCIA DE LAS DU (DD/MM/AA) 12. NOMBRE DE QUIEN PREPARÓ LA DU 1.1. IMPRESIÓN DE INFORMES 1.2. COPIA DE SEGURIDAD 1.3. LICENCIA DE SOFTWARE SIN TIEMPO DE CADUCIDAD 2. CALIFICACIÓN DE CALIDAD DEL EQUIPO 12.1 INSTALACIÓN 12.2 PUESTA EN MARCHA 12.3 DESEMPEÑO 3. MESAS DE TRABAJO (2) 3.1. DOS MESAS DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 3.2. UNA MESA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 180 X 70 X 90 CM (LARGO, FONDO, ALTO) A PARED 3.2.1. CAPACIDAD DE CARGA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE RE ACONDICIONAMIENTO 3.2.2. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304, CAL. 16 3.2.3. ACABADO PULIDO SANITARIO, CON PESTAÑA INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO INOX CAL. 20. 3.2.4. CON ARMAZÓN DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CUADRADO DE 32X32MM, EN TRES DE SUS LADOS POR LA PARTE INFERIOR 3.2.5. EN PARTE INFERIOR UN ENTREPAÑO REFORZADO, CAL. 16 3.2.6. REGATONES, FIJADORES, NIVELADORES DE ALTURA EN LAS 4 PATAS. 3.2.7. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR BIEN ENSAMBLADOS Y SOLDADOS.	
--	--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		3.2.8. SUPERFICIES LISAS, SIN REMACHES. 3.2.9. LA SOLDADURA PARA EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER CONTINUA, NO PUNTEADA 3.2.10. LOS DOBLECES DEBERÁN IR SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS 3.2.11. EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER UNIFORME; DE BUENA CALIDAD Y DE GRADO SANITARIO 3.3. UNA MESA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 100 X 50 X90 CM (LARGO, FONDO, ALTO) A PARED 3.3.1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL 16 3.3.2. ACABADO PULIDO SANITARIO, CON PESTAÑA INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 3.3.3. CON ARMAZÓN DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CUADRADO DE 32 X 32 MM, EN TRES DE SUS LADOS POR LA PARTE INFERIOR. 3.3.4. EN LA PARTE INFERIOR UN ENTREPAÑO REFORZADO, CAL. 16 3.3.5. REGUETONES, FIJADORES, NIVELADORES DE ALTURA EN 4 PATAS. 3.3.6. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR BIEN ENSAMBLADOS Y SOLDADOS. 3.3.7. LA SOLDADURA PARA EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER CONTINUA, NO PUNTEADA 3.3.8. LOS DOBLECES DEBERÁN IR SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS 3.3.9. EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER UNIFORME DE BUENA	
--	--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		CALIDAD Y DE GRADO SANITARIO 3.3.10. SUPERFICIES LISAS SIN REMACHES 4. UN BANCO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 4.1. ALTURA 93CM, DIÁMETRO 34 CM, LARGO DE RESPALDO 34CM 4.2. CAPACIDAD DE CARGA 100KG COMO MÍNIMO 4.3. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 CON DISEÑO ERGOMÉTRICO, 4.4. ASIENTO CON PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO 4.5. RESPALDO: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 14. 4.6. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO. 4.7. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.18, DE 22 MM (7/8) DE DIÁMETRO. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 38 MM (1 ½"), CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 12.1.ACABADOS: ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN PULIDO SANITARIO. CONSUMIBLES PARA DOS AÑOS: 1. PAPEL TÉRMICO 65,000 EMPAQUES INDIVIDUALES POR AÑO 2. CUBIERTA QUE PROTEJA AL MEDICAMENTO DE LA LUZ, LO SUFICIENTE PARA REACONDICIONAR 65,000 EMPAQUES INDIVIDUALES POR AÑO DESCRIPCIÓN GENÉRICA: MAQUINA SEMI AUTOMÁTICA PARA REACONDICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EMPAQUE UNITARIO PARA DISTRIBUCIÓN EN DOSIS UNITARIA CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 60 PIEZAS POR MINUTO.	
--	--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

	CON DISCO ESTÁNDAR PARA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS MANTENIENDO EMPAQUE PRIMARIO (BLISTER). SISTEMA DE IMPRESIÓN Y SELLADO TÉRMICO PARA UN EMPAQUE HERMÉTICO. CAPACIDAD PARA CONFIGURAR E IMPRIMIR CÓDIGO DE BARRA O QR PARA MANTENER TRAZABILIDAD DEL USO Y MANEJO DE MEDICAMENTOS. SOFTWARE DE GESTIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL, PERMISOS DE OPERACIÓN ACORDE A PERFIL DE USUARIOS, ACCESO POR MEDIO DE CONTRASEÑA PERSONALIZADO, CON CAPACIDAD PARA EL DISEÑO DE ETIQUETA CONFORME A REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA FEUM EN IDIOMA ESPAÑOL: DENOMINACIÓN GENÉRICA, DOSIS, FORMA FARMACÉUTICA, LOTE DE FABRICANTE, NOMBRE DEL FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO, FECHA DE PREPARACIÓN DE D.U., VIGENCIA DE LAS D.U (DD/MM/AA), NOMBRE DE QUIEN PREPARO LAS D.U., LEYENDAS DE SEGURIDAD (CONFORME A NECESIDAD DE LA UNIDAD). CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS (IMAGEN DE PRODUCTOS) Y DE LOS REPORTES DE OPERACIÓN POR PRODUCTO / USUARIO. ESTACIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO CON LICENCIA DE OPERACIÓN PERMANENTE, CONTIENE: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, TECLADO, MOUSE, MONITOR Y REGULADOR DE PC. DIMENSIONES ANCHO: 550 MM PROFUNDIDAD: 540 MM ALTURA: 487 MM PESO: 48 KG VELOCIDAD DE OPERACIÓN MÁX. 60 DOSIS UNITARIA POR MINUTO CAPACIDAD DE OPERACIÓN: DISCO CON 45 CAVIDADES TAMAÑO DE SOBRE: 70 X 75 MM CONSUMO DE ENERGÍA: MÁX. 500 WATTS ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 VCA, 60 HZ. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 40 °C HUMEDAD DE OPERACIÓN: 10 - 80 %	
--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		SISTEMA DE IMPRESIÓN: TRANSFERENCIA TÉRMICA INFORMACIÓN PARA IMPRESIÓN: TODO TIPO DE CARACTERES, CÓDIGOS DE BARRAS E IMÁGENES. "MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO SANITARIO AISI 304 CON DIMENSIONES DE 180 X 70 X 90 CM" MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO SANITARIO AISI 304 CON DIMENSIONES DE 100 X 50 X 90 CM" "BANCO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON CAPACIDAD DE CARGA 100 KG MÍNIMO. CON ACABADO TIPO SANITARIO. (ALTURA 93 CM, DIÁMETRO 34 CM, LARGO DE RESPALDO 34 CM.). " CONSUMIBLES PARA 2 AÑOS: ROLLO DE PAPEL PARA SELLADO TÉRMICO CON CAPACIDAD DE PROTECCIÓN UV. CONSUMIBLES PARA 2 AÑOS: ROLLO DE TINTA PARA IMPRESIÓN TÉRMICA. (PLACA DE DATOS EN ACERO INOXIDABLE) GARANTÍA DEL BIEN (PÓLIZA POR 2 AÑOS / INCLUYE CAPACITACIÓN)	
15	ANEXO 29, PLAZOS DE ENTREGA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LOS TIEMPOS DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS 43,173 Y 184.	SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

37. – HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1	PUNTO 2.3. PERÍODO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.	DICE "EL LICITANTE DEBERÁ ATENDER LOS PLAZOS DE ENTREGA SEÑALADOS EN EL ANEXO 29" REVISANDO EL ANEXO 29 Y EL ANEXO 1, EL LISTADO DE LAS PARTIDAS ESTA INCOMPLETO CON RESPECTO DEL ANEXO 1.8 QUE NOS PROPOCIONARON EN FORMATO EXCEL CON LA OCMpra DE LAS BASES, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS DEN LA INFORMACION DE LAS PARTIDAS 3, 4, 6, 7, 23, 26, 31, 33, 42, 46, 48, 57 Y 78. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LAS PARTIDAS EN MENCIÓN.	SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
2	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA CANTIDAD QUE ESTIPULAN PARA LA ENTREGA EN EL ANEXO 29 SON DIAS O SEMANAS, FAVOR DE ACLARAR	SE REFIERE A DÍAS NATURALES
3	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	EN CASO QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA LA CANTIDAD EN "DIAS" SOLICITAMOS QUE SE ESTIPULEN UNA CANTIDAD DE DIAS UNIFORME PARA TODAS LAS PARTIDAS YA QUE LA VARIACION EN DIAS DE UNAS PARTIDAS CON OTRAS ESTAN MUY DISTANTES UNAS DE OTRAS ALGUNAS CON MUY POCOS DIAS, TIEMPO IMPOSIBLE PARA CUMPLIR CON EL EQUIPO DE IMPORTACION, POR LO QUE PEDIMOS UNIFORMIDAD EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA PARA QUE TODOS LOS LICITANTES TENGAN LAS MISMAS CONDICIONES DE PODER PARTICIPAR, AUNADO A ESTO CONSIDERAMOS QUE EL HOSPITAL ENTRARA EN FUNCIONES EN CIERTA FECHA POR LO QUE SOLICITAMOS SE PIDA 90 DIAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPORTACION ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL ANEXO 29 ASÍ COMO LOS DERIVADOS DE LA PRESENTE JUNTA
4	ANEXO 1.1 FICHAS TECNICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CEDULAS TECNICAS DE LAS PARTIDAS: 3, 4, 6, 7, 23, 26, 31, 33, 42, 46, 48, 78 Y 117. YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN LAS BASES DE LA LICITACION, FAVOR DE PROPORCIONARLAS	SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
5	ANEXO 1.1 FICHAS TECNICAS	DE ACUERDO A NUESTRA SOLICITUD EN LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONOVCANTE QUE UNA VEZ QUE SE NOS HAYA ENTREGADO LAS CEDULAS FALTANTES NOS PROPORCIONE OTRO PLAZO PARA REVISAR ESTAS CEDULAS Y ELABOREMOS LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES DE	SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		LA CEDULAS FALTANTES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
6	ANEXO 1.1 FICHAS TECNICAS	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EXPONGA EL SUSTENTO POR LA CUAL NO SE ENTREGO LA INFORMACION COMPLETA PARA TENER OPORTUNIDAD DE EXPONER NUESTRAS DUDAS Y TAMBIEN LA RAZON JUSTIFICADA Y/O SUSTENTO POR LA CUAL NOS DEJARAN EN ESTADO DE INDEFENSION ANTE LA FALTA DE OPORTUNIDAD	SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
7	PUNTO 4.7.1.5. GUIAS MECANICAS	SOLICITAMOS QUE LAS GUIAS MECANICAS SEAN SOLICITADAS SOLO AL LICITANTE GANADOR DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE LA LICITACION ESTAN MUY RECORTADOS PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS CON TODA ESTA INFORMACION O EN SU DEFECTO OTORGAR UN TIEMPO CONSIDERABLE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LOS SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.5 DE BASES
8	PUNTO 4.7.1.5. GUIAS MECANICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO QUE NUESTRA SOLICITUD A LA PREGUNTA ANTERIOR NO SE ACEPTADA SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO ESTE CUBIERTO CON UNA CARTA COMPROMISO DE QUE SE ENTREGARAN LAS GUIAS MECANICAS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LOS SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.5 DE BASES
9	PUNTO 4.7.1.6 CRONOGRAMA DE INSTALACION Y CAPACITACION	SOLICITAMOS QUE LOS CRONOGRAMAS DE INSTALACION Y CAPACITACION SEAN SOLICITADAS SOLO AL LICITANTE GANADOR DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE LA LICITACION ESTAN MUY RECORTADOS PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS CON TODA ESTA INFORMACION O EN SU DEFECTO OTORGAR UN TIEMPO CONSIDERABLE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LOS SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.6 DE BASES
10	PUNTO 4.7.1.6 CRONOGRAMA DE INSTALACION Y CAPACITACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO QUE NUESTRA SOLICITUD A LA PREGUNTA ANTERIOR NO SE ACEPTADA SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO ESTE CUBIERTO CON UNA CARTA COMPROMISO DE QUE SE ENTREGARA EL CRONOGRAMA DE INSTALACION Y CAPACITACION LAS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LOS SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.6 DE BASES
11	PUNTO 4.7.1.6 CRONOGRAMA DE INSTALACION Y CAPACITACION	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EL CRONOGRAMA CON FECHAS REALES EL DÍA DE ENTREGA DE GUÍAS MECÁNICAS" AQUÍ SE MENCIONA QUE SOLO EL LICITANTE ADJUDICADO	LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA SU



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		DEBERA DE ENTREGAR DICHO CRONOGRAMA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE SOLO EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR ESTA INFORMACION, FAVOR DE RATIFICAR	CRONOGRAMA DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIFICANDO LA CANTIDAD DE DIA HABILES, EL CUAL DEBE APEGARSE A LOS TIEMPOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN SOLICITADOS, ADEMÁS EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EL CRONOGRAMA CON FECHAS REALES Y LAS GUIAS DE ENTREGA AL SIGUIENTE DIA HABIL DESPUES DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y FALLO.
12	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 11 ULTRASONOGRAFO PORTATIL	PUNTO "DEFINICION" SOLICITAN EQUIPO PORTATIL DIGITA, PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI EL TERMINO PORTÁTIL SE REFIERE A QUE SE PUEDA TRASNPORAR DE UNA AREA A OTRA AREA DEL MISMOHOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA CON UN CARRO DE TRANSPORTE INTEGRADO AL EQUIPO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
13	ANEXO 1.1. FICHAS TECNICAS PARTIDA 111 ULTRASONOGRAFO PORTATIL	PUNTO 3. SOLICITAN "PESO DEL EQUIPO DEALMENOS 7.6KG CON BATERÍA O MENOR." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONOVCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PESO DEL EQUIPO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO AFECTA DE NINGUNA MANERA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO CUMPLIENDO CON LAS DEMAS CARACTERISTICAS DE SU DESCRIPCION TECNICA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	FAVOR DE INDICAR CUAL ES EL PESO DEL EQUIPO, PARA PODERNOS PRONUNCIAR A LA PETICIÓN .
14	ANEXO 22, FORMATO DE FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONOMICA, EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ANTES DE I.V.A.	DEBEMOS ENTENDER QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA Y NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA EL PRESENTAR LA FIANZA POR UN MONTO MAYOR AL 5% DEL MONTO DE NUESTRA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

15	PUNTO 4.3 ELABORACION DE LAS PROPUESTAS. INCISO B)	DEBEMOS ENTENDER QUE LA FECHA SOLICITADA PODRA SER 26 DE JULIO, INDEPENDIENTEMENTE QUE SE DIFIERA LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
16	PUNTO 4.3 ELABORACION DE LAS PROPUESTAS. INCISO E)	DEBEMOS ENTENDER QUE EL RUBRICAR LAS PROPUESTAS ES OPCIONAL, POR LO QUE NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS ¿ES CORRECTO?	LAS PROPUESTAS DEBEN DE IR RUBRICADAS EN TODAS SUS HOJAS Y FIRMADAS DONDE CORRESPONDA
17	PUNTO 4.4 PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y PROPUESTAS	DEBEMOS ENTENDER QUE EL FOLIADO DE LA PROPUESTA ES OPCIONAL POR LO QUE NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
18	PUNTO 4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO R)	ESTE PUNTO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA, POR LO QUE PARA CUMPLIR CON EL MISMO DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO SE DEBERA PRESENTAR ESCRITO INDICANDO QUE NO APLICA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

39. – OURUX, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1	ORIGEN DE LOS RECURSOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y/O LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN CORRESPONDE A RECURSOS, FEDERALES, ESTATALES O SI CORRESPONDEN A ALGÚN PROGRAMA DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI) O LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	DE CARÁCTER FISCAL
2	FUNDAMENTACIÓN Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LA CONVOCANTE: ¿REALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PREVIO, A FIN DE CONOCER LA OFERTA EN EL MERCADO DE LOS BIENES A ADQUIRIR?	SI
3	FUNDAMENTACIÓN Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR, ¿CUÁL FUE EL RESULTADO DE DICHOS ESTUDIOS DE MERCADO?	EL RESULTADO FUE QUE, SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE CUALQUIER ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO, ES DECIR: SE DETERMINO LA EXISTENCIA DE BIENES OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. SE DETERMINO LA EXISTENCIA DE PROVEEDORES QUE PUEDAN SUMINISTRARLOS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

			SE DETERMINO EL PRECIO PREPONDERANTE.
4	FUNDAMENTACIÓN Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE LA CONVOCANTE DETERMINO EL CARÁCTER INTERNACIONAL DE LA PRESENTE LICITACIÓN?	EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
5	DEL CUADRO BÁSICO Y DESCRIPCIONES TÉCNICAS	¿POR QUÉ LA CONVOCANTE NO SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y UTILIZÓ LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD PUBLICADO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL?	SE HACE LA ACLARACIÓN QUE, SI BIEN SE HACE MENCIÓN A LA CLAVES COMPENDIO EN LA PRESENTES BASES, TAMBIÉN LO ES QUE EN EL ANEXO 1 SE HACE MENCIÓN A LA CLAVE SAICA, CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE NORMATIVA DENTRO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS
6	LAS MUESTRAS	¿LA CONVOCANTE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA LAS PARTIDAS 8,9,10,11,12,13,14 Y 15?	SÍ
7	LAS MUESTRAS	DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DICHAS MUESTRAS?	PARA HACER EVALUACIÓN
8	LAS MUESTRAS	SI LA CONVOCANTE REQUIERE MUESTRAS PARA LAS PARTIDAS ,9,10,11,12,13,14 Y 15, ¿QUIÉN SE HARÁ RESPONSABLE DE DICHAS MUESTRAS Y QUIEN PAGARA EN SU CASO LOS DAÑOS O PERDIDAS, YA SEA PARCIALES O TOTALES, QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LOS EQUIPOS?	LOS LICITANTES
9	LAS MUESTRAS	¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁN LAS MUESTRAS EN CUSTODIA DE LA CONVOCANTE?	SE EVALUAN Y SE REGRESARÁN,TERMINANDO LA EVALUACIÓN, DEBE DE ASISTIR EL ESPECIALISTA DE PRODUCTO.
10	LAS MUESTRAS	¿CUÁNDO PODREMOS RECOGER LAS MUESTRAS PRESENTADAS?	AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN.
11	GARANTÍAS	¿LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS QUE LO AMERITAN, SE REALICE CADA SEIS MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA?	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ANEXO 1.8.
12	GARANTÍAS	¿QUIÉN VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS?	EL INGENIERO BIOMEDICO DEL HOSPITAL.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

13	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	¿LA CONVOCANTE ESTA CONSIENTE, DE LA SITUACIÓN QUE AQUEJAN A LAS CADENAS GLOBALES DE PRODUCCIÓN, QUE IMPACTA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL EN TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES CON CONTENIDO DE SEMICONDUCTORES Y MICROPROCESADORES PARA PRODUCIR EQUIPO MÉDICO DE ALTA TECNOLOGÍA Y EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO, PARA CONSIDERAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO AL ANEXO 29 "PLAZOS DE ENTREGA"?	LOS TIEMPOS DE ENTREGA PREVISTOS EN EL ANEXO 29, SE CONSIDERAN DE ACUERDO A LOS PLAZOS DE ENTREGA DERIVADOS DEL SONDEO DE MERCADO
14	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	¿LA CONVOCANTE ESTÁ DISPUESTA A AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA? CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR LA LIBRE COMPETENCIA EN ESTE ACTO LICITATORIO.	DEBERA INDICAR QUE PARTIDA EN ESPECIFICO
15	ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA	DERIVADO DE LAS PROBLEMÁTICAS CAUSADAS POR LA PANDEMIA SARS-COV-2 (COVID-19), EXISTE UNA SOBRE DEMANDA DE TODO TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS ALREDEDOR DE TODO EL MUNDO, LO QUE HA PROVOCADO UNA CRISIS Y ESCASES DE INSUMOS, TENIENDO COMO RESULTADO MAYORES TIEMPOS O PLAZOS DE ENTREGA; EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, DE 60 DÍAS NATURALES ¿SE ACEPTA?	DEBERA INDICAR QUE PARTIDA EN ESPECIFICO
16	4.2 VISITA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE PARA QUE PARTIDAS APLICAN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS.	PREGUNTA ATENDIDA CON LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE NUMERO 1
17	PARTIDA 8: NUMERAL 3.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE YA QUE SOLICITAN UNA PANTALLA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 3MB ¿SE DEBERÁ ENTENDER 3 MEGA PÍXELES, ES CORRECTO?	ATENDER LA PRECISIÓN 6
18	PARTIDA 8: NUMERAL 3.1	EN CASO DE SER CORRECTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HD), YA QUE LA SOLICITADA ES PARA PANTALLAS CON TECNOLOGÍA 4K, QUE GENERALMENTE SE USAN PARA FINES DE ENTRETENIMIENTO, EN LAS CENTRALES DE MONITOREO SOLO SE REQUIERES VISUALIZAR LOS DATOS NUMÉRICOS Y TRAZOS DE LOS SIGNOS VITALES DE LOS PACIENTES, ESTOS REQUISITOS SE CUMPLEN SOBRADAMENTE Y SATISFACEN CON PANTALLAS DE TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HD), ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTO CON LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR.
19	PARTIDA 9, NUMERAL 1, MONITOR MODULAR	DERIVADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LOS MONITORES ACTUALES CONFIGURADO HAN SUPLENDO LA NECESIDAD DE TENER MONITORES MODULARES LOS CUALES FUERON DISEÑADOS PARA ECONOMIZAR EL COSTO POR PARÁMETROS QUE SE USABAN DE FORMA MENOS CONSTANTE. EN LA ACTUALIDAD LAS TECNOLOGÍAS NOS PERMITEN TENER LA MAYOR PARTE DE PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE EN UN MONITOR PRE-CONFIGURADO, CON LA VENTAJA DE AMINORAR EL COSTO CON RESPECTO A LOS MONITORES MODULARES, NO SUFRE DAÑO FÍSICO POR CAÍDAS Y SOBRE TODO QUE NO SE PIERDE, NI ES SUSCEPTIBLE DE ROBO ADEMÁS EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE ALGÚN OTRO SIGNO VITAL QUE NO ESTUVIESE INTEGRADO AL MONITOR, CUENTA CON LA CAPACIDAD DE TENER	NO SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		PUERTOS PARA CONECTAR LOS MÓDULOS DE ALTA ESPECIALIDAD. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PARA NO LIMITAR LAS TECNOLOGÍAS Y LOS BENEFICIOS QUE ESTA BRINDA A LOS PACIENTES SE ACEPTE PODAMOS PARTICIPAR CON MONITOR CONFIGURADO, CON CONEXIONES PARA MÓDULOS DE ALTA ESPECIALIDAD, ¿SE ACEPTA?	
20	PARTIDA 9, NUMERAL 1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI DEBEMOS ENTENDER POR "8 CANALES CONFIGURABLES" 8 ÁREAS DESIGNADAS PARA LAS CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS.	SE REFIERE A QUE EL MONITOR DEBE TENER 8 CANALES INDEPENDIENTES Y CONFIGURABLES, ES DECIR QUE EL USUARIO PUEDE DEFINIR QUE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS COLOCAR EN CUALQUIER CANAL ADEMÁS DE PODER CONFIGURAR EL PARÁMETRO FISIOLÓGICO INDEPENDIENTE COMO POR EJEMPLO UN VALOR DE ALARMA ALTO Y BAJO
21	PARTIDA 9, NUMERAL 1.19	EN RELACIÓN AL SISTEMA SAMIH, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL PROTOCOLO HL7 ¿ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS BIDIRECCIONAL CON ESTE SISTEMA?	HL7 Y REFERENCIAR TODAS LAS CARACTERÍSTICAS QUE ESTÉN EN ESTE PUNTO
22	PARTIDA 10, NUMERAL 3.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE YA QUE SOLICITA UNA PANTALLA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 3MB SE DEBERÁ ENTENDER 3 MEGA PÍXELES, ¿ES CORRECTO?	ATENDER PRECISIÓN 6.
23	PARTIDA 10, NUMERAL 3.1	EN CASO DE SER CORRECTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HD), YA QUE LA QUE LA SOLICITADA ES PARA PANTALLAS CON TECNOLOGÍA 4K, QUE GENERALMENTE SE USAN PARA FINES DE ENTRETENIMIENTO, EN LAS CENTRALES DE MONITOREO SOLO SE REQUIERES VISUALIZAR LOS DATOS NUMÉRICOS Y TRAZOS DE LOS SIGNOS VITALES DE LOS PACIENTES, ESTOS REQUISITOS SE CUMPLEN SOBRADAMENTE Y SATISFACEN CON PANTALLAS DE TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HD), ¿SE ACEPTA?	SE CONTESTA CON LA RESPUESTA ANTERIOR
24	PARTIDA 11, NUMERAL 1, MONITOR MODULAR	DERIVADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LOS MONITORES ACTUALES CONFIGURADOS HAN SUPLIDO LA NECESIDAD DE TENER MONITORES MODULARES LOS CUALES FUERON DISEÑADOS PARA ECONOMIZAR EL COSTO POR PARÁMETROS QUE SE USABAN DE FORMA MENOS CONSTANTE. EN LA ACTUALIDAD LAS TECNOLOGÍAS NOS PERMITEN TENER LA MAYOR PARTE DE PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE EN UN MONITOR PRE-CONFIGURADO, CON LA VENTAJA DE QUE SE AMINORA EL COSTO CON RESPECTO A LOS MONITORES MODULARES, NO SUFRE DAÑO FÍSICO POR CAÍDAS Y SOBRE TODO QUE NO SE PIERDE, NI ES SUSCEPTIBLE DE ROBO ADEMÁS EN CASO DE QUE SE REQUIERE DE ALGÚN OTRO SIGNO VITAL QUE NO ESTUVIESE INTEGRADO AL MONITOR, CUENTA CON LA CAPACIDAD DE TENER PUERTOS PARA CONECTAR LOS MÓDULOS DE	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		ALTA ESPECIALIDAD. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PARA NO LIMITAR LAS TECNOLOGÍAS Y LOS BENEFICIOS QUE ESTA BRINDA A LOS PACIENTES SE ACEPTÉ PODAMOS PARTICIPAR CON MONITOR CONFIGURADO, CON CONEXIONES PARA MÓDULOS DE ALTA ESPECIALIDAD.	
25	PARTIDA 11, NUMERAL 1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI DEBEMOS ENTENDER POR "8 CANALES CONFIGURABLES" 8 ÁREAS DESIGNADAS PARA LAS CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS.	SE REFIERE A QUE EL MONITOR DEBE TENER 8 CANALES INDEPENDIENTES Y CONFIGURABLES, ES DECIR QUE EL USUARIO PUEDA DEFINIR QUE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS COLOCAR EN CUALQUIER CANAL ADEMÁS DE PODER CONFIGURAR EL PARÁMETRO FISIOLÓGICO INDEPENDIENTE COMO POR EJEMPLO UN VALOR DE ALARMA ALTO Y BAJO
26	PARTIDA 11, NUMERAL 1.19	EN RELACIÓN AL SISTEMA SAMIH, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL PROTOCOLO HL7 ¿ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS BIDIRECCIONAL CON ESTE SISTEMA?	HL7 ADEMÁS DE REFRENCIAR TODOS LOS PUNTOS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

27	PARTIDA 12, NUMERAL 3.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE YA QUE SOLICITAN UNA PANTALLA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 3MB SE DEBERÁ ENTENDER 3 MEGA PÍXELES, ¿ES CORRECTO?	YA SE CONTESTO
28	PARTIDA 12, NUMERAL 3.1	EN CASO DE SER CORRECTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HD), YA QUE LA QUE LA SOLICITADA ES PARA PANTALLAS CON TECNOLOGÍA 4K, QUE GENERALMENTE SE USAN PARA FINES DE ENTRETENIMIENTO, EN LAS CENTRALES DE MONITOREO SOLO SE REQUIERES VISUALIZAR LOS DATOS NUMÉRICOS Y TRAZOS DE LOS SIGNOS VITALES DE LOS PACIENTES, ESTOS REQUISITOS SE CUMPLEN SOBRADAMENTE Y SATISFACEN CON PANTALLAS DE TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HD), ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTO
29	PARTIDA 13, NUMERAL 1, MONITOR MODULAR	DERIVADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LOS MONITORES ACTUALES CONFIGURADO HAN SUPLIDO LA NECESIDAD DE TENER MONITORES MODULARES LOS CUALES FUERON DISEÑADOS PARA ECONOMIZAR EL COSTO POR PARÁMETROS QUE SE USABAN DE FORMA MENOS CONSTANTE. EN LA ACTUALIDAD LAS TECNOLOGÍAS NOS PERMITEN TENER LA MAYOR PARTE DE PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE EN UN MONITOR PRE-CONFIGURADO, CON LA VENTAJA DE QUE SE AMINORA EL COSTO CON RESPECTO A LOS MONITORES MODULARES, NO SUFRE DAÑO FÍSICO POR CAÍDAS Y SOBRE TODO QUE NO SE PIERDE, NI ES SUSCEPTIBLE DE ROBO ADEMÁS EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE ALGÚN OTRO SIGNO VITAL QUE NO ESTUVIESE INTEGRADO AL MONITOR, CUENTA CON LA CAPACIDAD DE TENER PUERTOS PARA CONECTAR LOS MÓDULOS DE ALTA ESPECIALIDAD. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PARA NO LIMITAR LAS TECNOLOGÍAS Y LOS BENEFICIOS QUE ESTA BRINDA A LOS PACIENTES SE ACEPTÉ PODAMOS PARTICIPAR CON MONITOR CONFIGURADO, CON CONEXIONES PARA MÓDULOS DE ALTA ESPECIALIDAD.	NO SE ACEPTA
30	PARTIDA 13, NUMERAL 1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI DEBEMOS ENTENDER POR "8 CANALES CONFIGURABLE" 8 ÁREAS DESIGNADAS PARA LAS CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS.	SE REFIERE A QUE EL MONITOR DEBE TENER 8 CANALES INDEPENDIENTES Y CONFIGURABLES, ES DECIR QUE EL USUARIO PUEDA DEFINIR QUE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS COLOCAR EN CUALQUIER CANAL ADEMÁS DE PODER CONFIGURAR EL PARÁMETRO FISIOLÓGICO INDEPENDIENTE COMO POR EJEMPLO UN VALOR DE ALARMA ALTO Y BAJO
31	PARTIDA 13, NUMERAL 1.19	EN RELACIÓN AL SISTEMA SAMIH, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL PROTOCOLO HL7 ¿ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS BIDIRECCIONAL CON ESTE SISTEMA?	YA SE CONTESTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

32	PARTIDA 14, NUMERAL 3.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE YA QUE SOLICITAN UNA PANTALLA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 3MB SE DEBERÁ ENTENDER 3 MEGA PÍXELES, ¿ES CORRECTO?	YA SE CONTESTO
33	PARTIDA 14, NUMERAL 3.1	EN CASO DE SER CORRECTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HD), YA QUE LA QUE LA SOLICITADA ES PARA PANTALLAS CON TECNOLOGÍA 4K, QUE GENERALMENTE SE USAN PARA FINES DE ENTRETENIMIENTO, EN LAS CENTRALES DE MONITOREO SOLO SE REQUIERES VISUALIZAR LOS DATOS NUMÉRICOS Y TRAZOS DE LOS SIGNOS VITALES DE LOS PACIENTES, ESTOS REQUISITOS SE CUMPLEN SOBRADAMENTE Y SATISFACEN CON PANTALLAS DE TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HD), ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTO
34	PARTIDA 15, NUMERAL 1	DERIVADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LOS MONITORES ACTUALES CONFIGURADO HAN SUPLIDO LA NECESIDAD DE TENER MONITORES MODULARES LOS CUALES FUERON DISEÑADOS PARA ECONOMIZAR EL COSTO POR PARÁMETROS QUE SE USABAN DE FORMA MENOS CONSTANTE. EN LA ACTUALIDAD LAS TECNOLOGÍAS NOS PERMITEN TENER LA MAYOR PARTE DE PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE EN UN MONITOR PRE-CONFIGURADO, CON LA VENTAJA DE QUE SE AMINORA EL COSTO CON RESPECTO A LOS MONITORES MODULARES, NO SUFRE DAÑO FÍSICO POR CAÍDAS Y SOBRE TODO QUE NO SE PIERDE, NI ES SUSCEPTIBLE DE ROBO ADEMÁS EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE ALGÚN OTRO SIGNO VITAL QUE NO ESTUVIESE INTEGRADO AL MONITOR, CUENTA CON LA CAPACIDAD DE TENER PUERTOS PARA CONECTAR LOS MÓDULOS DE ALTA ESPECIALIDAD. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PARA NO LIMITAR LAS TECNOLOGÍAS Y LOS BENEFICIOS QUE ESTA BRINDA A LOS PACIENTES SE ACEPTÉ PODAMOS PARTICIPAR CON MONITOR CONFIGURADO, CON CONEXIONES PARA MÓDULOS DE ALTA ESPECIALIDAD.	NO SE ACEPTA
35	PARTIDA 15, NUMERAL 1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI DEBEMOS ENTENDER POR "8 CANALES CONFIGURABLES" 8 ÁREAS DESIGNADAS PARA LAS CURVAS Y DATOS NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS.	SE REFIERE A QUE EL MONITOR DEBE TENER 8 CANALES INDEPENDIENTES Y CONFIGURABLES, ES DECIR QUE EL USUARIO PUEDA DEFINIR QUE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS COLOCAR EN CUALQUIER CANAL ADEMÁS DE PODER CONFIGURAR EL PARÁMETRO FISIOLÓGICO INDEPENDIENTE COMO POR EJEMPLO UN VALOR DE ALARMA ALTO Y BAJO
36	PARTIDA 15, NUMERAL 1.19	EN RELACIÓN AL SISTEMA SAMIH, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL PROTOCOLO HL7 ¿ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS BIDIRECCIONAL CON ESTE SISTEMA?	HL7 ADEMÁS DE REFERENCIAR TODO EL PUNTO
37	PLANTAMIENTO	TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y HONRADEZ, ASÍ COMO EL	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

		COMBATE A LA CORRUPCIÓN, QUE ENCABEZA ESTE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DESPUÉS DE ANALIZAR LA CANTIDAD DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, Y QUE SON MÁS UNA SERIE DE OBSTÁCULOS ENCAMINADOS A LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, ES DE EXTRAÑAR QUE EL RESTO DE LOS PROVEEDORES NO SE PERCATEN DE ESTO. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE ESTE PROCESO DE ADQUISICIÓN Y QUE FORMAN PARTE DEL ACTUAL GOBIERNO; "SON LOS ADMINISTRADORES" DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y QUE DEBEN CONSIDERAR QUE DICHOS RECURSOS DE NINGÚN MODO SON PARTE DE SU PATRIMONIO PERSONAL, RAZÓN POR LA QUE DEBEN SER ADMINISTRADOS DE MANERA HONESTA TRANSPARENTE Y JUSTA. EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR Y DEBIDO A LA NATURALEZA DE NUESTRAS PALABRAS, ESTAMOS PREPARADOS PARA QUE LA SECRETARÍA Y/O EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INTENTEN AMEDRENTARNOS CON REVISIONES Y/O AUDITORÍAS A NUESTRA EMPRESA, EN LOS DIVERSOS ÁMBITOS QUE LE ES POSIBLE, SIN EMBARGO, ESTO ES NECESARIO E INDISPENSABLE, ALGUIEN TIENE QUE DECIR LA VERDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE FORMA ATENTA Y RESPETUOSA Y CON BASE EN LOS ARTÍCULOS SEXTO Y OCTAVO CONSTITUCIONAL, DE RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONAMIENTO: ¿LA CONVOCANTE CONTINUARA CON LA MISMA OPACIDAD CON LA QUE HA VENIDO ACTUANDO POR AÑOS, PARTICULARMENTE COMO LO HIZO DURANTE EL SEXENIO ANTERIOR?	SE ADVIERTE QUE ESTA PREGUNTA NO GUARDA RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE LAS BASES MOTIVO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022 PARA LA DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA", POR LO QUE LA CONVOCANTE NO PUEDE EMITIR PRECISIÓN AL RESPECTO.
--	--	---	---

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE MANIFIESTAN LO SIGUIENTE:

REPREGUNTAS ESPECIALISTA EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE S.A. DE C.V.

1.- ANEXO 29, PLAZO DE ENTREGA, PAG. 381, CLAVE SAICA 531.635.0114. PREGUNTA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA PARTIDA 113, CON CLAVE SAICA 531.635.0114, TIENE UN TIEMPO DE ENTREGA DE 56, POR CAUSAS DE PANDEMIA Y LOGÍSTICA DE MI REPRESENTADA SOLICITA PODER ENTREGAR DICHA PARTIDA A LOS 180 DÍAS UNA VEZ ADJUDICADA LA PARTIDA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA

REPREGUNTAS DIMSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1.- PARA LAS PARTIDAS DE 8-15, SEGÚN EL ANEXO 29 PAG. 380 SE ESPECIFICAN 105 DÍAS DE ENTREGA PARA UNA PARTIDA DE CENTRAL DE MONITOREO Y 15 DÍAS PARA TRES PARTIDAS. FAVOR DE ESPECIFICAR A CUÁLES PARTIDAS CORRESPONDE CADA UNO O SI HUBIERE ALGÚN ERROR CORREGIRLO. FAVOR DE ACLARAR

RESPUESTA. - EL TIEMPO CORRECTO DE ENTREGA PARA LAS CENTRALES DE MONITORES SERA DE 45 DÍAS NATURALES

2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE 60 DIAS DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS 8-15 REFERENTES A LA CENTRAL DE MONITOREO Y MONITORES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA, EL TIEMPO DE ENTREGA SERA DE 45 DÍAS NATURALES COMO MÁXIMO.

REPREGUNTAS LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

1.- PARTIDA 43. CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, PARTIDA 52, REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES, PARTIDA 68, MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE TIEMPO DE ENTREGA DE 90 DÍAS, DERIVADO DE QUE SON EQUIPOS DE IMPORTACIÓN Y DIFÍCILMENTE LLEGAN EN MENOS DE 90 DÍAS.

RESPUESTA. -

PARTIDA 43, 45 DÍAS NATURALES

PARTIDA 52, 30 DÍAS NATURALES

PARTIDA 68, 30 DÍAS NATURALES

2.- PARTIDA 50, REFRIGERADOR PARA VACUNA 17 PIES
PARTIDA 51, REFRIGERADOR PARA REACTIVOS 5.6 PIES
PARTIDA 51.1, REFRIGERADOR PARA REACTIVOS 8 PIES
PARTIDA 53, BALANZA ANALÍTICA
PARTIDA 53.1, BALANZA ANALÍTICA
PARTIDA 60, PH METRO DIGITAL
PARTIDA 63, MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA
PARTIDA 64, CENTRIFUGA DE MESA 8 TUBOS 13X100 MM
PARTIDA 72, CENTRIFUGA SEMIAUTOMÁTICA
PARTIDA 119, ESTUFA DE CULTIVO
PARTIDA 168, BAÑO MARIA

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DICHAS PARTIDAS QUEDARAN FUERA DE ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO

RESPUESTA. - ES CORRECTO

3.- PUNTO 4.3- PARTIDA 32

DADO QUE LA FUNCIÓN DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR ES MANTENER ESTABLE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE, UN INCREMENTO DEL 5-10 O HASTA 15% ES IRRELEVANTE, YA QUE CUALQUIERA DE ESTOS INCREMENTOS CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE MANTENER TERMORREGULADOR AL PACIENTE.

POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA PARTICIPACIÓN CON EL INCREMENTO DEL 10%. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO.

4.- PUNTO 13- PARTIDA 32

DADO QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS ES LO MÍNIMO REQUERIDO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, YA QUE EL OFERTAR UN COLCHÓN CALEFACTOR RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE IMPERMEABLE PERMITE BLINDAR UNA FUENTE ADICIONAL DE CALOR PARA EL PACIENTE.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

CLÍNICAMENTE APOYAMOS A LA TERMORREGULACIÓN DEL PACIENTE, SOLO A TRAVÉS DEL RADIADOR (MODO CUNA) O DEL CALENTADOR POR CONVENCIÓN (MODO INCUBADORA), SINO TAMBIÉN A TRAVÉS DE UN COLCHÓN CALEFACTOR.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE REQUIERE EL COLCHÓN CALENTADOR Y NO SE ACEPTA.

REPREGUNTAS DE EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA, S.A. DE C.V.

3.- 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.7.1.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES

2. PARA MOBILIARIO MÉDICO

2.2 CERTIFICADOS, 2.2.2 PÁG. 41

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU OFERTA YA QUE AL PEDIR UN CERTIFICADO QUE NO ES PROPIO DE LOS FABRICANTES DEL MOBILIARIO, SE ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE ESTE MODO SOLICITAMOS QUE ESTE CERTIFICADO SEA OPCIONAL Y SE ENTREGUEN LOS CERTIFICADOS PROPIOS DE LOS FABRICANTES COMO EL ISO13485:2016, ISO 9001:2015, EN CASO DE NO ACEPTAR, SOLICITAMOS FUNDAMENTE Y EXPLIQUE POR QUÉ SE SOLICITAN ESTOS CERTIFICADOS QUE NO SON PROPIOS DEL FABRICANTE DE MOBILIARIO MÉDICO

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DEL FABRICANTE DEL ACERO DONDE SE MENCIONE COMO CLIENTE AL FABRICANTE DEL MOBILIARIO MÉDICO.

17. - ANEXO 29 PLAZOS DE ENTREGA

PARTIDAS 2,16,17,18,19,69,87 Y 176

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE LOS TIEMPOS DE 5, 7 Y 30 DÍAS ES IMPOSIBLE HACER LA FABRICACIÓN O ENVÍOS DE LOS EQUIPOS, CON FECHAS TAN CORTAS POR LO QUE SOLICITAMOS SEA PARA ESTAS PARTIDAS QUE CUENTEN CON TIEMPOS MUY CORTOS DE "5, 7 Y 30 DÍAS" A 40 DÍAS, DE LO CONTRARIO SOLICITAMOS NOS FUNDAMENTE EL POR QUÉ NO SE ACEPTAN ESTOS TIEMPOS, YA QUE HAY PARTIDAS EN ESPECÍFICOS CON MAYOR TIEMPO DE ENTREGA.

RESPUESTA: LOS PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA SERÁN LOS SIGUIENTES:

PARA LA PARTIDA 2. 45 DÍAS NATURALES

PARA LAS PARTIDAS 16,17,18 Y 19. 45 DÍAS NATURALES

PARTIDA 69. 30 DÍAS NATURALES

PARTIDA 87. 30 DÍAS NATURALES

PARTIDA 176. 20 DÍAS NATURALES

18. - 4.1 MUESTRAS

4.1.4 PARTIDAS DE INSTRUMENTAL PÁG. 37

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER MANDAR UNA SOLA PINZA PARA MUESTRA, CON SUS RESPECTIVAS ETIQUETAS QUE CUBRA EL CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES SETS DE INSTRUMENTAL, YA QUE LA PIEZA LA SOLICITAN EN DIFERENTES SETS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, PARA LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE LAS 40 PARTIDAS DE INSTRUMENTOS DEBERÁN PRESENTAR UNA PIEZA DE INSTRUMENTAL POR SET OFERTADO O POR MARCA, LAS QUE EL PROVEEDOR PARTICIPE DECIDA SIEMPRE Y CUANDO SE DESCRIBA EN EL SET OFERTADO Y PARA LAS PRUEBAS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA, CORROSIÓN Y DUREZA QUE DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS DEBERÁN REALIZAR SOLAMENTE EN UNA PIEZA DE INSTRUMENTAL QUE PUEDE SER:

1. PINZA KELLY
2. TIJERA MAYO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA"

3. PORTA AGUJAS
4. PINZA MAYO
5. PINZA FOERSTER
6. PINZA KERN
7. PINZA BULLDOG

LA PIEZA DE INSTRUMENTAL A LA CUAL LE DEBERÍA DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA, CORROSIÓN Y DUREZA LA DEBE CONTENER ALGUNO DE LOS SETS QUE OFERTEN

REPREGUNTAS DE HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1. - DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE ENTREGA DE 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO PARA LAS PARTIDAS 8,9,10,11,12,13,14 Y 15 DEBIDO A QUE SON EQUIPOS DE IMPORTACIÓN Y ES IMPOSIBLE ENTREGAR EN LOS 15 DÍAS QUE SOLICITAN, ESTO CON RAZÓN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE SOLO PODRÁN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE YA TIENEN LOS EQUIPOS EN EXISTENCIA AQUÍ EN MÉXICO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, EL TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA SERÁ DE 45 DÍAS NATURALES.

2. - PARA LA PARTIDA 5 "RAYOS X CON FLOUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN C" NO SE PIDEN IMÁGENES DE ESTUDIO NI MUESTRA FÍSICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

3.- EN EL ANEXO DE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS SOLICITAN MUESTRA DE LA PARTIDA 31 "CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO CON REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR- MARACA PASOS", PERO EN EL ANEXO 1 Y 1.1 NO APARECE ESTA PARTIDA, PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI, ¿ESTA PARTIDA TAMBIÉN ESTA CANCELADA?

RESPUESTA: ESTA PARTIDA NO FORMA PARTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO

4.- EN LA PARTIDA 11 " ULTRASONÓGRAFO (PORTÁTIL)" EN EL ANEXO 1 Y 1.1 SOLICITAN 4 EQUIPOS COMO CANTIDAD Y EN ANEXO 29, SOLO 1 EQUIPO, SOLICITAMOS NOS ACLAREN LA CANTIDAD CORRECTA.

RESPUESTA: LO CORRECTO ES LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y 1.1

REPREGUNTAS DE DICIPA S.A. DE C.V.

18.- PARTIDA 5, PUNTO 2.2 PUNTOS FOCALES NOMINALES 0.3 Y 0.6 MM

EL PUNTO FOCAL PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS ES SUPERIOR EN CUANTO MÁS PEQUEÑA SEA ESTE, SI SOLICITAN PUNTOS FOCALES NOMINALES 0.3 Y 0.6 MM; EL EQUIPO QUE OFERTAMOS SUPERA ESTAS CARACTERÍSTICAS YA QUE SU VALOR NÓMINAL DEL PUNTO FOCAL ES DE 0.3/ 0.5 MM Y SOLO ES POR TEMA DE REFERENCIACIÓN DE CADA CASA COMERCIAL. POR LO QUE SOLICITAMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS. VALOR NOMINAL DEL PUNTO FOCAL FOCALES NOMINALES 0.3/ 0.5 MM

RESPUESTA: SI SE TIENE UN ÁNGULO GRANDE, HABRÁ UN FOCO EFECTIVO GRANDE Y EL HAZ DE RADIACIÓN SERÁ MÁS DISPERSO, MIENTRAS QUE SI SE TIENE UN ÁNGULO PEQUEÑO DARÁ COMO RESULTADO UN FOCO EFECTIVO MUY PEQUEÑO LO CUAL CONCENTRA EL HAZ DE RADIACIÓN EN UN ÁREA PEQUEÑA. ES DECIR, PARA ALGUNOS CASOS ES MEJOR PEQUEÑO Y EN OTROS GRANDE; POR LO QUE SE REQUIERE UNO CHICO DE 0.3MM Y OTRO DE 0.6MM, PODRÁ OFERTAR 0.5 MM SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

13.- PARTIDA 5, PUNTO 1.1 GENERADOR DE FRECUENCIA DE 60HZ Y 15KW DE POTENCIA O MAYOR

PARA NO LIMITAR LAS APLICACIONES CLÍNICAS DE ESTE TIPO DE EQUIPOS ES NECESARIO CONOCER LA POTENCIA Y LA SALIDA DE POTENCIA NOMINAL. SI SOLICITAN 15KW DE POTENCIA O MAYOR, MI EQUIPO CUMPLE CON ESTA CARACTERÍSTICA AL OFERTAR POTENCIA DE 12KW Y UNA SALIDA DE POTENCIA NOMINAL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

DE 15KW Y SOLO ES TEMA DE CARACTERÍSTICA DE CADA CASA COMERCIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON ESTA CARACTERÍSTICA PARA CUBRIR ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE REQUIERE UN GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 60HZ Y 15KW DE POTENCIA O MAYOR, LA POTENCIA DEPENDE DE EL KILOVOLTAJE (KV) Y CORRIENTE (AMPERS A) SELECCIONADA, POR LO QUE AL SER LA POTENCIA =KILOVOLTAJE X CORRIENTE, LA POTENCIA "REAL" PUEDE SER MAYOR A LA POTENCIA NOMINAL AL MENOS EN UN INSTANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS APEGARSE A BASES O EXPLICAR CON MAYOR PROFUNDIDAD POR QUE SU POTENCIA NOMINAL QUE ES UNA POTENCIA NOMINAL O RMS (ROOT MAIN SQUARE / RAÍZ CUADRADA MEDIA) ES MAYOR A SU POTENCIA.

REPREGUNTAS COMERLAT S.A. DE C.V.

1.- A PREGUNTA 7. SOLICITAN VIDEOGRABADOR EN EL PUNTO 6 DE LA FICHA POR LO QUE ES NECESARIO REQUERIR QUE EL PROCESADOR PERMITA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN USB Y SOLO LIMITA LA GAMA DE DISTINTAS OFERTAS DE EQUIPAMIENTO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, COMO MONITOR DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 4 TIPO DE ENTRADAS EN EL PUNTO 3.5

2.- A PREGUNTA 10. EL PROCESADOR QUE SE ACEPTARÁ PARA ESTA PARTIDA NO REQUIERE DE ENTRADA +10 ML PARA FUNCIONAR, POR LO QUE NO DEBERÍA SER UN IMPEDIMENTO QUE LA PANTALLA A OFERTAR NO CUENTE CON ESTE PUERTO FAVOR DE PERMITIR OFERTAR PANTALLA CON PUERTO Y-C YHDS, SDI, DVI, DE VIDEO COMPUESTO

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

3.- A PREGUNTA 17, 18 Y 19. CUÁL ES LA PRECISIÓN 10?

RESPUESTA: LOS VALORES ESTÁN INTERCAMBIADOS.

4.- A PREGUNTA 43 A 46. LATIGUILLOS DE 6 A 10 PUNTAS

RESPUESTA: SE ACEPTA DE 10 LATIGUILLOS

5.- A PREGUNTA 48. SOLO ACLARAR QUE LOS 40 DÍAS SERÁN DE LAS PARTIDAS 8, 10, 12 Y 14 CON SUS MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LAS PARTIDAS 9, 11, 13 Y 15.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EL TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA SERÁ DE 45 DÍAS NATURALES

6.- A PREGUNTA 52. EN BASES SE SOLICITA CON MINIMO 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTE SEA EL TIEMPO MÍNIMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO.

RESPUESTA: DEBERÁ ATENDER EL PUNTO 4.7.1.7 EN EL QUE SE SOLICITA CON UN PERÍODO NO MAYOR A 3 AÑOS.

7.- A PREGUNTA 70 Y 71. LA LICITANTE RESPONDIÓ QUE, SOLICITAN TECNOLOGÍA PARA APRECIAR CON MAYOR DETALLE ESTRUCTURAS DEL PX CON UN ESPECTRO AMPLIO DE COLORES LO CUAL NOSOTROS ESTAMOS OFERTANDO TECNOLOGÍA QUE AYUDE A VISUALIZAR LOS PATRONES VASCULARES Y DE LA MUCOSA PEQUEÑAS. FAVOR DE REVALUAR SU RESPUESTA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LAS BASES.

8.- A PREGUNTA 8 DE GE. ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON DEMOSTRAR EL PROTOCOLO HL7. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO DEBERÁ ENTREGAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SI ES ADJUDICADO CUMPLIRÁ CON EL PUNTO 1.17.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

9.- PARTIDA 8, 10, 12 Y 14. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON TENDENCIAS DE 48 HORAS, DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES SERÁ CONCENTRADA EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y ÉSTA OFRECE UNA CAPACIDAD DE 120 HORAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR 48 HORAS SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

10.- PARTIDA 16 EN PERSONAL TÉCNICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MÍNIMA INVASIÓN, LO CUAL INCLUYE TANTO ENDOSCOPIA COMO LAPAROSCOPIA EN LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

REPREGUNTAS. MEDICAL SCOPE S.A. DE C.V.

1.- 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN. LA MANUFACTURA DE LOS EQUIPOS SE REALIZA TOTALMENTE FUERA DE MÉXICO, ES CORRECTO PONER QUE EL GRADO DE INTEGRACIÓN ES DE 0% Y EL CONTENIDO DEL EXTRANJERO DEL 100%. ¿SE ACEPTA LO SOLICITADO?

RESPUESTA: NO ES CORRECTO, SOLO DEBERÁ SEÑALAR EL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL, EL CUAL PUEDE SER DEL 0% AL 100% E INDICAR EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES.

2.- PARTIDA 16. PUNTO 3.5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NO OFERTAR LA ENTRADA DE DISPLAY PORT YA QUE LIMITAN PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: EL EQUIPO MONITOR DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS CUATRO TIPO DE ENTRADAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 3.5

REPREGUNTAS. RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE MI REPRESENTADA OFERTARÁ POTENCIA DE 20 KW Y DE ESTA MANERA LA TASA DE ENFRIAMIENTO CONTINUO DEL ANODO NO REQUIERE UN VALOR TAN GRANDE AL NO SER FORZADO POR EL GENERADOR A SU MÁXIMA POTENCIA, SIENDO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR TASA DE ENFRIAMIENTO CONTINUO DEL ÁNODO DE 60, 000 HU. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ SER DE 70, 000 O MAYOR.

REPREGUNTAS. INSTRUMENTOS QUIRURGICOS GERMANY

1.- EN EL APARTADO 4.7.1.23. PODRÍA MENCIONAR 3 LABORATORIOS QUE REALICEN LAS 3 PRUEBAS SOLICITADAS EN DICHO APARTADO CUMPLIENDO CON LA CERTIFICACIÓN EMA Y REFERENCIADAS POR LA FARMACOPEA.

RESPUESTA: LOS LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA EMA DONDE SE PUEDEN REALIZAR LAS PRUEBAS, SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB: [HTTPS://CATALOGO.CONSULTAEMA.MX:75/BUSQUEDA-LABORATORIOS-DE-ENSAYO](https://CATALOGO.CONSULTAEMA.MX:75/BUSQUEDA-LABORATORIOS-DE-ENSAYO)

2.- DADO CASO QUE LOS SIGUIENTES LABORATORIOS NOMBRADOS INDIQUEN QUE ESTAS PRUEBAS NO LAS REALIZAN, SE PUEDE DESHACER EL PUNTO 4.7.1.23?

RESPUESTA: PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.7.1.23, LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES PODRÁN PRESENTAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO O EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PRUEBAS ANTE EL LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.

3.- PODRÍAN SER MÁS ESPECÍFICOS BAJO QUE NORMA SE TIENEN QUE REALIZAR DICHAS PRUEBAS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

RESPUESTA: ES DE ACUERDO AL MÉTODO GENERAL DE ANÁLISIS DEL SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS
MÉDICOS. CUARTA EDICIÓN. 2017

SE LES PREGUNTO A LOS LICITANTES SI NO TIENEN OTRA PREGUNTA QUE REALIZAR A LO CUAL
RESPONDIERON NO TENER ALGUNO.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES EL NUEVO CALENDARIO DE EVENTOS:

MUESTRAS	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO
25 DE JULIO DE 2022 10:00 A 12:00 HORAS	27 DE JULIO DE 2022 11:00 HORAS	01 DE AGOSTO DE 2022 12:00 HORAS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE
COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN
Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E
INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS
PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS 21:50 HRS., FIRMANDO DE
CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA
INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	
	DRA. NAZAREA HERRERA MALDONADO DIRECTORA HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRIGUEZ ROBLES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
	LIC. NALLELY MORALES ROSAS REPRESENTANTE	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MANUEL MORA DELGADO REPRESENTANTE	
CONTRALORÍA CIUDADANA	MARCO ANTONIO GÓMEZ REPRESENTANTE	
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS	CESAR SEBASTIÁN SALINAS NÁJERA MÉDICO ADSCRITO	

POR LOS LICITANTES

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	PERLA ROGEL MENA	
MOTIONCORP, S.A. DE C.V.	CARLOS HERNANDEZ TREJO	
OURUX, S.A DE C.V.	GABRIEL CORZO CARDONA	
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASES, S.A. DE C.V.	ANTONIO DE J. ROMERO GÓMEZ	
HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL ROMERO CARRERA	
MEGAMED, S.A DE C.V.	LEONEL MARCELO FLORES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	MARTHA GARCÍA MARTÍNEZ	
GRUPO ABUNDANZAA, S.A. DE C.V.	LUIS ENRIQUE MATEOS RUIZ	
COMERLAT S.A DE C.V.	KENIA PAMELA AGUIRRE BELLO	
CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	MANUEL DE JESÚS RECIO RAMÍREZ	
SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIGUEL LÓPEZ ESPINOSA	
LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	HERIBERTO VAZQUEZ SOLORZANO	
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	MIGUEL TELLEZ DOMINGUEZ	
BEATRIZ LÓPEZ LUNA	ISRAEL GARCÍA RANGEL	
NUDOMI, S.A. DE C.V.	YUSEL GÓMEZ BLANCO	
INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A DE C.V.	ISRAEL INIESTRA SACT	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-016-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
CUAJIMALPA"

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN	
MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	OSCAR ROGELIO ORTIZ LEGORRETA.	
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	JOSÉ ROJO LINE	
LABORATORIOS SAAV, S.A. DE C.V.	JORGE ANTONIO SANTANDER GARCÍA	
JUAN R. PACHECO VARGAS	JUAN R. PACHECO VARGAS	
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	MARTA ELENA AVILA	
RADIOLOGÍA Y ELÉCTRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	RODRIGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ	
DIMSA INTERPRETACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.	DIEGO MAXIMILIANO MORALES NIETO	
INBIOMEDIX, S.A. DE C.V.	EDUARDO JAIME CASTRO	
BIODIST, S.A. DE C.V.	ISRAEL GOYTIA SIL	
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SAUL MARQUEZ MARTÍNEZ	
BETON CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	ERIKA GONZALEZ	
SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	BEATRIZ LOPEZ LUNA	
INTERCABLE, S.A. DE C.V.	KATYA DAYANA GALLO MACIAS	
EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA, S.A.P.I. DE C.V.	GERARDO MAYEN VILLALOBOS	
MARÍA SUSANA GONZALEZ CORPIO	MARÍA SUSANA GONZALEZ CORPIO	
DEWIMED, S.A.	VICTOR MANUEL MONCADA PAZOS	
MOBLIFARMA, S.A. DE C.V.	JAIR LEONARDO MORENO ALARCÓN	
INSTRUMENTAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	CÉSAR RAMÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	
FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	MICHEL LOZANO CASILLAS	
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	TEOFILA CADENA ALFARO	
BIOMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ARTURO MILLAN GUADARRAMA	
NEUMEDICA HOMECARE, S.A. DE C.V.	EDUARDO CARDENAS	
EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	GUALBERTO MOLINA	

ACLARACIÓN 2 DE LA CONVOCANTE

EQUIPO MÉDICO				
PARTIDA	CLAVE SAICA	Descripción	Cantidad Solicitada	TIEMPO DE ENTREGA
2	531.385.1031	Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno.	1	15
5	531.341.2571	Rayos X con fluoroscopia móvil digital tipo arco en "C".	1	60
8	531.632.0554	Central de monitoreo para múltiples camas.	1	15
10	531.632.0554	Central de monitoreo para múltiples camas.	1	15
12	531.632.0554	Central de monitoreo para múltiples camas.	1	15
17	531.447.0120	VideogastroscoPIO	1	7
18	531.217.0235	VideocolonoscoPIO	1	7
19	531.316.0086	VideoduodenoscoPIO	1	7
14	531.632.0554	Central de monitoreo para múltiples camas.	1	15
111	531.924.0031	Ultrasonógrafo. (portatil)	1	5
32	531.500.0561	Sistema de calentamiento para pacientes neonatales.	8	56
43	531.422.0053	Campana de flujo laminar. Flujo laminar para mejorar la calidad del aire y dirigir su flujo. Sistema de instalación fija.	2	30
47	531.156.0147	Cama camilla radiotransparente.	14	15
52	533.786.0026	Refrigerador vertical para laboratorio cap. 20 pies cúbicos.	4	15
54	531.609.0041	Marcapaso cardíaco externo.	3	56
59	531.291.0028	Unidad estomatológica con módulo integrado.	1	45
61	537.461.0037	HISTEROSCOPIO.	1	56
66	513.621.1652	Mesa puente	68	15
67	513.143.0059	Buro con cajón hospitalario	54	15
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	8	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	1	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	9	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	4	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	4	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	2	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	1	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	1	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	3	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	5	20
68	513.621.1876	Mesa para instrumental quirurgico	1	20
69	513.621.2429	Mesa universal para exploración.	13	5
77	531.295.1162	Estuche de diagnóstico hospitalario.	16	28
81	533.020.0188	Agitadores electricos, magnetico con plato que calienta y agita combinada o indepediente	1	15
87	513.731.0339	Portalebrillos doble	29	5
91	531.116.0369	Esfigmomanómetro anerode portátil.	46	5
93	515.825.0067	Silla cama para donadores de sangre	2	15
95	531.678.0013	Plicómetro	2	15
113	531.635.0114	Electromotor para cirugía.	1	56
114	060.760.0029	Oxímetro de pulso. Portátil.	10	15
115	531.806.0042	Unidad de secado para equipo de inhaloterapia.	1	70
116	531.807.0017	Selladora térmica para Bolsas de esterilización.	1	70
118	533.255.0218	Congelador horizontal de refrigerantes para vacunas.	1	15
120	533.461.0010	Gradillas Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 40 tubos hasta 22 mm de diámetro.	1	15
121	533.461.0028	Gradillas Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 90 tubos hasta 13 mm de diámetro.	1	42
122	535.816.0017	Sierra oscilatoria eléctrica para cortar hueso	2	56

ACLARACIÓN 2 DE LA CONVOCANTE

PARTIDA	CLAVE SAICA	Descripción	Cantidad Solicitada	TIEMPO DE ENTREGA
INSTRUMENTAL MÉDICO				
123	537.830.0327	SET DE CIRUGÍA MENOR	5	60
124	537.830.0332	SET DE CIRUGÍA GENERAL ADULTO	4	60
125	537.830.0354	SET DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES	3	60
126	537.830.0377	Set de estómago, bazo y pílora	4	60
127	537.830.0582	SET DE ORTOPEDIA FINA PEDIÁTRICA	2	84
128	537.830.0797	SET DE TORACOTOMÍA	3	60
129	537.830.0818	SET DE CIRUGÍA VASCULAR	2	60
130	537.830.0836	SET DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL	1	60
131	537.830.0944	SET DE ADENOAMIGDALECTOMÍA	3	60
132	SIN CLAVE	Set de aseo	15	60
133	SIN CLAVE	Set de Bloqueo	20	60
134	SIN CLAVE	Set de cesárea	5	60
135	SIN CLAVE	Set de circuncisión	2	60
136	SIN CLAVE	Set de cirugía ambulatoria	6	60
137	SIN CLAVE	SET DE CIRUGIA DE MIEMBRO INFERIOR PEDIATRICA	4	60
138	SIN CLAVE	SET DE CIRUGIA DE MIEMBRO SUPERIOR PEDIATRICA	3	60
139	SIN CLAVE	Set de Cirugía General Basico	4	60
140	SIN CLAVE	Set de cirugía general pediátrica	4	84
141	SIN CLAVE	Set de Cirugía Intestinal	3	84
142	SIN CLAVE	SET DE CIRUGIA MENOR PEDIATRICA	3	60
143	SIN CLAVE	Set de Cirugía Ortopédica Basica Adulto	4	60
144	SIN CLAVE	Set de Cirugía Plástica	1	60
145	SIN CLAVE	Set de Colocación de DIU	10	60
146	SIN CLAVE	Set de Colpoperinoplastia	2	60
147	SIN CLAVE	Set de Colposcopia Diagnóstica	2	60
148	SIN CLAVE	Set de Colposcopia Quirúrgica	1	60
149	SIN CLAVE	Set de Corte	20	60
150	SIN CLAVE	Set de curación	23	60
151	SIN CLAVE	Set de dental adulto	2	60
152	SIN CLAVE	Set de disección de 12 piezas	1	60
153	SIN CLAVE	Set de Episiotomía Parto	6	60
154	SIN CLAVE	Set de histerectomía abdominal	4	60
155	SIN CLAVE	Set de histerectomía vaginal	2	60
156	SIN CLAVE	Set de instrumental quirúrgico	2	60
157	SIN CLAVE	Set de legrado	5	60
158	SIN CLAVE	Set de revisión de cavidad	5	60
159	SIN CLAVE	Set de salpingoclasia	8	60
160	SIN CLAVE	Set de sutura adulto	10	60
161	SIN CLAVE	Set de venodisección	5	60
162	SIN CLAVE	Set para cirugía de cuello	2	60
MOBILIARIO MÉDICO				
176	SIN CLAVE	Anaquele con 5 entrepaños	5	5
183	SIN CLAVE	Equipamiento de análisis para Departamento de Ingeniería Biomédica	1	70
186	SIN CLAVE	Extractor eléctrico de leche materna	2	42
187	SIN CLAVE	Frasco de vidrio para leche	50	42
187.1	SIN CLAVE	Frasco de vidrio para leche	50	42
PARTIDAS 9, 11, 13 y 15 DEBEN CONSIDERAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA PARA LAS CENTRALES DE MONITOREO				
PARTIDA 16, DEBERÁ CONSIDERAR LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LAS PARTIDAS 17, 18 Y 19				



Ciudad de México, a 20 de julio de 2022

MINUTA DE TRABAJO VISITA HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA

"L.P.I. NO. 30001122-016-2022, ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA"

Partidas No: "2,8,9,10,11,12,13,14,15,59 Y 115"

Horario: 10:15 a 10:30 hrs

Comentarios y/o Dudas de los Proveedores Participantes:

Se preguntó partida por partida a los licitantes sus observaciones y solo hubo una pregunta por parte de Especialistas en Esterilización y Envase pregunta si el área donde se instalará la partida 2 (Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de Peróxido de hidrógeno) cuenta con línea eléctrica, la convocante aclara que es monofásica.


Comentarios y/o aclaraciones por parte de la Convocante:

Se les informa a los licitantes que lo estipulado en guías mecánicas es lo que se encuentra construido en el hospital y en caso de que se requiera alguna adecuación para la instalación del equipo deberá ser colocado en la propuesta económica y técnica.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E
INSUMOS
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

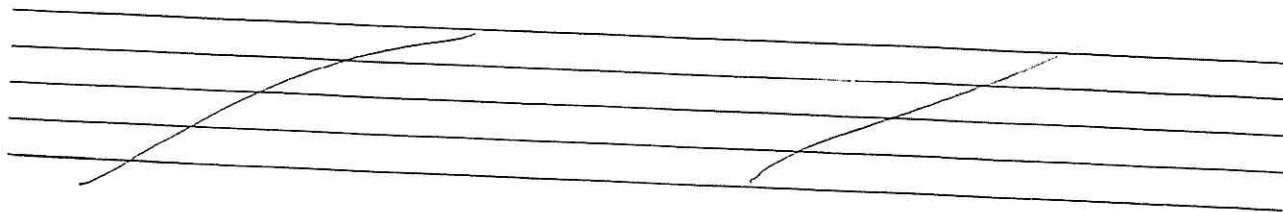

Participantes

Por la Convocante:

Ing. Claudia Quiroz Flores
Subsecretaria de Tecnología e Ingeniería
Misael González Moreno
Auditor, Órgano Interno de Control.

SALINAS NATALIA ESAL SEBASTIAN
MÉDICO ADSCRITO A LA UNIDAD
DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS

JUAN CARLOS VEGA FRANCO
JED. EXLACE ATUO HMI Coahuila.

Por los Proveedores Participantes:

Blanca Estela Trejo López
Mega Med.
GABRIEL TABOADA RUIZ OUNUS S.A.
Fernando Hernandez
Erick Fernando Salazar Gallegos
Alejandra Nava Gómez
Miriam Andrea Jaque
Ricardo Román Campillo Aguirre
Manuel de Jesús Benito Lamiroz CTH
CEIKA GONZÁLEZ ROSA BETAN CONTRACCIONES DE LA PENINSULA
Israel Gayha Sil Biodist SA de CV
ALEXANDER MENDEZ DOMINGUEZ S.A.
Marco Antonio Veizquet Ferreira INBIONMEDIX S.A. DE C.V.
Angel Rameles Cudera Barrera Instrumental SA de CV
Om... Uliso, Romero Romero Giting
GE SYSTEMS MEDICOS OSCAR ROBERTO NUÑEZ MORA
Feliciano Martínez García Especialistas En Esterilización y Envasado SA de CV.
Idia Yaeling Aule Ocker SAAV
Carlos Maencio Chau Mastinec IES

Gerardo Mayen Villalobos.

Editorial de Hospitales ECA.



Katya Dayana Gallo Macias

Intercable S.A. de C.V.




Mauricio Martínez Espinoza.

Comerlat S.A. de C.V.



José Diego Lina
Integral Fis Consulting bussiness S.N. de C.V.



Miguel González Moreno

Órgano Interno de Control