



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-006-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO".

SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA SALA "B" DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 10, ALA NORTE, DEL EDIFICIO UBICADO EN ALTADENA NÚMERO 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO IR-006-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO" HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES:-----

HECHOS

- I. POR PARTE DE "LA CONVOCANTE" SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS:-----

ÁREA	FUNCIONARIO
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES	ING. HÉCTOR EZEQUIEL ZURITA RODRIGUEZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES	ING. SERGIO CARLOS DÍAZ GALEANA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVAN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURIDICOS
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO GÓNZALO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN
POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	C.P. EVA RODRÍGUEZ SORIANO AUDITORA
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	LIC. LUIS IGNACIO RAMIREZ LÓPEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

- II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS PARTICIPANTES:-----

EMPRESA	REPRESENTANTE
LABRIHNOS, S.A. DE C.V.	RODOLFO LAGUNA BRINDIS
INDUSTRIAL, TECNOLOGÍAS Y EQUIPO MARINO INTEQ, S.A. DE C.V.	NADIA A. HERNÁNDEZ ESTRADA
TELCOI, S.A. DE C.V.	JORGE INFANTE POSADAS

- III. PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1.- EN LOS NUMERALES 1.4, 1.5, 2.5, 3.3, 4.3.1, 5.1 DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-006-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO".

DICE: MTRO. HÉCTOR EZEQUIEL ZURITA RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES.

DEBE DECIR: DR. JORGE GERARDO MORALES VELÁZQUEZ, DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ASÍ MISMO

DICE: DIRECCIÓN DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES.

DEBE DECIR: DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES.

2.- EN LOS NUMERALES 2.3 PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y 2.4 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

NUMERAL 2.3 DICE: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL" SE INFORMA QUE EL PERÍODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

DEBE DECIR: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL" SE INFORMA QUE EL PERÍODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO.

NUMERAL 2.4 DICE: LOS BIENES OBJETO DE ESTA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES SE DEBERÁN ENTREGAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.....

DEBE DECIR: LOS BIENES OBJETO DE ESTA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES SE DEBERÁN ENTREGAR 20 DIAS HABILES POSTERIORES A EMISIÓN DEL FALLO.....

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 43 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", 41 FRACCIÓN I DE SU "REGLAMENTO" Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.-----

INDUSTRIAL, TECNOLOGÍAS Y EQUIPO MARINO INTEQ, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:-

PREGUNTA 1.- DE ACUERDO AL PUNTO 2.3 DE LA PAGINA 6 DE 104 EN EL NUMERAL (2.3) PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, MENCIONA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ 20 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, SE PODRÍA EXTENDER A 45 DIAS YA QUE LAS ENTREGAS DE ALGUNAS REFACCIONES EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 4 A 6 SEMANAS, PODRÍA CONSIDERAR EXTENDER LOS DIAS.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERA APEGARSE A LO DESCRITO EN LA PRESIDIÓN 2 DE LA PRESENTE ACTA DONDE SE ESPECIFICA QUE LA ENTREGA SERÁ 20 DIAS HABILES POSTERIORES A EMISIÓN DEL FALLO .-----

TELCOI, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:-----

PREGUNTA 1.- CON BASE AL PUNTO 2.3 DE LA PÁGINA 6 DE 104 EN EL NUMERAL (2.3) PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, SE MENCIONA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, ¿SE PODRÍA EXTENDER A 40 DÍAS? ALGUNAS ENTREGAS DE REFACCIONES SON DE 4 A 7 SEMANAS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-006-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO".

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERA APEGARSE A LO DESCRITO EN LA PRESIÓCN 2 DE LA PRESENTE ACTA DONDE SE ESPECIFICA QUE LA ENTREGA SERÁ 20 DIAS HABLES POSTERIORES A EMISIÓN DEL FALLO .

CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV** DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

- IV. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII** DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.
- V. LA CONVOCANTE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 17:30 HORAS** Y EL ACTO DE **COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:30 HORAS**, AMBOS EVENTOS SERÁN EN LA SALA "B" DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 10, ALA NORTE, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE ALTADENA No. 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
- VI. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN, COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.
- VII. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **18:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA O CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	NOMBRE	FIRMA
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES	ING. HÉCTOR EZEQUIEL ZURITA RODRIGUEZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-006-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO".

ÁREA O CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	NOMBRE	FIRMA
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES	ING. SERGIO CARLOS DÍAZ GALEANA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES	
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVAN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO GÓNZALO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN	
POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	C.P. EVA RODRÍGUEZ SORIANO AUDITORA	
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	LIC. LUIS IGNACIO RAMIREZ LÓPEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	

PARTICIPANTES

EMPRESA O PERSONA FÍSICA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
LABRIHNOS, S.A. DE C.V.	RODOLFO LAGUNA BRINDIS	
INDUSTRIAL, TECNOLOGÍAS Y EQUIPO MARINO INTEQ, S.A. DE C.V.	NADIA A. HERNÁNDEZ ESTRADA	
TELCOI, S.A. DE C.V.	JORGE INFANTE POSADAS	

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-006-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO".



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

1647 F/23042/14
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y
Coordinación Sectorial
Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales

Ciudad de México, a 26 de Septiembre de 2019

Oficio No.: SSCDMX/DGDPPCS/DISSI/1236/2019

Asunto: Fichas Técnicas


LIC. EDUARDO E. CASTILLO ARROYO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
PRESENTE

En contestación a su oficio número SSCDMX/DGAF/DRMAS/4247/2019, con respecto a la revisión de bases y de acuerdo a la reunión llevada a cabo hoy, anexo a este documento las fichas técnicas actualizadas de acuerdo al oficio SSCDMX/DGDPPCS/DISSI/335/2019, para continuar con el proceso administrativo

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

41071


ATENTAMENTE

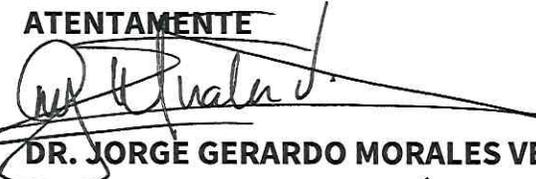
DR. JORGE GERARDO MORALES VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD Y
SISTEMAS INSTITUCIONALES



C.c.e.p.- Dr. Francisco Javier Garrido Latorre.- Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.

JGMV/HEZR/lem



★ 27 SEP 2019 ★

FIRMA Huso HORA: 17:30

CONTROL DE GESTION DRMAS

Calle Altadena 23, Colonia Nápoles
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México.
T. 5132 1200 ext.1017

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0037	CABLE PARA PATCH RJ-45 CAT 6 5 PIES	140	PIEZA

Descripción técnica del bien

PatchCord

Características:

- Cable de longitud 1.5m
- Tipo de Producto: Cable Ensamblado
- Tipo de Cable: Riser UTP Sólido
- Genero de Conector Macho - Macho
- Conector 1: RJ-45
- Conector 2: RJ-45
- Cable y conector Categoría 6
- Blindaje de Cable U/UTP

Los PatchCord deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados empaquetados y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0036	CABLE PARA PATCH RJ-45 CAT 6 10 PIES	50	PIEZA

Descripción técnica del bien

PatchCord

Características:

- Cable de longitud 1.5m
- Tipo de Producto: Cable Ensamblado
- Tipo de Cable: Riser UTP Sólido
- Genero de Conector Macho - Macho
- Conector 1: RJ-45
- Conector 2: RJ-45
- Cable y conector Categoría 6
- Blindaje de Cable U/UTP

Los PatchCord deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados empaquetados y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0077	CONVERTIDORES SATA/IDE	6	PIEZA

Descripción técnica del bien
Convertidores SATA/IDE
Características:


- Conectores integrados para unidades de disco duro SATA de 2.5" y 3.5" y unidades SSD (unidades de estado sólido), así como discos duros IDE
- Indicadores LED para mostrar el estado y los procesos de actualización de las actividades
- Velocidad máxima de transferencia de datos de 5Gbps con USB 3.0 y de 480Mbps con USB 2.0

Los Convertidores deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

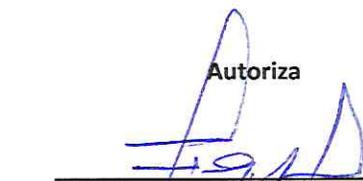

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0162	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB	10	PIEZA

Descripción técnica del bien
Disco Duro Externo de 500 GB
Características:

- Factor de forma: 2.5"
- Incluye carcasa y cable de conexión
- Velocidad de Conexión: USB 3.0
- Velocidad del eje : 5400 rpm
- Tamaño de búfer mínimo : 8 MB

Los Discos duros deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE,
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Salicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0210	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 2430	2	PIEZA

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora HP LaserJet 2430

Características:

- Kit de Mantenimiento Original HP
- Valido para : HP LASERJET 2430 SERIES
- Unidad de fusor 220 Voltios
- Rodillo de transferencia
- Rodillos de arrastre y alimentación (para bandejas)

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0219	KIT PARA IMPRESORA HP LASER JET 6P	3	PIEZA

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora HP LaserJet 6P

Características:

- Kit de Mantenimiento Original HP
- Valido para : HP LASERJET 6P
- Unidad de fusor 220 Voltios
- Rodillo de transferencia
- Rodillos de arrastre y alimentación (para bandejas)

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0223	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL 5330 DN	4	PIEZA

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora Dell 5330 DN

Características:

- Fusor
- Pick Roller
- Transfer Roller

Los Access Point deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA


a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

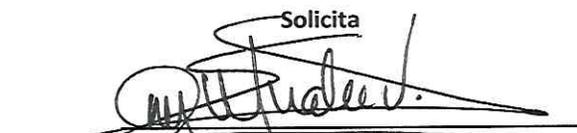
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0360	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS RJ45 TIPO MODULAR CAT6 CUMPLIR CON LA NORMA TIA - EIA568	4	PIEZA

Descripción técnica del bien

Panel de Parcheo de 48Pts RJ-45 Cat6

Características:

- 48 Puertos Categoría 6
- Se puede montar en un Rack estándar de ancho de 19".
- Probado y certificado por la UL por cumplir con 1a norma TIA/EIA-568-B.2, para requisitos de funcionamiento en Categoría 6.
- Seguridad y funcionamiento certificados por la UL.
- Plástico retardante al fuego (UL 94V-0).
- UL / cUL 1863
- Contactos cubiertos de oro de 50 micro pulgadas sobre 100 micro pulgadas de níquel.
- Doble código de configuración, según 1a codificación de colores T568A o T568B.
- Terminaciones tipo IDC 110 especiales que aceptan cables sólidos de 22-26 AWG, combinan la terminación y corte del cable en un solo paso.
- Etiquetas impresas para la identificación de puertos.
- Tipo ángulo 180° (horizontal)
- Provisto con guía trasera para una mejor organización de los cables

Los Paneles deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0353	CONVERTIDOR PARA POE	10	PIEZA

Descripción técnica del bien

Adaptador (Convertidor/Inyector) de energía POE

Características:

- Interfaz 2 puertos 10/100/1000Mbps RJ45 con
- AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX
- 1 puerto de 48VDC
- Medios de Red 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo)
- EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100 m)
- 100BASE-TX: cable UTP categorías 5, 5e (máximo 100 metros)
- EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100 m)
- 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e o 6 (100 metros máximo)
- Fuente de Alimentación 15,4 W (máximo 48 V DC)

Los Convertidores deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0222	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL 3330 DN	4	PIEZA

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora Dell 3330 dn

Características:

- Fusor
- Pick Roller
- Transfer Roller
- Entrada: 200/240V.

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA


a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

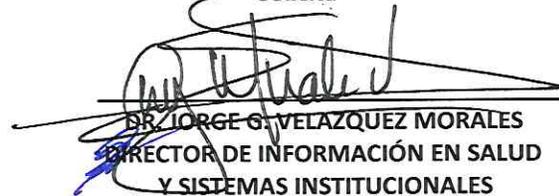
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0224	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-2100 DN	4	KIT

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora ECOSYS FS-2100 DN

Características:

- PickUpRoller
- Feeder
- Fusor
- Gomas

Los Access Point deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0233	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS610 DN	60	KIT

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora Lexmark MS610dn

Características:

- Kit de Fusor
- Media Pick Rollers
- Guía de salida de papel
- Transfer Roller
- SeparationRollersAssembly

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

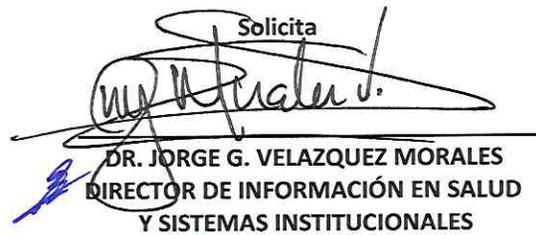

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0356	PICK UP ROLLER DE LA BANDEJA PRINCIPAL PARA IMPRESORA LEXMARK MS610DN N/P: 40X8443	50	PIEZA

Descripción técnica del bien

Pick Up Roller de la Bandeja Principal para la impresora Lexmark MS610dn

Características:

- Conjunto de rodillo de recogida
- Número de Parte: 40x8443

La pieza debe ser nueva, no reconstruida ni re manufacturada o usada, entregada en caja cerrada.


ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

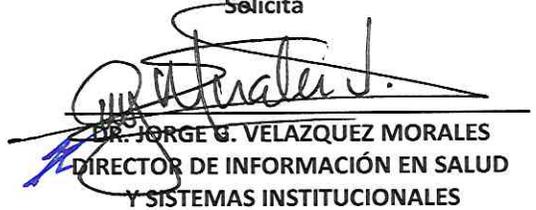
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0164	DISCO DURO DE 500 GB A 7200 RPM SATA	65	PIEZA

Descripción técnica del bien

Disco Duro de 500 GB a 7200 rpm SATA

Características:

- Factor de forma: 3.5" x 1/3H
- Capacidad: 500Gb
- Tipo de Interfaz: Serial ATA
- Native Command Queuing (NCQ), Directed Offline Scan
- Homologado S.M.A.R.T
- Índice de transferencia de la unidad: 300 MBps (externo)
- Tiempo de búsqueda medio : 8.9 ms
- Velocidad del eje : 7200 rpm
- Latencia media: 4.16 ms
- Tamaño de búfer : 16 MB

Los Discos duros deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0244	MEMORIA TIPO DDR2 DE 2 GB	20	PIEZA

Descripción técnica del bien

MEMORIAS PARA PC DE ESCRITORIO

Características:

- Número de Parte KVR667D2N5/2G
- Capacidad 2GB
- Factor de forma 240-Pin
- Tipo de Memoria 667Mhz (PC2-5300)
- Velocidad de Memoria 667Mhz
- Latencia CL5
- Voltaje 1.8 Volts

Las Memorias deberán ser completamente nuevas, no re manufacturadas o reparadas, entregadas en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0044	USB 2.0 TO RS232 SERIAL PIN CABLE	4	PIEZA

Descripción técnica del bien

Cable USB 2.0 a RS232 SERIAL PIN

Características:

- Tasas de transferencia de datos de hasta 921.6 Kbps,
- Compatibilidad con sistemas operativos, incluidos Windows® 8, Linux y Mac OS®,
- Cantidad de Puertos: 1
- Estándares Industriales: USB 1.1 / 2.0 RS232
- Estilo de Puerto: Adaptador de cable
- ID Del Conjunto de chips: prolíficos - PL2303-HxD
- Interfaz: Serial
- Tipo de Bus: USB 2.0
- Rendimiento
- Bits de Datos 5, 6, 7, 8
- Bits de Detención 1, 1.5, 2
- Control de Flujo: Ninguno, Xon / Xoff, RTS / CTS, DTR / DSR
- FIFO: 512 Bytes
- Paridad: Impar, Par, Mark, Espacio, o Ninguno Modos de paridad
- Protocolo División: RS-232
- Tasa Máxima de baudios: 921.6 Kbps
- Conector (es)
- Tipo (s) de Conector (es) 1 - DB-9 (9 pines; D-Sub) Macho
- 1 - USB A (4 pin) Macho

Los Cables deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0130	EXTENSION USB MINIMO DE 2 MTS.	15	PIEZA

Descripción técnica del bien

Generador de tonos para identificación de cables (uso rudo)

Características:

- Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
- Revestimiento del Conector Níquel
- Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
- Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
- Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
- Conexión en cascada de hasta 4 cables USB2AAEXT5M, para mayor extensión
- Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
- Alimentación de Salida 1A
- Consumo de Energía 5
- Corriente de Entrada 0.35 A
- Polaridad Central Positivo
- Tensión de Entrada 110V-240V AC
- Tensión de Salida 5 DC
- Tipo de Enchufe H
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Altura del Producto 0.4 in [9.2 mm]
- Ancho del Producto 0.6 in [16.4 mm]
- Calibre del Conductor 24 AWG
- Color Negro
- Estilo de Conector Recto

Los cables deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0018	BATERIA RECARGABLE SELLADA DE ACIDO-PLOMO, 12 VOLTS A 7 AH	260	PIEZA

Descripción técnica del bien

Generador de tonos para identificación de cables (uso rudo)

Características:

- Batería recargable sellada con ácido de plomo con una capacidad de 12 volts
- A 7Ah
- Voltaje de recarga de 14.5 a 14.8 volts
- Dimensiones Largo 15.1 cm, Ancho 6.5 cm, Alto 9.4cm. Con terminales alto 10cm
- Pero 2.0Kg
- Los pines deben estar colocados en par a un extremo de la pila

Las pilas deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregadas en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0214	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASER 4100	2	KIT

Descripción técnica del bien
Kit de Mantenimiento para Impresora HP LaserJet 4100
Características:

- Kit de Mantenimiento Original HP C8057A kit de mantenimiento 110v, 200.000 páginas
- Valido para : HP LASERJET 4100 SERIES
- Unidad de fusor
- Rodillo de transferencia
- Rodillos de arrastre y alimentación (para bandejas)
- Guantes desechables

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0359	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3428	2	PIEZA

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora Xerox Phaser 3428

Características:

- Kit de Mantenimiento Original XEROX
- Valido para : HP PHASER 3428
- Unidad de fusor 220 Voltios
- Rodillo de transferencia
- Rodillos de arrastre y alimentación (para bandejas)
- Manual

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no recontruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0202	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP 3005N	2	KIT

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora HP LaserJet P3005n

Características:

- 1 Pad De Separacion Hp Laserjet
- 1 Pad De Separacion Charola 1 Hp Laserjet P3005
- 1 Rodillo De Alimentacion Charola 2 Hp Laserjet
- 1 Fusor Hp Laserjet Serie 3005
- 1 Rodillo De Alimentacion Charola 1 Hp Laserjet
- 1 Rodillo De Transferencia Hp Laserjet

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA


PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA


a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

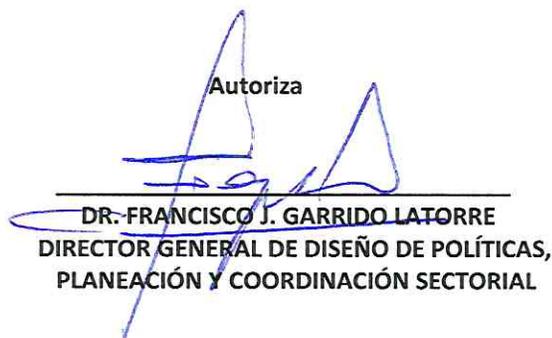
DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

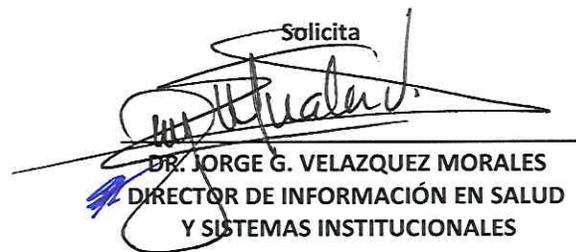
DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0211	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET DE COLOR 3700	2	PIEZA

Descripción técnica del bien
Kit de Mantenimiento para Impresora HP Color 3700
Características:

- Kit de Mantenimiento Original HP Q3656
- Incluye fusor

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0317	TARJETA DE RED PCI GIGABIT ETHERNET	15	PIEZA

Descripción técnica del bien	
Tarjeta de Red Gigabit Ethernet	
Características:	
Hardware	
Cantidad de Puertos	1
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u PCI 2.1, 2.2
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8110SC
Interfaz	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Standard Profile (LP bracket incl.)
Rendimiento	
MTBF	36,000 Horas
Protocolos Admitidos	CSMA/CD
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex	Si
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1000 Mbps
Conector(es)	
Puertos Externos	1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Macho
Software	
Compatibilidad OS	Windows® 98SE, NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Netware Server 5.x, Netware ODI for DOS Linux 2.6.x to 4.4.x, Unix Mac OS X 10.4
Observaciones / Requisitos	
Nota	Dirección E/S y Líneas IRQ asignadas por el sistema
Indicadores	
Indicadores LED	1 - Enlace/Actividad 10/100/1000 Mbits/seg
Requisitos Ambientales	
Humedad	HR 10% ~ 95%
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas	
Altura del Producto	2.5 in [63 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
Longitud del Producto	4.8 in [123 mm]

Peso del Producto	1.9 oz [54 g]
	Información de la Caja
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.1 kg]
	Contenido de la Caja
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Gigabit Ethernet 1 - Soporte de Perfil Bajo 1 - CD del Controlador 1 - Manual de Instrucciones
Las tarjetas deberán ser nuevas, no reconstruidas ni re manufacturadas o usadas, entregadas en caja y con sellos de garantía	

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0198	KIT DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES	6	KIT

Descripción técnica del bien
Kit de Accesorios para Mantenimiento de redes
Características:


- Desforrador de cables UTP/STP
- Pinza ponchadora para plugs de 6 y 8 posiciones
- Herramienta de impacto ajustable tipo 110
- Cortador de cable
- Tester probador de cable para RJ45, RJ11 y BNC

Los Kit de Accesorios deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

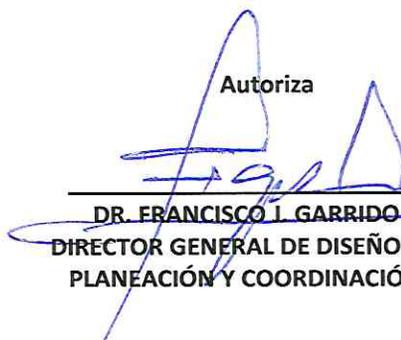

DR. FRANCISCO I. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0135	FUENTE DE PODER 450W PARA PIV	20	PIEZA

Descripción técnica del bien
Fuente de poder de 450W para PC
Características:

- Versión ATX: 1.3
- Utilizar con: PC
- Control de energía
- Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Cortocircuito
- Potencia total 450 W
- Corriente máxima de salida (+5V) 30 A
- Voltaje de entrada AC 90 - 264 V
- Potencia nominal 450 W
- Corriente máxima de salida (+5Vsb) 2 A
- Corriente máxima de salida (+12V) 16 A
- Frecuencia de entrada AC 47/63 Hz
- Corriente máxima de salida (+3.3V) 22 A
- Tiempo de espera 17 ms
- Corriente máxima de salida (-12V) 0,8 A

Las fuentes de poder deben ser nuevas, no reconstruidas ni re manufacturadas o usadas, entregadas en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0357	GOMA PARA IMPRESORA LEXMARK MS610DN, PAD SEPARADOR N/P 40X8444 Y SUB PAD MPF N/P 40X8295	50	PIEZA

Descripción técnica del bien
Goma para impresora lexmark ms610dn, Pad separador y SubPad MPF para la impresora Lexmark MS610dn
Características:

- Conjunto de Goma y Pads Separadores
- Número de Parte: 40x8444 Y 40x8295

Las piezas deben ser nuevas, no reconstruidas ni re manufacturadas o usadas, entregadas en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

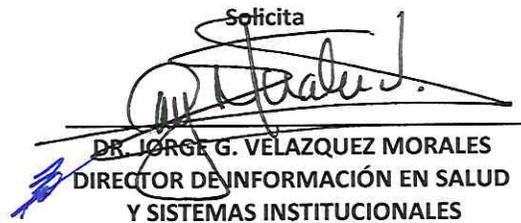

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0327	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB COMPATIBLE CON IEEE 802.11G Y IEEE 802.11B, 2.4GHZ COMPATIBLE CON WINDOWS 98, 2000, XP Y LINUX	60	PIEZA

Descripción técnica del bien
Generador de tonos para identificación de cables (uso rudo)
Características:

- Tecnología: Inalámbrica N
- Estándares: 802.11n, 802.11b, 802.11g
- Antenas: 2 (internas)
- Configuración del software: CD de instalación incluido
- Compatibilidad con sistemas operativos: Windows xp,7, vista, 8 y posteriores, Linux
- Requisitos mínimos del sistema: PC con unidad de CD o DVD, Windows XP SP3, Windows Vista SP1 o versión posterior, Windows 7, o Windows 8
- Velocidad Arriba de 300Mbps

Las tarjetas deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0255	MOUSE ANATOMICO DE DOS BOTONES CON SCROLL OPTICO	300	PIEZA

Descripción técnica del bien
Mouse Anatómico Óptico
Características:

- Diseño Somatológico
- Con rueda de scroll
- Tecnología de orientación óptica avanzada, que escanee cada movimiento y localice rápidamente
- Interfaz USB
- Cómodo agarre
- Diseñado para diestros y zurdos indistintamente
- Compatible con Windows NT/2000/Xp/vista/7/8/Linux/MacOS y superiores
- 1000 dpi de resolución

Todos los mouse deberán ser totalmente nuevos, no re manufacturados, ni reconstruidos, serán entregados en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0305	SOPLADORA PORTATIL TIPO MAKITA	10	PIEZA

Descripción técnica del bien
Sopladora Portátil tipo Makita
Características:

- Potencia: 600W
- Volumen de aire: 0-2,8m3/min
- Presión de aire: 0 – 5,5kPa (0-560mm H2O)
- Velocidad sin carga: 0-16.000
- Longitud total: 480mm (18-7/8")
- Peso neto: 1,9kg (4,1lbs)

Las sopladoras deberán ser nuevas, no reconstruidas, ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0364	DISCO DURO PARA SERVIDOR DE 600GB, SAS, 6GB, 15K7, HOD.	2	PIEZA

Descripción técnica del bien
Disco Duro de 600GB compatible con Servidor DELL R730
Características:

- Interno: Si
- Interfaz mínima: SAS 6Gb/s, Recomendada (SAS 12Gb/s)
- Tamaño de Bufer 128MB
- Velocidad de transferencia de datos: 1.2 Gbps
- Velocidad del Eje: RPM 15k
- Incluye Bandeja

Los Discos Duros deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un años de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0082	UNIDAD DE DISCO DVD TIPO SATA	6	PIEZA

Descripción técnica del bien
Unidad de Disco DVD conexión SATA
Características:

- Grabación y Lectura de DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW
- Velocidad promedio Lectura 52x Escritura 32x
- Conector tipo SATA
- Tipo: Interno
- Para PC de Escritorio
- Tamaño de Bufer: 1.5Mb

Las Unidades deben ser nuevas, no reconstruidas ni re manufacturadas o usadas, entregadas en empaque cerrado

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

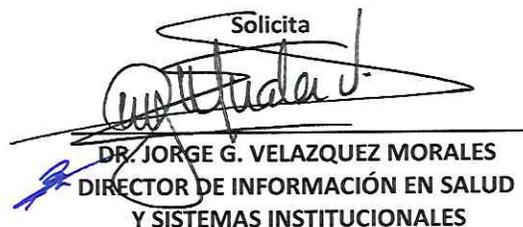

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0054	CANALETA HE 1221 2.5 MTS.	80	PIEZA

Descripción técnica del bien
Canaletas HE
Características:

- Canaleta DE PVC
- Cuadrada
- Color Blanco
- 12X21 MM
- Tramo de 2.5 Mts.

Las canaletas deberán ser nuevas, entregadas en caja

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0071	CAJA UNIVERSAL PLASTICA PARA CONEXION	40	PIEZA

Descripción técnica del bien
Caja Universal plástica para conexión
Características:

- Caja Sencilla Blanca 100x45.
- PVC
- Antiflama
- Con tornillería incluida

Las Cajas deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0186	JACK RJ45 CATEGORIA 6 CON FACE PLATE INCLUIDA Y DE LA MISMA MARCA TIA/EIA 568 AB	250	PIEZA

Descripción técnica del bien

JACK RJ-45 Cat 6 con FACE PLATE incluida

Características:

- Jack Autoponchable en categoría 6 para transmisiones de 250 MHz
- 8 pines de conexión de cobre bañados con 50um de oro.
- Sistema de terminación IDC para terminación con ponchador de tipo 110.
- Resistente al fuego UL 666
- Compatibles con placas estándar (faceplate) para jack y tipo keystone que serán incluidas.

Los Jacks con FacePlate deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía


ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

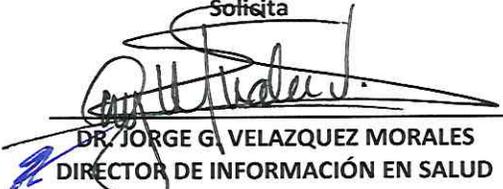
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0194	KIT DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2	3	PIEZA

Descripción técnica del bien

Kit de Accesorios para Mantenimiento de Equipo de Computo

Accesorios Mínimos:

- Mini aspiradora con accesorios
- Cautín para soldar, puntas y estaño
- Desarmador con 25 puntas intercambiables
- Cepillo
- 6 tamaños de desarmadores de precisión (Phillips y cabezaplana)
- Navaja de precisión
- Cinchos
- Cortadores de cable
- Pinzas de precisión con cortador integrado
- Pelador de cables
- Probador eléctrico de voltaje

Los kit de accesorios deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA


a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

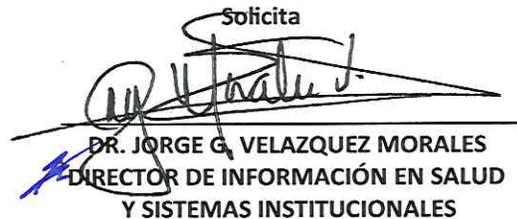
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0081	UNIDAD DE DISCO DVD TIPO IDE	3	PIEZA

Descripción técnica del bien
Unidad de Disco DVD conexión IDE
Características:

- Grabación y Lectura de DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW
- Velocidad promedio Lectura 52x Escritura 32x
- Conector tipo IDE
- Tipo: Interno
- Para PC de Escritorio
- Tamaño de Bufer: 1.5Mb

Las Unidades deben ser nuevas, no reconstruidas ni re manufacturadas o usadas, entregadas en empaque cerrado

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0354	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB DIMENSIONES: 82 MM DE ANCHO,111 MM LARGO,17.5MM ALTURA (MÁXIMO),0.170 KG PESO DETALLE: 2,5" FACTOR DE FORMA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA/XP/2000 PRO/7, MAC OS X 10.4.8 O SUPERIOR	4	PIEZA

Descripción técnica del bien

Disco Duro Externo fácil transportar y resistente a los golpes

Características:

- Disco Duro de 4 TB
- Taza de transferencia en USB 3.0 compatible a USB 2.0
- Velocidad de transferencia de 5GB/max.
- Dimensiones: 82mm x 111mm x 17.5mm
- Peso: 0.24 kg aproximadamente
- Factor de forma 2.5"
- Compatible con Win. XP, 7, Vista, 8, Mac y posteriores
- Con protección contra golpes
- Protección contra Agua

Los Discos Duros deben ser nuevos, no reconstruidos, ni re manufacturados o usados, entregados en cajas y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA


PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

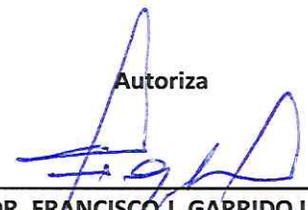
 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0231	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO ML-2250 QUE CONSTA DE: GOMA CENTRAL PARA ALIMENTACION AUTOMATICA DE PAPEL, GOMA CENTRAL PARA ALIMENTACION MANUAL DE PAPEL, RODILLOS LATERALES DE SALIDA DE PAPEL (UBICACION E SISTEMA DE FUSION), SENSOR DE PIEZA	3	PIEZA

Descripción técnica del bien
Kit de Mantenimiento para Impresora Samsung ML-2250
Características:

- Goma central para alimentacion automatica de papel
- Goma central para alimentacion manual de papel
- Rodillos laterales de salida de papel (ubicacion e sistema de fusion)
- Sensor de pieza

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO-LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

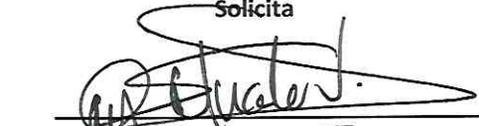

DR. JORGE G. VELÁZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUINENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0007	PULSERAS ANTIESTATICAS REUTILIZABLES	5	PIEZA

Descripción técnica del bien

Generador de tonos para identificación de cables (uso rudo)

Características:


- Conexión a tierra en espiral
- Pinzas tipo caimán
- Longitud del cable extendida: 2 Metros
- Resistividad de la banda: <50 Ohms
- Resistividad de la muñequera: 106 Ohms
- Correa de Velcro

Las Pulseras deben ser nuevas, no reconstruidas ni re manufacturadas o usadas, entregadas en empaque cerrado


ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

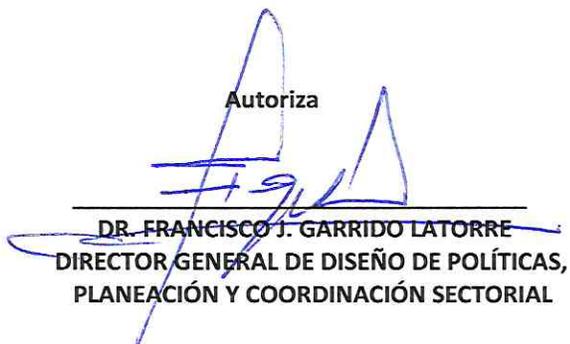
 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

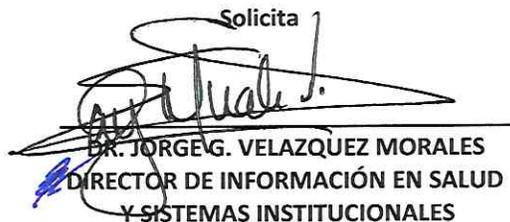
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0215	KIT DE MANTENIMIENTO LASER JET 4200	2	PIEZA

Descripción técnica del bien

Kit de Mantenimiento para Impresora HP LaserJet 4200

Características:

- Kit de Mantenimiento Original HP Q2430-67905
- Incluye rodillo, gomas y fusor

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada.

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0051	CABLE UTP NIVEL 6	42	305 METROS (BOBINA)

Descripción técnica del bien
El cable de par trenzado es un medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes.

Características:

- Cable de red UTP Categoría 6
- Excede los estándares ANSI/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801
- Clase E y EN 50173
- Conductores de 24 AWG
- Aislante de polietileno (no plenum)
- Conductores trenzados en pares separados por cruceta
- Forro de PVC (CM, CMR, CMP) O LSOH (LowSmoke Zero Halogen) retardante de flama,
- Diámetro externo 6.35mm,
- Bobina dentro de caja de 305 metros

Las bobinas de cable tendrán que ser nuevas y en cajas selladas

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

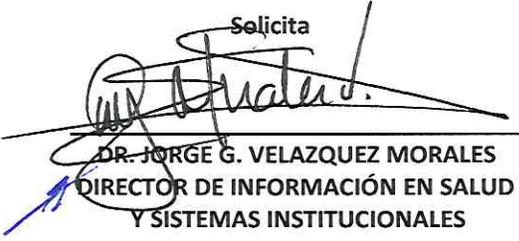

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0046	CABLE USB PARA IMPRESORA	20	PIEZA

Descripción técnica del bien

CABLE USB PARA IMPRESORA
 Es un cable estándar industrial que utiliza conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos.

UTILIDADES

- Conexión fácil y rápida
- Conexión de dispositivos con conector tipo B a PC

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS
 Dimensiones 3 mts.
 Voltaje Soportado: 30V
 Temperatura Máxima Soportada: 60"
 Grueso: 28 AWG
 Tipos de Conectores: USB-A (normal) USB-B (cuadrado)
 Blindaje en el aislante + 1 filtro de señal

Los Cables deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

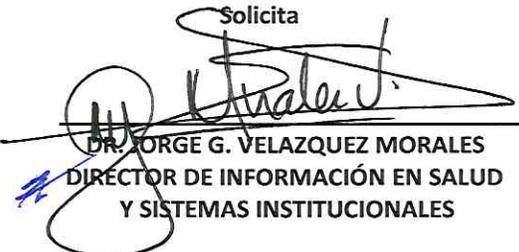

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0039	CABLE PLANO PARA EXTENSION TELEFONICA	2	BOBINA

Descripción técnica del bien
Cable plano para extensión telefónica
Características:


- Alambre de 2 vías
- Color forro exterior: Beige
- Color conductores: Rojo y blanco
- Cable semirígido
- Redondo
- Presentación: Bobina
- Calibre 24 AWG

Los cables planos deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza

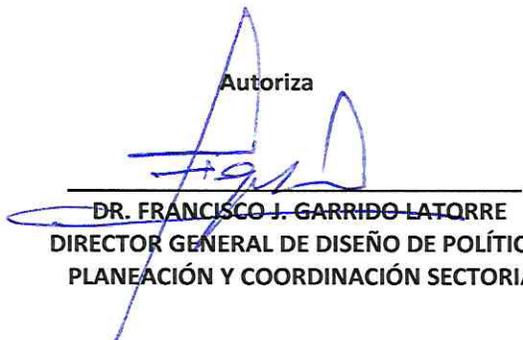

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

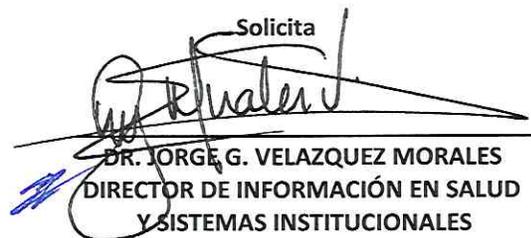

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0041	CABLE PARA PROYECTOR VGA	80	PIEZA

Descripción técnica del bien
Cable VGA
Características:


- Cable VGA de 15 pines
- Compatible con resolución desde 640x400px hasta Full HD (1920x1080)
- Cabezas bañadas en plata
- Macho – Macho
- 1.5 Metros
- Mallado, blindado y coaxilado
- Filtros de Ferrite

Los Access Point deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

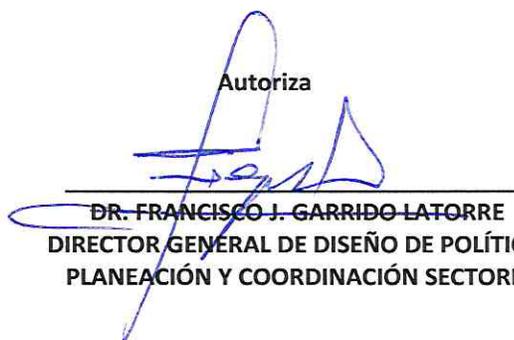

DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0083	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB DIMENCIONES: 82 MM DE ANCHO,111 MM LARGO,17.5MM ALTURA (MÁXIMO),0.170 KG PESO DETALLE: 2,5" FACTOR DE FORMA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA/XP/2000 PRO/7, MAC OS X 10.4.8 O SUPERIOR	6	PIEZA

Descripción técnica del bien

Disco Duro Externo fácil transportar y resistente a los golpes

Características:

- Disco Duro de 1 TB
- Taza de transferencia en USB 3.0 compatible a USB 2.0
- Velocidad de transferencia de 5GB/max.
- Dimensiones: 82mm x 111mm x 17.5mm
- Peso: 0.24 kg aproximadamente
- Factor de forma 2.5"
- Compatible con Win. XP, 7, Vista, 8, Mac y posteriores
- Con protección contra golpes
- Protección contra Agua

Los Discos Duros deben ser nuevos, no reconstruidos, ni re manufacturados o usados, entregados en cajas y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA


a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

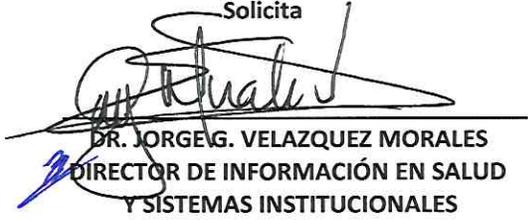
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0059	CABLE PARA EXTENSION TELEFONICA (AURICULAR)	10	PIEZA

Descripción técnica del bien
Generador de tonos para identificación de cables (uso rudo)
Características:

- Cable Telefónico negro en espiral para auricular
- Plug a plug RJ9 de 4.5m
- Con 2 conectores macho (plug) de 4 hilos Red: IEEE 802. 11n, IEEE 802.11g,

Los Access Point deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0213	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASER 4000 / 4050	4	KIT

Descripción técnica del bien

KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASER 4000 / 4050

Características:

- Kit de mantenimiento original HP valido para HP LaserJet 4000/4050 Series
- Incluye fusor 220volts
- Rodillo de transferencia
- Rodillos de arrastre y alimentación (para bandejas)

Los kit de mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

DR. FRANCISCO L. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0010	JUEGO DESARMADORES TIPO RELOJERO	8	PIEZA

Descripción técnica del bien

Generador de tonos para identificación de cables (uso rudo)

Características:

- Puntas fabricadas en acero al cromo vanadio
- Mínimo 26 puntas y accesorios incluidos
- Puntas Planas, Phillips, Cuadradas, Torx, Hexagonales, Pzidriv, Triangulo, Triwing, Llave, Estrella
- Estuche para guardar
- Desarmador con mango sólido de Aluminio

Los Access Point deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA


a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

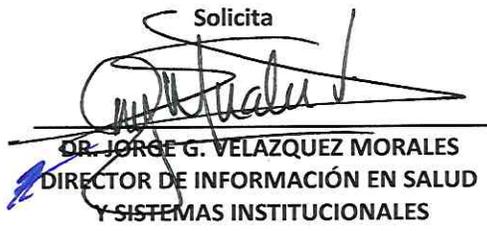
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0016	ASPIRADORA DE TONER	4	PIEZA

Descripción técnica del bien

Aspiradora para Toner

Características:

- Aspirado con Pérdida no mayor a 3 Micras
- Tensión de Alimentación: 120 VCA
- Incluir Manguera, Filtro, tubo flexible, Cepillo, Cable de alimentación y correa de hombro

Las Aspiradoras deben ser nuevas, no reconstruidas ni re manufacturadas o usadas, entregadas en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza

DR. FRANCISCO I. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0116	UNIDAD QUEMADOR DE DVD EXTERNO DOBLE CAPA	10	PIEZA

Descripción técnica del bien

Unidad Quemador de DVD Externo Doble Capa

Características:

- Grabación y Lectura de DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW
- Velocidad promedio Lectura 52x Escritura 32x
- Conexión: Plug and Play – USB 2.0 3.0
- Tipo: Externo
- Tipo de unidad Ultra Slim Portable DVD Writer Drive
- Sistemas Operativos compatibles Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, • Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS X(10.7.5)

Las Unidades deben ser nuevas, no reconstruidas ni re manufacturadas o usadas, entregadas en empaque cerrado


ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

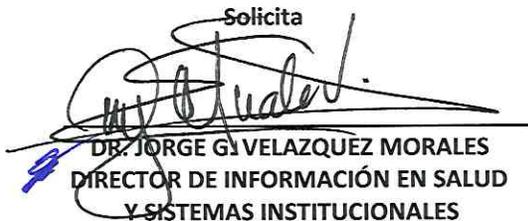
 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0002	ACCES POINT INALAMBRICO	30	PIEZA

Descripción técnica del bien
Access Point Inalámbrico
Características:

- Red: IEEE 802. 11n, IEEE 802.11g,
- Frecuencia: 5 Ghz y 2.4 Ghz
- Rango de alcance: 20 dbi
- Seguridad: WEP, WPA/WPA2, encriptado WPA-PSK/WPA2-PSK, Ad-Hoc, wps
- Calidad del servicio: WMM, WMM-UAPSD, 802. Ip, TOS
- Con soporte de PoE
- Soporte para 16 ESSIDs
- Taza de transferencia de datos: 54 Mbps

Los Access Point deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JÓRGE G. VELÁZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0008	GENERADOR DE TONOS PARA IDENTIFICAR CABLES	2	PIEZA

Descripción técnica del bien

Generador de tonos para identificación de cables (uso rudo)

Características:

- Prueba de redes de datacom, telecom, seguridad, vídeo y audio
- Switch de dos posiciones para señal sencilla o multi-tono
- LEDs de polaridad de línea, continuidad y voltaje
- Modo de batería para voz, debe proporcionar alimentación para comunicaciones de voz a través de los pares no usados
- Prueba de inicios y cables modulares pada pruebas individuales o pruebas de jack modulares
- Punta de plástico reemplazables para evitar cortos accidentales
- Conectores tipo caimán, RJ45, conector opcional tipo F
- Tonos de frecuencia: Altos alternados 500Hz – 781 Hz; Bajos alternados 446 Hz 657 Hz
- Modo de batería para voz: 9V en un circuito de 600 ohms
- Batería: 9V DC estándar o alcalina
- Aprobado por CE: EN 55022 Clase B para ITE y EN 55024
- Peso aprox: 120g
- Bolsa para Transportación
- Protección de voltaje: 50 VDC o 24 VAC

Todos los generadores de tonos deberán ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

VISITAS: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE

PERIODO DE GARANTÍA

a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza


 DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita


 DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUERENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0333	TECLADO UNIVERSAL	300	PIEZA

Descripción técnica del bien
Teclado Universal
Características:

- Teclado distribución Español
- Tipo de teclas estándar con bloque numérico
- Con botones de acceso directo a diversas funciones
- Interfaz USB
- Compatible con Windows Vista/7/8 y Xp
- Resistente a líquidos
- Plug and play
- De color negro

Todos los teclados deberán ser totalmente nuevos, no re manufacturados, ni reconstruidos, serán entregados en caja cerrada

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.

FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita



DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCION DE SISTEMAS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES			
REQUISICIÓN NÚMERO:			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR:			
CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	U.M.
2941-0236	KIT DE MANTENIMIENTO PARA OKI DATA B6500	4	KIT

Descripción técnica del bien
Kit de Mantenimiento para Impresora OKI DATA B6500
 Características:

- FUSOR ORIGINAL
- KIT DE 3 GOMAS
- RODILLO DE TRANSFERENCIA

Los Kit de Mantenimiento deben ser nuevos, no reconstruidos ni re manufacturados o usados, entregados en caja y con sellos de garantía

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN: NO APLICA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD: CONFORME A LO SOLICITADO
LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: LAB DESTINO; ALMACÉN CENTRAL. AV. JARDIN No. 356, COL. DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520; 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
VISITAS: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS: PRUEBAS DE USO Y ENSAMBLE
PERIODO DE GARANTÍA
a) Un año de garantía en repuestos y mano de obra en sitio para todos los elementos descritos.


FIRMAS

Autoriza



DR. FRANCISCO J. GARRIDO LATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS,
 PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Solicita

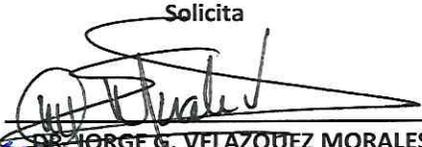

DR. JORGE G. VELAZQUEZ MORALES
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN EN SALUD
 Y SISTEMAS INSTITUCIONALES